VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Depth Micrometer

MODEL:IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Model:IG520-301



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and understand this entire manual before assembling,installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury.

WARNING:

1.This product must be installed by an adult.
2.Keep this product away from children and pets when installing.
3.Seek immediate medical attention if you swallow small parts.
4.Do not draw, cut or clean the surface with a sharp object, otherwise the surface coating will be damaged
5.Removing the depth micrometer may cause damage


Parameter List

Model	IG520-301
Indicator Range	0-1"
Measuring Range with Extensions	0-22"
Graduations	0.001"
Accuracy	±0.001"/0.02mm

Accessories list

Number	Accessory	QTY
1	Mechanical Depth Micrometer	1pc
2	Ball Point	2pcs
3	Needle Point	1pc
4	Spline Point	1pc
5	1inch Extension Rod	1pc
6	2inch Extension Rod	1pc

7	3inch Extension Rod	1pc
8	4inch Extension Rod	1pc
9	5inch Extension Rod	1pc
10	6inch Extension Rod	1pc

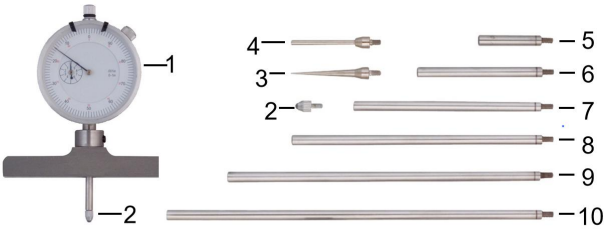


We provided a tool box. When not in use, store all components in the tool box.

Operation

A:Tolerance Markers	B:Bezel Lock Screw
C: Measuring Base	D:Plunger

One small grid on the large dial represents 0.001 inch, and one full rotation equals 0.1 inch. On the small dial, one small grid equals 0.1 inch, and one full rotation equals 1 inch.

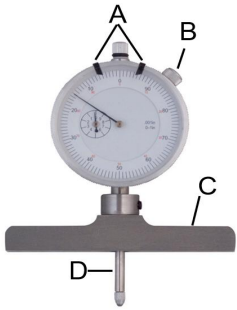

Zero Point Confirmation

• **Setting zero for measurements 0-1".**Place the depth base on a surface plate or flat surface.Loosen the bezel lock screw,

adjust the dial on the depth micrometer to the "0" position and tighten the screw.

Measuring Procedure

• For measuring lengths greater than 1" add the necessary amount of measuring rods for the depth required.

• To ensure correct measurements after adding additional rods, the dial depth micrometer should be set aganist a master part or a setting master

Note: Our product does not include standard or reference parts for the report package. Please purchase them separately.


• Zeroing the indicator (without the extensions) on a flat surface.



• Remove the original ball point, then install the extension rod and finally the ball point.



• .Zeroing the indicator using an extension rod and a setting master.
Please note that our product does not include calibration accessories, which must be purchased separately.

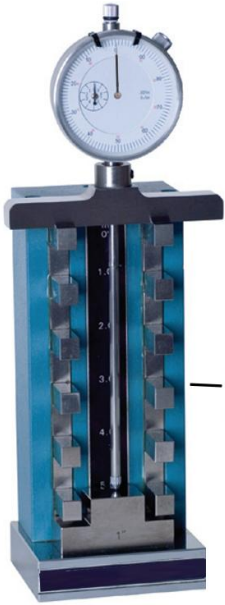

Maintenance

1.Avoid contact with liquids and excessive humidity.
2. If the instrument requires cleaning, use only isopropyl alcohol and a soft cloth.
3.Do not disassemble the depth micrometer, which will reduce its accuracy and damage it.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Micromètre de profondeur

MODÈLE : IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Modèle : IG520-301



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant assembler, installer, utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et
Les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles .

AVERTISSEMENT:

1. Ce produit doit être installé par un adulte .
2. Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques lors de l'installation .
3. Consultez immédiatement un médecin si vous avalez de petites pièces .
4. Ne pas dessiner, couper ou nettoyer la surface avec un objet pointu, sous peine d'endommager le revêtement.
5. Le retrait du micromètre de profondeur peut causer des dommages


Liste des paramètres

Modèle	IG520-301
Plage de l'indicateur	0- 1 "
Plage de mesure avec extensions	0-22"
Remise des diplômes	0,001"
Précision	±0,001"/ 0,02 mm

Liste des accessoires

Nombre	Accessoire	Qté
1	Micromètre de profondeur mécanique	1 pièce
2	stylo à bille	2 pièces
3	Pointe d'aiguille	1 pièce


4	Point de spline	1 pièce
5	Tige d'extension de 1 pouce	1 pièce
6	Tige d'extension de 2 pouces	1 pièce
7	Tige d'extension de 3 pouces	1 pièce
8	Tige d'extension de 4 pouces	1 pièce
9	Tige d'extension de 5 pouces	1 pièce
10	Tige d'extension de 6 pouces	1 pièce

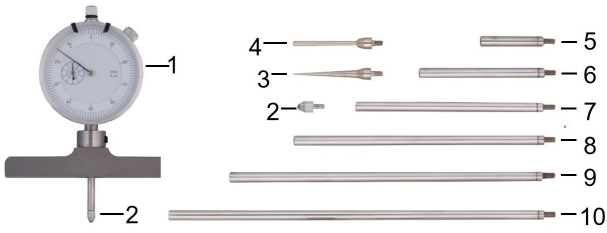

Nous avons fourni une boîte à outils. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez tous les composants dans la boîte à outils.

Opération

A : Marqueurs de tolérance	B : Vis de blocage de la lunette
C : Base de mesure	D : Piston
Sur le grand cadran, une petite graduation représente 0,001 pouce et un tour complet équivaut à 0,1 pouce. Sur le petit cadran, une petite graduation représente 0,1 pouce et un tour complet équivaut à 1 pouce.	

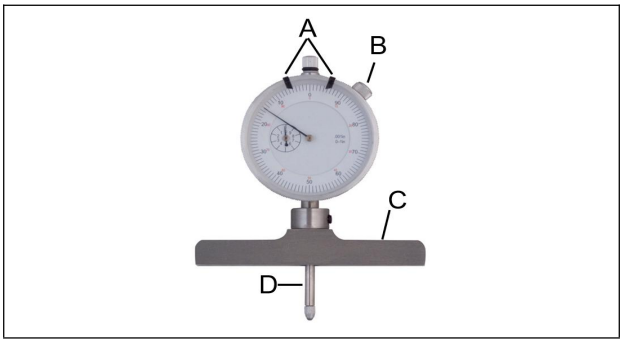

Confirmation du point zéro

• **Réglage du zéro pour les mesures de 0 à 1 pouce.** Placez la base de profondeur sur une surface plane. surface plane ou sur une surface plane. Desserrez la vis de blocage de la lunette, réglez le cadran du micromètre de profondeur sur la position « 0 » et resserrez la vis.

Procédure de mesure

• Pour mesurer des longueurs supérieures à 1 pouce, ajoutez le nombre nécessaire de tiges de mesure pour la profondeur requise.

• Pour garantir des mesures correctes après l'ajout de tiges supplémentaires, le micromètre de profondeur à cadran doit être réglé par rapport à une pièce de référence ou à un étalon de réglage.

Remarque : Notre produit ne comprend pas les pièces standard ou de référence pour le rapport. Veuillez les acheter séparément.


• Remise à zéro de l'indicateur (sans les extensions) sur une surface plane.



• Retirez le stylo à bille d'origine , puis installez la tige d'extension et enfin le stylo à bille .



• . Mise à zéro de l'indicateur à l'aide d'une rallonge et d'un gabarit de réglage.
Veuillez noter que notre produit ne comprend pas d'accessoires d'étalonnage, qui doivent être achetés séparément.

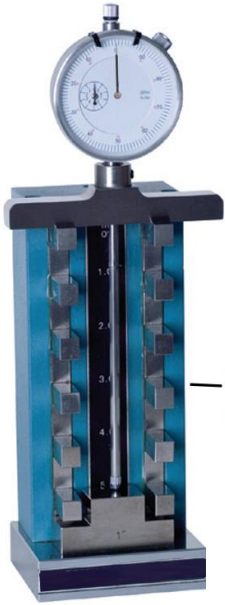

This accessory requires an additional purchase

Entretien

1. Évitez tout contact avec les liquides et une humidité excessive.
2. Si l'instrument nécessite un nettoyage, utilisez uniquement de l'alcool isopropylique et un chiffon doux.
3. Ne démontez pas le micromètre de profondeur, cela réduira sa précision et l'endommagera .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tiefenmikrometer

MODELL: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Modell : IG520-301



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Montage, Installation, Betrieb oder Wartung dieses Geräts Produkt. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und
Anweisungen können zu Verletzungen führen .

WARNUNG:

1. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen installiert werden .
2. Halten Sie dieses Produkt während der Installation von Kindern und Haustieren fern .
3. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie kleine Teile verschlucken .
4. Die Oberfläche darf nicht mit scharfen Gegenständen gezeichnet, geschnitten oder gereinigt werden, da sonst die Oberflächenbeschichtung beschädigt wird.
5. Das Entfernen des Tiefenmikrometers kann zu Beschädigungen führen.


Parameterliste

Modell	IG520-301
Indikatorbereich	0-1 "
Messbereich mit Verlängerungen	0-22"
Abschlussfeiern	0,001"
Genauigkeit	±0,001"/0,0 2 mm

Zubehörliste

Nummer	Zubehör	MENGE
1	Mechanisches Tiefenmikrometer	1 Stück
2	Kugelschreiber	2 Stück
3	Nadelspitze	1 Stück


4	Spline-Punkt	1 Stück
5	1-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück
6	2-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück
7	3-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück
8	4-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück
9	5-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück
10	6-Zoll -Verlängerungsstange	1 Stück

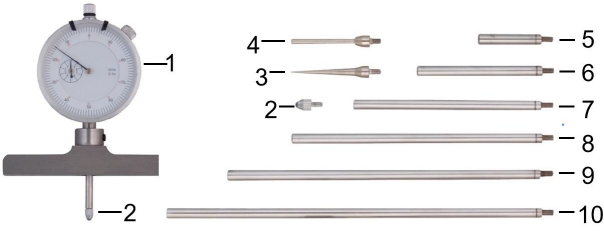

Wir haben einen Werkzeugkasten bereitgestellt. Bewahren Sie alle Komponenten im Werkzeugkasten auf, wenn sie nicht benötigt werden.

Betrieb

A: Toleranzmarkierungen	B: Lünetten-Sicherungsschraube
C: Messbasis	D: Pümpel
Ein kleines Rasterfeld auf dem großen Zifferblatt entspricht 0,001 Zoll, eine volle Umdrehung entspricht 0,1 Zoll. Auf dem kleinen Zifferblatt entspricht ein kleines Rasterfeld 0,1 Zoll, eine volle Umdrehung entspricht 1 Zoll.	

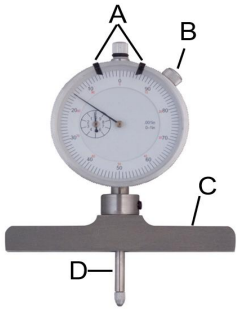

Nullpunktbestätigung

• **Nullpunkt für Messungen von 0 bis 1 einstellen.** Die Tiefenbasis auf einen Oberflächenplatte oder flare Oberfläche. Die Feststellschraube der Lünette lösen, den Drehknopf am Tiefenmikrometer auf die Position „0“ einstellen und die Schraube festziehen.

Messverfahren

• Bei der Messung von Längen über 1 Zoll muss die erforderliche Anzahl an Messstäben für die benötigte Tiefe hinzugefügt werden.

• Um nach dem Hinzufügen weiterer Stäbe korrekte Messungen zu gewährleisten , sollte das Tiefenmessmikrometer an einem Referenzteil oder einer Einstellvorlage eingestellt werden.

Hinweis : Unser Produkt enthält keine Standard- oder Referenzteile für das Berichtspaket. Bitte erwerben Sie diese separat.


• Den Indikator auf Null setzen (ohne die Erweiterungen)
auf einer flfligen Fläche.



• Entfernen Sie die ursprüngliche Kugelspitze , setzen Sie dann die Verlängerungsstange und schließlich die Kugelspitze ein .



• . Nullstellen des Indikators mithilfe einer Verlängerungsstange und eines Einstellwerkzeugs. Bitte beachten Sie, dass unser Produkt kein Kalibrierzubehör enthält, dieses muss separat erworben werden.

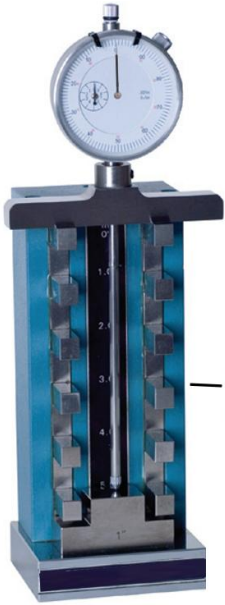

This accessory requires an additional purchase

Wartung

1. Kontakt mit Flüssigkeiten und übermäßiger Luftfeuchtigkeit vermeiden.
2. Falls das Instrument gereinigt werden muss, verwenden Sie ausschließlich Isopropylalkohol und ein weiches Tuch.
3. Das Tiefenmikrometer darf nicht auseinandergenommen werden, da dies seine Genauigkeit verringert und es beschädigt .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Micrometro di profondità

MODELLO: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Modello : IG520-301



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere l'intero manuale prima assemblaggio, installazione, funzionamento o manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali .

AVVERTIMENTO:

1. Questo prodotto deve essere installato da un adulto .
2. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici durante l'installazione .
3. In caso di ingestione di piccole parti, consultare immediatamente un medico .
4. Non disegnare, tagliare o pulire la superficie con un oggetto appuntito, altrimenti il rivestimento superficiale verrà danneggiato
5. La rimozione del micrometro di profondità può causare danni


Elenco dei parametri

Modello	IG520-301
Intervallo dell'indicatore	0- 1 "
Campo di misura con estensioni	0-22"
Lauree	0,001"
Precisione	±0,001"/0,0 2 mm

Elenco degli accessori

Numero	Accessorio	QUANTITÀ
1	Micrometro di profondità meccanico	1 pz
2	Penna a sfera	2 pezzi
3	Punto ago	1 pz


4	Punto spline	1 pz
5	Asta di prolunga da 1 pollice	1 pz
6	Asta di prolunga da 2 pollici	1 pz
7	Asta di prolunga da 3 pollici	1 pz
8	Asta di prolunga da 4 pollici	1 pz
9	Asta di prolunga da 5 pollici	1 pz
10	Asta di prolunga da 6 pollici	1 pz

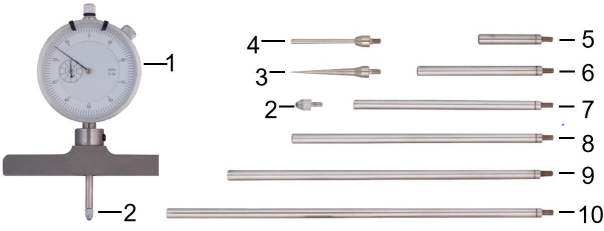

Abbiamo fornito una cassetta degli attrezzi. Quando non vengono utilizzati, riponete tutti i componenti al suo interno.

Operazione

A: Marcatori di tolleranza	B: Vite di bloccaggio della lunetta
C: Base di misura	D: Stantuffo
Una piccola griglia sul quadrante grande rappresenta 0,001 pollici e una rotazione completa equivale a 0,1 pollici. Sul quadrante piccolo, una piccola griglia equivale a 0,1 pollici e una rotazione completa equivale a 1 pollice.	

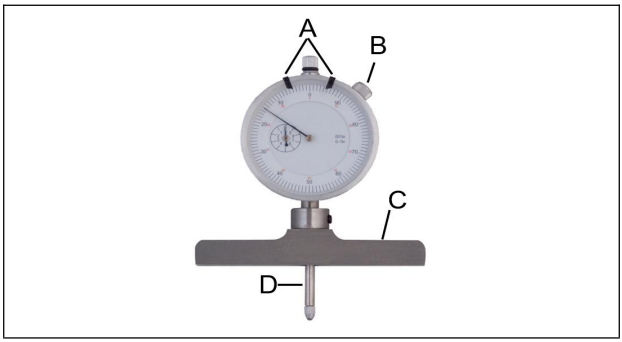

Conferma del punto zero

• **Impostazione dello zero per misurazioni da 0 a 1".** Posizionare la base di profondità su un piastra di superficie o su una superficie piana. Allentare la vite di bloccaggio della lunetta, regolare il quadrante del micrometro di profondità sulla posizione "0" e serrare la vite.

Procedura di misurazione

• Per misurare lunghezze superiori a 1" aggiungere la quantità necessaria di aste di misurazione per la profondità richiesta.

• Per garantire misurazioni corrette dopo l'aggiunta di aste aggiuntive, il micrometro di profondità del quadrante deve essere impostato su un pezzo master o su un master di impostazione

Nota : il nostro prodotto non include parti standard o di riferimento per il pacchetto di report. Si prega di acquistarle separatamente.


• Azzeramento dell'indicatore (senza le prolunghe) su una superficie piana.



• Rimuovere la punta a sfera originale , quindi installare l'asta di prolunga e infine la punta a sfera .



• . Azzeramento dell'indicatore mediante asta di prolunga e master di regolazione.
Si prega di notare che il nostro prodotto non include accessori di calibrazione, che devono essere acquistati separatamente.

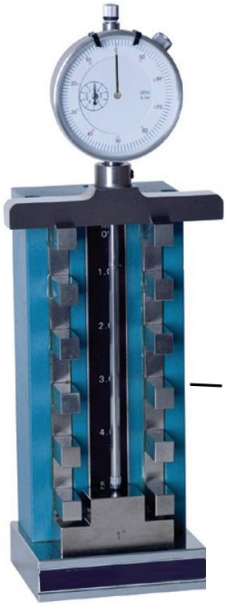

This accessory requires an additional purchase

Manutenzione

1. Evitare il contatto con liquidi e l'eccessiva umidità.
2. Se lo strumento necessita di pulizia, utilizzare solo alcol isopropilico e un panno morbido.
3. Non smontare il micrometro di profondità, poiché ciò ne ridurrebbe la precisione e lo danneggerebbe .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Micrómetro de profundidad

MODELO: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Modelo : IG520-301



(Las imágenes son sólo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto.El incumplimiento de estas advertencias y
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones personales .

ADVERTENCIA:


1. Este producto debe ser instalado por un adulto .
2. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas durante la instalación .
3. Busque atención médica inmediata si ingiere piezas pequeñas .
4. No dibuje, corte ni limpie la superficie con un objeto afilado, de lo contrario se dañará el revestimiento de la superficie.
5. Quitar el micrómetro de profundidad puede causar daños.

Lista de parámetros

Modelo	IG520-301
Rango del indicador	0-1 "
Rango de medición con extensiones	0-22"
Graduaciones	0,001"
Exactitud	±0,001"/ 0,02 mm

Lista de accesorios


Número	Accesorio	CANTIDAD
1	Micrómetro de profundidad mecánico	1 pieza
2	Punta de bola	2 piezas

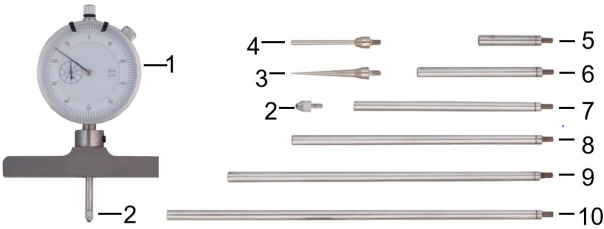3	Punta de aguja	1 pieza
4	Punto spline	1 pieza
5	Varilla de extensión de 1 pulgada	1 pieza
6	Varilla de extensión de 2 pulgadas	1 pieza
7	Varilla de extensión de 3 pulgadas	1 pieza
8	Varilla de extensión de 4 pulgadas	1 pieza
9	Varilla de extensión de 5 pulgadas	1 pieza
10	Varilla de extensión de 6 pulgadas	1 pieza
		
Proporcionamos una caja de herramientas. Cuando no la use, guarde todos los componentes en ella.		

Operación

A: Marcadores de tolerancia	B: Tornillo de bloqueo del bisel
C: Base de medición	D: Émbolo
Una cuadrícula pequeña en la esfera grande representa 0,001 pulgadas y una vuelta completa equivale a 0,1 pulgadas. En la esfera pequeña, una cuadrícula pequeña equivale a 0,1 pulgadas	

y una vuelta completa equivale a 1 pulgada.

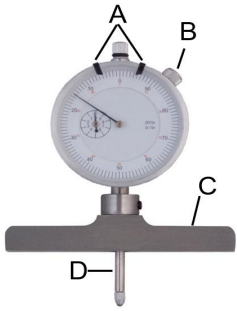

Confirmación del punto cero

• **Ajuste a cero para mediciones de 0 a 1".** Coloque la base de profundidad sobre una placa de superficie o superficie plana. Afloje el tornillo de bloqueo del bisel, ajuste el dial del micrómetro de profundidad a la posición "0" y apriete el tornillo.

Procedimiento de medición

• Para medir longitudes mayores a 1", agregue la cantidad necesaria de varillas de medición para la profundidad requerida.

• Para garantizar mediciones correctas después de agregar varillas adicionales, el micrómetro de profundidad de cuadrante debe ajustarse contra una pieza maestra o un patrón de ajuste.

Nota : Nuestro producto no incluye piezas estándar ni de referencia para el paquete de informes. Adquiéralas por separado.


• Puesta a cero del indicador (sin las extensiones) sobre una superficie plana.



• Retire la punta de bola original , luego instale la varilla de extensión y finalmente la punta de bola .



• . Puesta a cero del indicador mediante una varilla de extensión y un patrón de ajuste.
Tenga en cuenta que nuestro producto no incluye accesorios de calibración, que deben comprarse por separado.

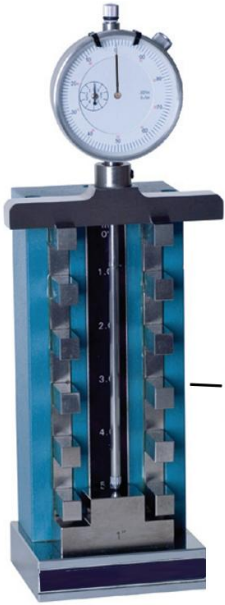

Mantenimiento

1. Evite el contacto con líquidos y humedad excesiva.
2. Si el instrumento requiere limpieza, utilice únicamente alcohol isopropílico y un paño suave.
3. No desmonte el micrómetro de profundidad, ya que reducirá su precisión y lo dañará .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mikrometr głębokościowy

MODEL: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Model : IG520-301



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego

produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. montaż, instalacja, obsługa lub serwisowanie tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała .

OSTRZEŻENIE:

1. Produkt musi zostać zainstalowany przez osobę dorosłą .
2. Podczas instalacji trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych .
3. W przypadku połknięcia małych części należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską .
4. Nie rysuj, nie tnij ani nie czyść powierzchni ostrymi przedmiotami, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłoki powierzchniowej.
5. Wyjęcie mikrometru głębokości może spowodować uszkodzenie


Lista parametrów

Model	IG520-301
Zakres wskaźnika	0-1 "
Zakres pomiarowy z rozszerzeniami	0-22"
Ukończenie szkoły	0,001"
Dokładność	±0,001"/0,0 2 mm

Lista akcesoriów

Numer	Akcesorium	ILOŚĆ
1	Mechaniczny mikrometr głębokościowy	1 szt.
2	Kulka	2 szt .
3	Igła	1 szt.


4	Punkt splajnu	1 szt.
5	Pręt przedłużający 1-calowy	1 szt.
6	Przedłużacz 2-calowy	1 szt.
7	3-calowy pręt przedłużający	1 szt.
8	4-calowy pręt przedłużający	1 szt.
9	Pręt przedłużający 5 cali	1 szt.
10	Pręt przedłużający 6 cali	1 szt.

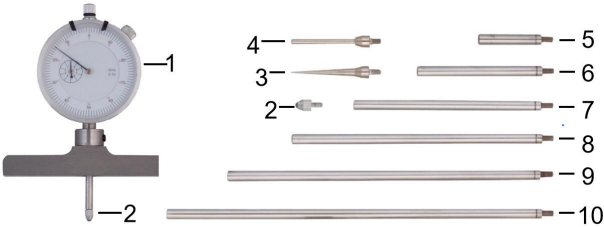

Dostarczyliśmy skrzynkę narzędziową. Gdy nie są używane, przechowuj wszystkie elementy w skrzynce.

Działanie

A: Markery tolerancji	B: Śruba blokująca ramkę
C: Podstawa pomiarowa	D: Tłok
Jedna mała siatka na dużej tarczy odpowiada 0,001 cala, a jeden pełny obrót odpowiada 0,1 cala. Na małej tarczy jedna mała siatka odpowiada 0,1 cala, a jeden pełny obrót odpowiada 1 calowi.	

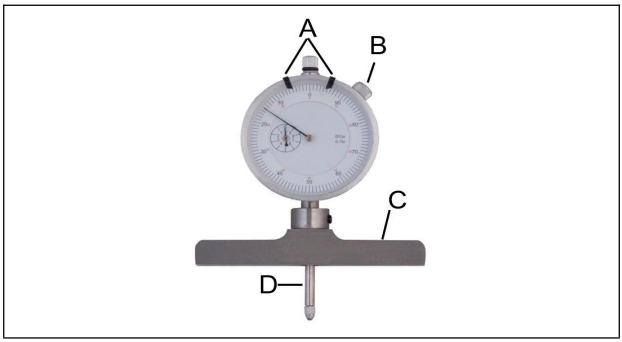

Potwierdzenie punktu zerowego

• **Ustawienie zera dla pomiarów 0-1".** Umieść podstawę głębokości na płyta powierzchniowa lub płaskiej powierzchni. Poluzuj śrubę blokującą pierścień, ustaw pokrętło mikrometru głębokości w pozycji „0" i dokręć śrubę.

Procedura pomiarowa

• W przypadku pomiaru długości większych niż 1" należy dodać odpowiednią liczbę prętów pomiarowych, zależnie od wymaganej głębokości.

• Aby zapewnić prawidłowe pomiary po dodaniu dodatkowych prętów, mikrometr głębokościomierza należy ustawić względem części głównej lub wzorca ustawień.

Uwaga : Nasz produkt nie zawiera standardowych ani referencyjnych części do pakietu raportów. Prosimy o ich zakup osobno.


• Zerowanie wskaźnika (bez przedłużek) na płaskiej powierzchni.



• Wyjmij oryginalną końcówkę kulkową , następnie zamontuj pręt przedłużający i na końcu końcówkę kulkową .



• . Zerowanie wskaźnika za pomocą pręta przedłużającego i wzorca nastawczego.
Należy pamiętać, że nasz produkt nie zawiera akcesoriów kalibracyjnych, które należy zakupić osobno.

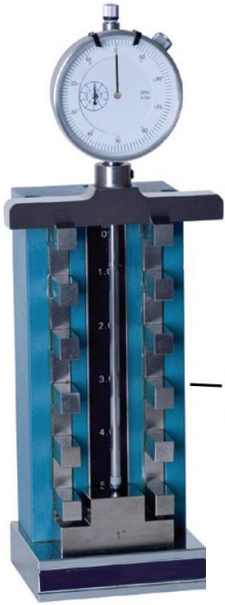

Konserwacja

1. Unikaj kontaktu z płynami i nadmierną wilgocią.
2. Jeśli konieczne jest czyszczenie urządzenia, należy używać wyłącznie alkoholu izopropylowego i miękkiej ściereczki.
3. Nie rozbieraj mikrometru głębokościowego, gdyż spowoduje to zmniejszenie jego dokładności i uszkodzenie .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dieptemicrometer

MODEL: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Model : IG520-301



(Afbeeldingen dienen alleen ter referentie)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het monteren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en
Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel .

WAARSCHUWING:

1. Dit product moet door een volwassene worden geïnstalleerd .
2. Houd dit product tijdens de installatie buiten bereik van kinderen en huisdieren .
3. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u kleine onderdelen inslikt .
4. Teken, snijd of reinig het oppervlak niet met een scherp voorwerp, anders wordt de oppervlaktecoating beschadigd.
5. Het verwijderen van de dieptemicrometer kan schade veroorzaken


Parameterlijst

Model	IG520-301
Indicatorbereik	0-1 "
Meetbereik met verlengstukken	0-22"
Diploma-uitreikingen	0,001"
Nauwkeurigheid	±0,001"/ 0,02 mm

Lijst met accessoires

Nummer	Accessoire	AANTAL
1	Mechanische dieptemeter	1 stuk
2	Balpen	2 stuks


3	Naaldpunt	1 stuk
4	Spline-punt	1 stuk
5	1 inch verlengstang	1 stuk
6	2 inch verlengstang	1 stuk
7	3 inch verlengstang	1 stuk
8	4 inch verlengstang	1 stuk
9	5 inch verlengstang	1 stuk
10	6 inch verlengstang	1 stuk

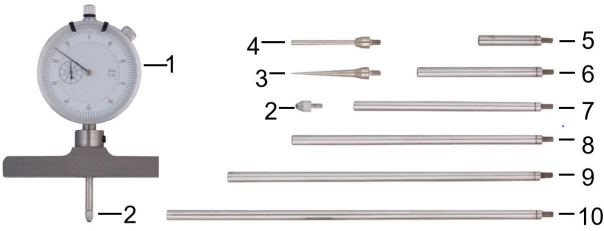

We hebben een gereedschapskist ter beschikking gesteld. Wanneer u de kist niet gebruikt, bergt u alle onderdelen erin op.

Operatie

A: Tolerantiemarkers	B: Bezel Lock-schroef
C: Meetbasis	D: Zuiger
Eén klein raster op de grote wijzerplaat staat voor 0,001 inch, en één volledige rotatie staat gelijk aan 0,1 inch. Op de kleine wijzerplaat staat één klein raster gelijk aan 0,1 inch, en één volledige rotatie staat gelijk aan 1 inch.	

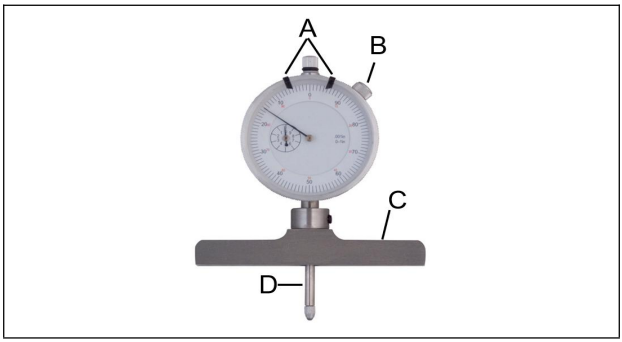

Nulpuntbevestiging

• **Nul instellen voor metingen van 0-1".** Plaats de dieptebasis op een oppervlakteplaat of een plat oppervlak. Draai de schroef van de bezelvergrendeling los, stel de wijzerplaat op de dieptemicrometer in op de "0"-positie en draai de schroef vast.

Meetprocedure

• Voor het meten van lengtes groter dan 1" voegt u het benodigde aantal meetlatten toe voor de gewenste diepte.

• Om correcte metingen te garanderen na het toevoegen van extra staven, moet de dieptemicrometer met wijzerplaat worden ingesteld tegen een masteronderdeel of een instelmaster

Let op : Ons product bevat geen standaard- of referentieonderdelen voor het rapportpakket. Deze kunt u apart aanschaffen.


• De indicator op nul zetten (zonder de verlengstukken) op een plat oppervlak.



• Verwijder de originele kogelpunt , monteer vervolgens de verlengstang en tot slot de kogelpunt .



• . Het op nul zetten van de indicator met behulp van een verlengstang en een instelmaster.
Houd er rekening mee dat ons product geen kalibratieaccessoires bevat. Deze dienen apart te worden aangeschaft.

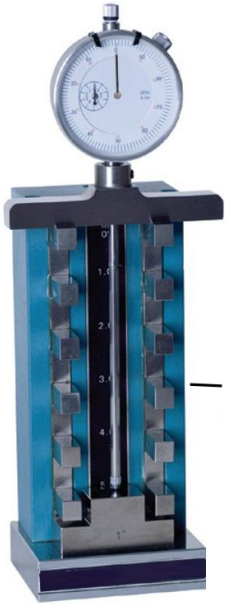

Onderhoud

1. Vermijd contact met vloeistoffen en overmatige vochtigheid.
2. Als het instrument gereinigd moet worden, gebruik dan alleen isopropylalcohol en een zachte doek.
3. Demonteer de dieptemicrometer niet, omdat dit de nauwkeurigheid vermindert en schade aanricht .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Djupmikrometer

MODELL: IG520-301

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Depth Micrometer

Modell : IG520-301



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs och förstå hela denna manual innan du montering, installation, drift eller service av detta produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador .

VARNING:

1. Denna produkt måste installeras av en vuxen .
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur vid installation .
3. Sök omedelbart läkarvård om du sväljer smådelar.
4. Rita, skär eller rengör inte ytan med ett vasst föremål, annars kommer ytbeläggningen att skadas.
5. Att ta bort djupmikrometern kan orsaka skador


Parameterlista

Modell	IG520-301
Indikatorintervall	0-1 "
Mätområde med förlängningar	0-22"
Examen	0,001"
Noggrannhet	±0,001"/ 0,02 mm

Tillbehörslista

Antal	Åtföljande	ANTAL
1	Mekanisk djupmikrometer	1 st
2	Kulspetspenna	2 st
3	Nålspets	1 st
4	Splinepunkt	1 st
5	2,5 cm förlängningsstång	1 st
6	2-tums förlängningsstång	1 st
7	3-tums förlängningsstång	1 st


8	4-tums förlängningsstång	1 st
9	5-tums förlängningsstång	1 st
10	6-tums förlängningsstång	1 st

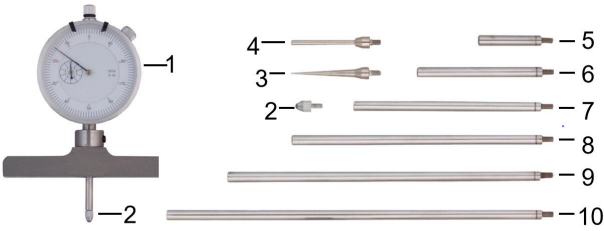

Vi har tillhandahållit en verktygslåda. Förvara alla komponenter i verktygslådan när den inte används.

Drift

A: Toleransmarkörer	B: Skruv för låsning av ramen
C: Mätbas	D: Kolv
Ett litet rutnät på den stora urtavlan representerar 0,001 tum, och ett helt varv är lika med 0,1 tum. På den lilla urtavlan är ett litet rutnät lika med 0,1 tum, och ett helt varv är lika med 1 tum.	

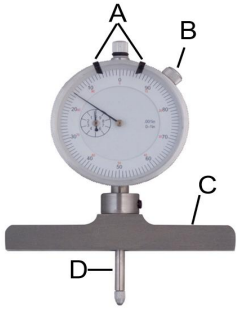

Nollpunktsbekräftelse

• Nollställning för mätningar 0–1". Placera djupbasen på en ytplatta eller plan yta. Lossa låsskruven på ramen, justera ratten på djupmikrometern till läget "0" och dra åt skruven.

Mätprocedur

• För mätning av längder större än 2,5 cm, lägg till det antal mätstavar som behövs för det djup som krävs.
• För att säkerställa korrekta mätningar efter att ytterligare stavar har lagts till, bör djupmikrometern ställas in mot en masterdel eller en inställningsmaster.
Obs ! Vår produkt inkluderar inte standard- eller referensdelar för rapportpaketet. Vänligen köp dem separat.
• Nollställning av indikatorn (utan förlängningar) på en plan yta.




• Ta bort den ursprungliga kulspetsen , montera sedan förlängningsstången och slutligen kulspetsen .



• Nollställning av indikatorn med hjälp av en förlängningsstång och en inställningsmaster . Observera att vår produkt inte inkluderar

kalibreringstillbehör, vilka måste köpas separat.

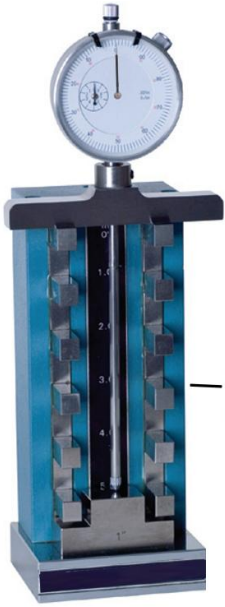

Underhåll

1. Undvik kontakt med vätskor och hög luftfuktighet.
2. Om instrumentet behöver rengöras, använd endast isopropylalkohol och en mjuk trasa.
3. Demontera inte djupmikrometern, det minskar dess noggrannhet och skadar den .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

