VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL:FBL760636

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL:FBL760636





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

Physiotherapist

1. Before first use, adjust the height and the width of the rail to your toilet.
2. Back up to the toilet with your assistive device (if available) until the back of your legs is touching the toilet.
3. Reach back for the rail, hold firmly, and slowly lower yourself into a seated position on the toilet.
4. To return to a standing position, place your hands on the rails firmly and push yourself up into a standing position.
5. Once you are standing, gradually let go of the rails, and only then, grab the handle of your assistive device (if available).



IMPORTANT

1. Don't exceed the maximum weight capacity.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, and rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect them for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Legs	4	⑩		Bucket with lid	1
②		Handrail tube	2	⑪		Seat	1
③		Seat tube	1	⑫		Backrest	1
④		Left backrest tube	1	⑬		Knob	4
⑤		Right backrest tube	1	⑭		Screw set	4
⑥		T-shape tube	4	⑮		Paper towel holder	1
⑦		Suction cup tip	4	⑯		Bag	1
⑧		R12.7 Gray C-Clips	4	⑰		Hexagon screwdriver	1
⑨		R14.3 White C-Clips	4	⑱		Hexagon wrench	1

PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760636
Main Materials	Aluminum
Seat Height	490-585mm/19.3"-23"
Seat Rated Load	227kg/500lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Assembly

1



Note：Remove the rubber sleeve from the Suction cup tip before installation.


Insert the T-shape tubes⑥ into the handrail tubes② one by one, align them with the holes and fix them with the gray C-Clips⑧.

2



Insert the seat tube③ into the installed T shape-tube in the handrail tube,align it with the hole and fix it with the white C-Clips⑨ (2 levels of adjustable width)

3

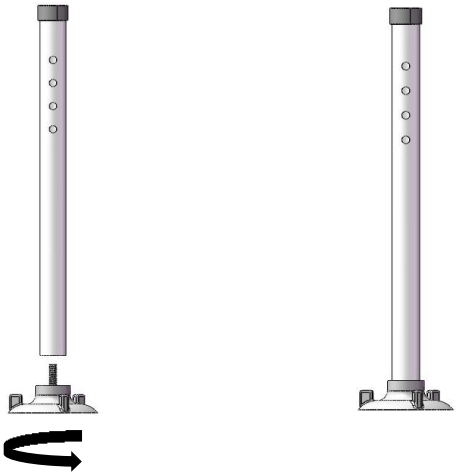

Note：Remove the rubber sleeve from the Suction cup tip before installation.

Align the suction cup tips⑦ with the legs① and tighten it.

4





Press the button on the handrail tube with your hand and insert the legs with the suction cup tips into the handrail tubes one by one until the button pops out (4 levels of adjustable height).


5





Align the left backrest tube④ with the right backrest tube⑤ and the two holes on the handrail tube, pass the screws⑭through, and then tighten them with the screwdrivers⑰ and Hexagon wrench⑱.

6

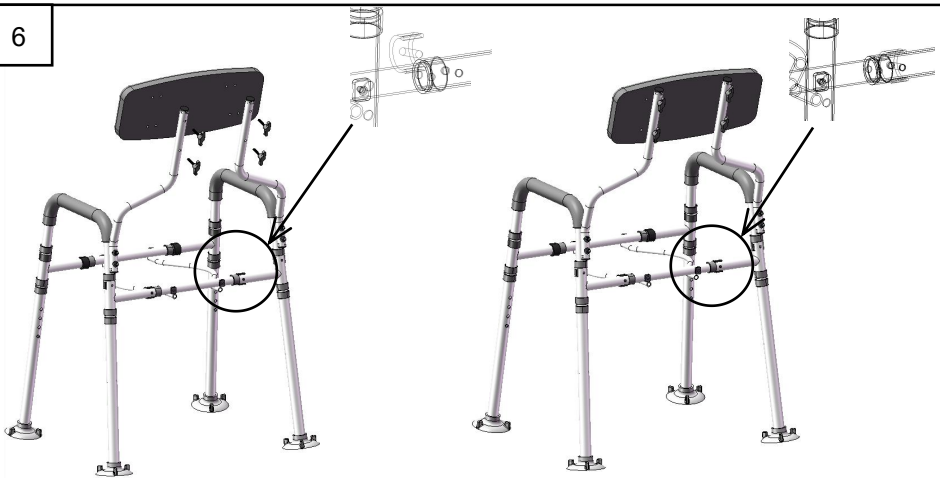

Align the left and right backrest tubes with the holes of the backrest⑫ and lock them with the knobs⑬. There are 2 levels to adjust the width (this needs to be adjusted to the same level as the seat frame width)

7



Place the bucket⑩ into the seat tube.

8



Press the seat⑪ down so that the seat is stuck on the seat tube.

9



If you need to use a paper towel holder⑮, remove one of the C-Clips on the T-tube and insert the paper towel holder⑮.

10





Tie the 4 Velcros on the bag⑯ to the handrail tube, and the storage bag is installed.

As shown in the figure, the product assembly is completed

2.Instruction

1





Remove the knobs on the backrest, the white C-Clips on the seat and the seat tube, pull the handrail tube in the direction of the arrow to adjust it to the second level, and then put the removed accessories back to complete the width adjustment (2-level width adjustment)

2



Press the button and pull out the leg to adjust the height (4 levels of height adjustment)

3



Take off the top seat, lift the seat with holes upwards by hand, and then you can take out the bucket.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE : FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE : FBL760636





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement le manuel afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du produit ou d'annulation de la garantie. Consultez un professionnel en cas d'inconfort, de douleur ou d'aggravation des symptômes. Si nécessaire, assurez-vous d'être supervisé afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids.
Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ce produit doit être utilisé sur une surface plane et stable. Ne le démontez pas si nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel.

Physiothérapeute

1. Avant la première utilisation, ajustez la hauteur et la largeur de la barre à votre toilette.
2. Reculez jusqu'aux toilettes avec votre appareil d'assistance (si disponible) jusqu'à ce que l'arrière de vos jambes touche les toilettes.
3. Attrapez la rampe, tenez-la fermement et abaissez-vous lentement en position assise sur les toilettes.
4. Pour revenir à la position debout, placez fermement vos mains sur les rails et poussez-vous vers le haut pour vous mettre debout.
5. Une fois debout, lâchez progressivement les rails, puis saisissez la poignée de votre appareil d’assistance (si disponible).

IMPORTANT



1. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d’usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit

répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PART LIST

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces listées ci-dessous sont bien présentes et inspectez- les soigneusement pour détecter tout dommage éventuel survenu pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NON	IMAGE	NOM	Qté	NON	IMAGE	NOM	Qté
1		Jambes	4	⑩		Seau avec couvercle	1
②		Tube de main courante	2	⑪		Siège	1
③		Tube de selle	1	⑫		Dossier	1
④		Tube de dossier gauche	1	⑬		Bouton	4
5		Tube de dossier droit	1	⑭		Jeu de vis	4
6		tube en forme de T	4	⑮		Porte-serviettes en papier	1
⑦		Embout à ventouse	4	⑯		Sac	1

⑧		R12.7 Clips en C gris	4	⑰		Tournevis hexagonal	1
⑨		R14.3 Clips C blancs	4	⑱		Clé hexagonale	1

PRODUCT PAREMETERS

Modèle	FBL760636
Principaux matériaux	Aluminium
Hauteur du siège	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Siège Charge nominale	227 kg/500 lb

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

2. Assemblée

1



Remarque : retirez le manchon en caoutchouc de l'embout de la ventouse avant l'installation .


Insérez les tubes en T ⑥ dans les tubes de la main courante ② un par un, alignez-les avec les trous et fixez- les avec les clips en C gris ⑧ .


2



Insérez le tube de selle ③ dans le tube en T installé dans le tube de la main courante, alignez-le avec le trou et fixez-le avec les clips en C blancs ⑨ (2 niveaux de largeur réglable)

3





Remarque : retirez le manchon en caoutchouc de l'embout de la ventouse avant l'installation .

Alignez les pointes des ventouses ⑦ avec les pieds ① et serrez-les.

4





Appuyez sur le bouton du tube de la main courante avec votre main et insérez les pieds avec les embouts à ventouse dans les tubes de la main courante un par un jusqu'à ce que le bouton sorte (4 niveaux de hauteur réglable) .


5





Alignez le tube du dossier gauche ④ avec le tube du dossier droit ⑤ et les deux trous sur le tube de la main courante, passez les vis ⑭ à travers, puis serrez-les avec les tournevis ⑰ et la clé hexagonale ⑱ .

6

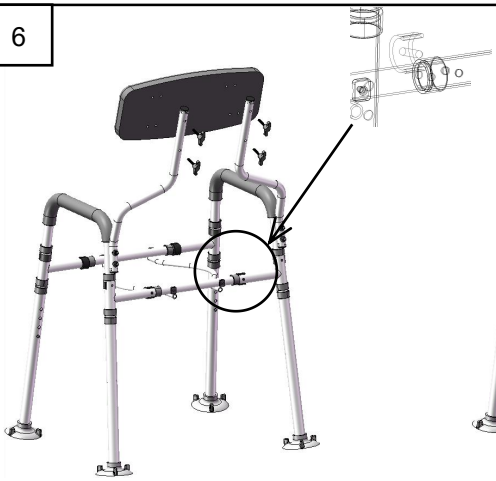



Alignez les tubes gauche et droit du dossier avec les trous du dossier ⑫ et verrouillez-les avec les boutons ⑬ . Il existe deux niveaux de réglage de la largeur (ce réglage doit être identique à celui de l'assise).

7





Placez le seau ⑩ dans le tube de selle.

8



Appuyez sur le siège ⑪ vers le bas afin que le siège soit collé sur le tube de selle.

9



Si vous devez utiliser un porte-serviettes en papier ⑮ , retirez l'un des clips en C sur le tube en T et insérez le porte-serviettes en papier ⑮ .

10





Attachez les 4 Velcros du sac ⑯ au tube de la main courante et le sac de rangement est installé.

Comme le montre la figure, l'assemblage du produit est terminé

2.Instruction

1





Retirez les boutons du dossier, les clips en C blancs du siège et du tube de selle, tirez le tube de la main courante dans le sens de la flèche pour l'ajuster au deuxième niveau, puis remettez les accessoires retirés pour terminer le réglage de la largeur (réglage de la largeur à 2 niveaux)

2



Appuyez sur le bouton et tirez le pied pour régler la hauteur (4 niveaux de réglage de la hauteur)

3



Retirez le siège supérieur, soulevez le siège avec les trous vers le haut à la main, puis vous pouvez retirer le seau.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse : 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMODE

MODELL:FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELL: FBL760636





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG:

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, um Verletzungen, Produktschäden oder Garantieverlust zu vermeiden. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung der Symptome verspüren. Lassen Sie das Produkt gegebenenfalls beaufsichtigen, um es korrekt und sicher zusammenzubauen und zu verwenden. Überschreiten Sie nicht das zulässige Gesamtgewicht.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Das Produkt ist auf ebenen, stabilen Flächen zu verwenden. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

Physiotherapeut

1. Passen Sie vor dem ersten Gebrauch die Höhe und Breite der Stange an Ihre Toilette an.
2. Gehen Sie mit Ihrem Hilfsmittel (sofern vorhanden) rückwärts zur Toilette, bis die Rückseite Ihrer Beine die Toilette berührt .
3. Greifen Sie nach hinten zum Haltegriff, halten Sie ihn fest und lassen Sie sich langsam in eine sitzende Position auf der Toilette hinunter.
4. Um wieder in die stehende Position zurückzukehren, stützen Sie sich mit den Händen fest auf den Schienen ab und drücken Sie sich hoch, bis Sie stehen.
5. Sobald Sie stehen, lassen Sie die Stangen langsam los und greifen Sie erst dann nach dem Griff Ihres Hilfsmittels (falls vorhanden).

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder losen Teilen vorliegen.


4. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser und spülen Sie Seifenreste ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.


5. Besprechen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt, ob das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

PART LIST

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und prüfen Sie sie sorgfältig auf Transportschäden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

NEIN	BILD	NAME	MENGE	NEIN	BILD	NAME	MENGE
①		Beine	4	⑩		Eimer mit Deckel	1
②		Handlaufrohr	2	⑪		Sitz	1
③		Sattelrohr	1	⑫		Rückenlehne	1
④		Linkes Rückenrohr	1	⑬		Knopf	4
⑤		Rechtes Rückenrohr	1	⑭		Schraubensatz	4

⑥		T-förmiges Rohr	4	⑮		Papierhandtuchhalter	1
⑦		Saugnapfspitze	4	⑯		Tasche	1
⑧		R12.7 Graue C-Clips	4	⑰		Sechskantschraubendreher	1
⑨		R14.3 Weiße C-Clips	4	⑱		Sechskantschlüssel	1

PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760636**
Hauptmaterialien	Aluminium
Sitzhöhe	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Sitz Nennlast	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

3. Montage

1



Hinweis: Entfernen Sie vor der Installation die Gummimanschette von der Saugnapfspitze .


Stecken Sie die T-förmigen Rohre ⑥ nacheinander in die Handlaufrohre ② , richten Sie sie an den Löchern aus und befestigen Sie sie mit den grauen C - Clips ⑧ .

2



Stecken Sie das Sattelrohr ③ in das eingebaute T-Rohr im Handlaufrohr, richten Sie es an der Öffnung aus und befestigen Sie es mit den weißen C-Clips ⑨ (2-stufig einstellbare Breite).

3

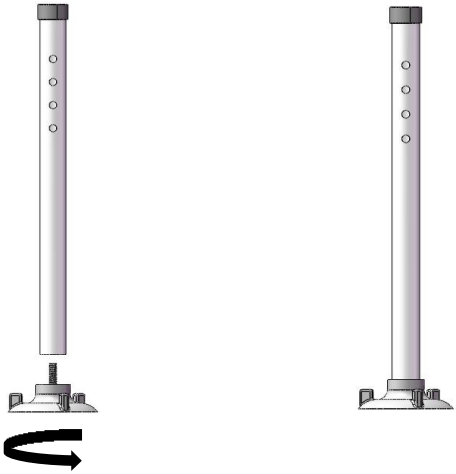

Hinweis: Entfernen Sie vor der Installation die Gummimanschette von der Saugnapfspitze .

Richten Sie die Saugnapfspitzen ⑦ an den Beinen ① aus und ziehen Sie sie fest.

4





Drücken Sie mit der Hand auf den Knopf am Handlaufrohr und stecken Sie die Beine mit den Saugnapfspitzen nacheinander in die Handlaufrohre, bis der Knopf herausspringt (4-stufig höhenverstellbar) .

5






Richten Sie das linke Rückenlehnenrohr ④ mit dem rechten Rückenlehnenrohr ⑤ und den beiden Löchern am Handlaufrohr aus, führen Sie die Schrauben ⑭ hindurch und ziehen Sie sie dann mit den Schraubendrehern ⑰ und dem

Inbusschlüssel ⑱ fest .

6

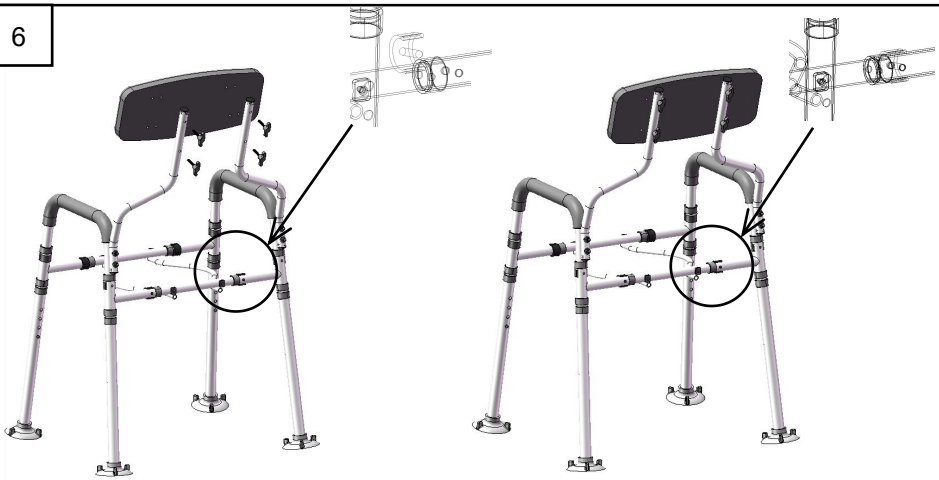

Richten Sie die linken und rechten Rückenlehnenrohre an den Löchern der Rückenlehne ⑫ aus und verriegeln Sie sie mit den Knöpfen ⑬ . Es gibt zwei Stufen zur Breitenverstellung (diese muss auf die gleiche Höhe wie die Breite des Sitzrahmens eingestellt werden).

7





Setzen Sie den Eimer ⑩ in das Sattelrohr ein.

8





Drücken Sie den Sitz ⑪ nach unten, sodass der Sitz fest auf dem Sattelrohr sitzt.

9



Wenn Sie einen Papierhandtuchhalter ⑮ verwenden müssen , entfernen Sie einen der C-Clips am T-Rohr und setzen Sie den Papierhandtuchhalter ⑮ ein .

10



Die 4 Klettverschlüsse der Tasche ⑯ am Handlaufrohr festbinden und schon ist die Aufbewahrungstasche montiert.

Wie in der Abbildung dargestellt, ist die Produktmontage abgeschlossen

2.Anweisung

1



Entfernen Sie die Knöpfe an der Rückenlehne, die weißen C-Clips am Sitz und am Sitzrohr, ziehen Sie das Handlaufrohr in Pfeilrichtung, um es auf die zweite Stufe einzustellen, und setzen Sie anschließend das entfernte Zubehör wieder ein, um die Breiteneinstellung abzuschließen (2-stufige Breiteneinstellung).

2



Drücken Sie die Taste und ziehen Sie das Bein heraus, um die Höhe einzustellen (4 Stufen der Höheneinstellung)

3





Nehmen Sie den oberen Sitz ab, heben Sie den Sitz mit den Löchern mit der Hand nach oben und dann können Sie den Eimer herausnehmen.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMÒ

MODELLO: FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELLO: FBL760636





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il manuale per evitare lesioni, danni al prodotto o invalidare la garanzia. Consultare un professionista in caso di disagio, dolore o peggioramento dei sintomi. Se necessario, sottoporsi a supervisione per montare e utilizzare il prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso. Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la longevità. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

Fisioterapista

1. Prima del primo utilizzo, adattare l'altezza e la larghezza della barra al WC.
2. Torna indietro verso il water con il tuo dispositivo di assistenza (se disponibile) finché la parte posteriore delle gambe non tocca il water.
3. Raggiungi la ringhiera, tienila saldamente e abbassati lentamente fino a raggiungere la posizione seduta sul water.
4. Per tornare in posizione eretta, appoggia saldamente le mani sui corrimano e spingiti verso l'alto per tornare in posizione eretta.
5. Una volta in piedi, lascia andare gradualmente i corrimano e solo allora afferra la maniglia del tuo dispositivo di assistenza (se disponibile).



IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso massima.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PART LIST

Quando si disimballa il prodotto, verificare che i componenti elencati di seguito siano inclusi e ispezionarli attentamente per eventuali danni verificatisi durante il trasporto. Se un componente risulta mancante o danneggiato, non tentare di montare o utilizzare il prodotto.

NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ	NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
①		Gambe	4	⑩		Secchio con coperchio	1
②		Tubo corrimano	2	⑪		Posto a sedere	1
3.		Tubo sella	1	⑫		Schienale	1
④		Tubo dello schienale sinistro	1	⑬		Manopola	4
⑤		Tubo dello schienale destro	1	⑭		Set di viti	4
⑥		Tubo a forma di T	4	⑮		Porta asciugamani di carta	1
⑦		Punta a ventosa	4	⑯		Borsa	1

⑧		R12.7 C-Clip grigi	4	⑰		Cacciavite esagonale	1
⑨		R14.3 Fermagli a C bianchi	4	⑱		Chiave esagonale	1

PRODUCT PAREMETERS

Modello	**FBL760636**
Materiali principali	Alluminio
Altezza del sedile	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Posto a sedere Carico nominale	227 kg/500 libbre

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

4. Assemblea

1



Nota: rimuovere il manicotto in gomma dalla punta della ventosa prima dell'installazione .


Inserire uno alla volta i tubi a T ⑥ nei tubi del corrimano ② , allinearli con i fori e fissarli con le clip a C grigie ⑧ .

2



Inserire il tubo del sedile ③ nel tubo a forma di T installato nel tubo del corrimano, allinearlo con il foro e fissarlo con le clip a C bianche ⑨ (2 livelli di larghezza regolabile)

3

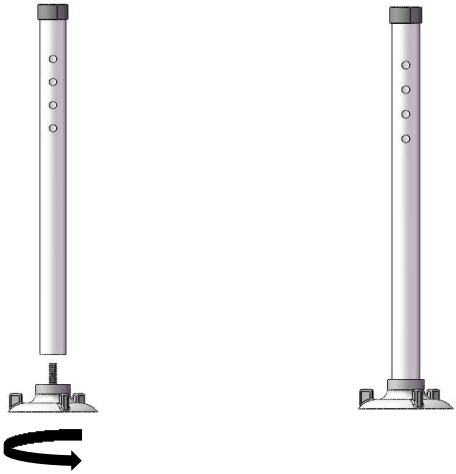

Nota: rimuovere il manicotto in gomma dalla punta della ventosa prima dell'installazione .

Allineare le punte della ventosa ⑦ con le gambe ① e stringere.

4





Premere manualmente il pulsante sul tubo del corrimano e inserire una alla volta le gambe con le punte a ventosa nei tubi del corrimano, finché il pulsante non fuoriesce (4 livelli di altezza regolabile) .


5





Allineare il tubo dello schienale sinistro ④ con il tubo dello schienale destro ⑤ e i due fori sul tubo del corrimano, far passare le viti ⑭ e quindi serrarle con i cacciaviti ⑰ e la chiave esagonale ⑱ .

6

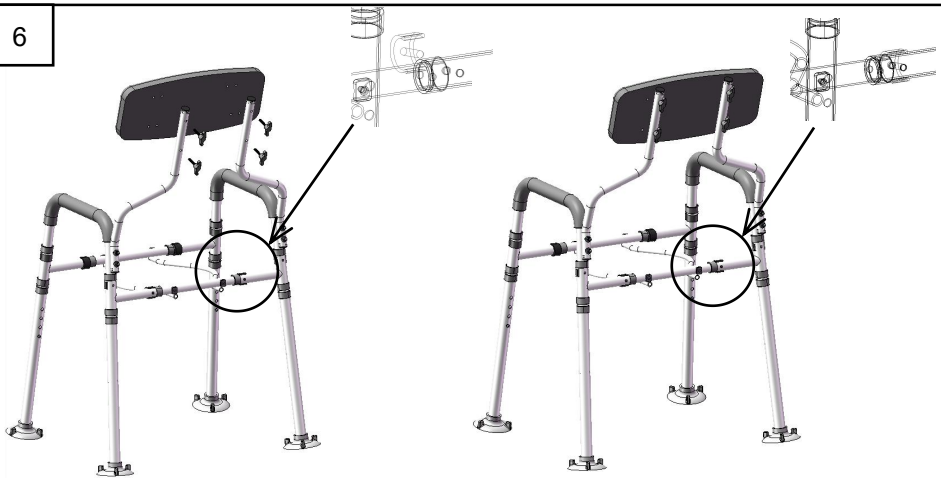

Allineare i tubi dello schienale sinistro e destro con i fori dello schienale ⑫ e bloccarli con le manopole ⑬ . Sono disponibili 2 livelli per regolare la larghezza (la regolazione deve essere effettuata alla stessa altezza della larghezza del telaio del sedile).

7



Posizionare il secchio ⑩ nel tubo del sedile.

8



Premere il sedile ⑪ verso il basso in modo che si incastri sul tubo del sedile.

9



Se è necessario utilizzare un portarotolo di carta ⑮ , rimuovere una delle clip a C sul tubo a T e inserire il portarotolo di carta ⑮ .

10





Fissare i 4 velcro della borsa ⑯ al tubo del corrimano e la borsa portaoggetti è installata.

Come mostrato in figura, l'assemblaggio del prodotto è completato

2.Istruzione

1





Rimuovere le manopole sullo schienale, le clip a C bianche sul sedile e il tubo del sedile, tirare il tubo del corrimano nella direzione della freccia per regolarlo al secondo livello, quindi rimettere gli accessori rimossi per completare la regolazione della larghezza (regolazione della larghezza a 2 livelli)

2



Premere il pulsante ed estrarre la gamba per regolare l'altezza (4 livelli di regolazione dell'altezza)

3



Togliere il sedile superiore, sollevare manualmente il sedile con i fori verso l'alto e quindi estrarre il secchio.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CÓMODA

MODELO:FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELO: FBL760636





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea el manual completo para evitar daños al producto o la anulación de la garantía. Busque ayuda profesional si experimenta molestias, dolor o empeoramiento de los síntomas. Si es necesario, utilice la supervisión de un adulto para ensamblar y usar este producto de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso.

Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, contacte con el servicio de asistencia. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

Fisioterapeuta

1. Antes del primer uso, ajuste la altura y el ancho del riel a su inodoro.
2. Retroceda hasta el inodoro con su dispositivo de asistencia (si está disponible) hasta que la parte posterior de sus piernas toque el inodoro.
3. Alcance la barandilla hacia atrás, agárrese firmemente y bájese lentamente hasta quedar en posición sentada en el inodoro.
4. Para volver a la posición de pie, coloque las manos firmemente sobre los rieles y empújese hacia arriba hasta quedar de pie.
5. Una vez que esté de pie, suelte gradualmente los pasamanos y, solo entonces, agarre el mango de su dispositivo de asistencia (si está disponible).

IMPORTANTE



1. No exceda la capacidad máxima de peso.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, y enjuague cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, seque bien.
5. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se

ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PART LIST

Al desembalar este producto, compruebe que las piezas que se indican a continuación estén incluidas e inspecciónelas cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD	NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
①		Piernas	4	⑩		Cubo con tapa	1
2		Tubo de pasamanos	2	⑪		Asiento	1
③		tubo del asiento	1	⑫		Respaldo	1
④		Tubo del respaldo izquierdo	1	⑬		Perilla	4
5		Tubo del respaldo derecho	1	⑭		Juego de tornillos	4
⑥		tubo en forma de T	4	⑮		Porta toallas de papel	1

⑦		Punta de ventosa	4	⑯		Bolsa	1
⑧		R12.7 Clips en C grises	4	⑰		destornillador hexagonal	1
⑨		R14.3 Clips en C blancos	4	⑱		llave hexagonal	1

PRODUCT PAREMETERS

Modelo	FBL760636
Materiales principales	Aluminio
Altura del asiento	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Asiento Carga nominal	227 kg/500 libras

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

5. Asamblea

1



Nota: Retire la funda de goma de la punta de la ventosa antes de la instalación .


Inserte los tubos en forma de T s ⑥ en los tubos del pasamanos ② uno por uno, alinéelos con los orificios y fíjelos con los clips C grises ⑧ .

2



Inserte el tubo del asiento ③ en el tubo en forma de T instalado en el tubo del pasamanos, alinéelo con el orificio y fíjelo con los clips C blancos ⑨ (2 niveles de ancho ajustable)

3

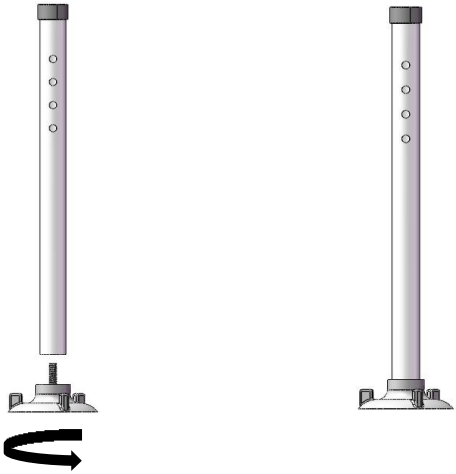

Nota: Retire la funda de goma de la punta de la ventosa antes de la instalación .

Alinee las puntas de la ventosa ⑦ con las patas ① y apriétela.

4





Presione el botón en el tubo del pasamanos con la mano e inserte las patas con las puntas de ventosa en los tubos del pasamanos una por una hasta que el botón salga (4 niveles de altura ajustable) .


5





Alinee el tubo del respaldo izquierdo ④ con el tubo del respaldo derecho ⑤ y los dos orificios del tubo del pasamanos, pase los tornillos ⑭ y luego apriételos con los destornilladores ⑰ y la llave hexagonal ⑱ .

6

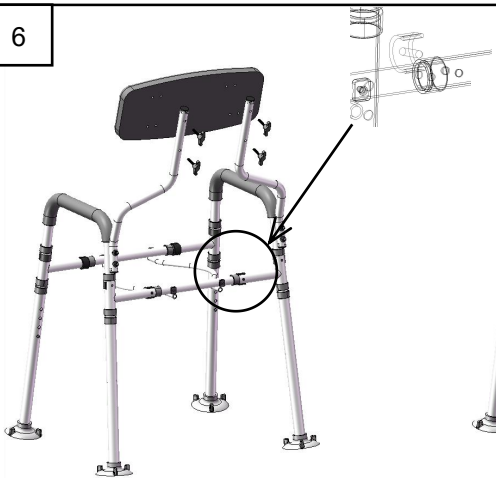



Alinee los tubos izquierdo y derecho del respaldo con los orificios del respaldo ⑫ y bloquéelos con las perillas ⑬ . Hay dos niveles para ajustar el ancho (debe ajustarse al mismo nivel que el ancho del marco del asiento).

7





Coloque el cubo ⑩ en el tubo del asiento.

8



Presione el asiento ⑪ hacia abajo de manera que quede fijado en el tubo del asiento.

9



Si necesita utilizar un soporte para toallas de papel ⑮ , retire uno de los clips en C del tubo en T e inserte el soporte para toallas de papel ⑮ .

10





Ate los 4 velcros de la bolsa ⑯ al tubo del pasamanos y la bolsa de almacenamiento estará instalada.

Como se muestra en la figura, el ensamblaje del producto está completo.

2.Instrucción

1





Retire las perillas del respaldo, los C-Clips blancos del asiento y el tubo del asiento, tire del tubo del pasamanos en la dirección de la flecha para ajustarlo al segundo nivel y luego vuelva a colocar los accesorios retirados para completar el ajuste de ancho (ajuste de ancho de 2 niveles)

2



Presione el botón y tire de la pata para ajustar la altura (4 niveles de ajuste de altura)

3



Quita el asiento superior, levanta el asiento con los orificios hacia arriba con la mano y luego podrás sacar el cubo.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMODA

MODEL:FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760636





To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj instrukcję w całości, aby uniknąć szkód, uszkodzeń produktu lub naruszenia gwarancji. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub pogorszenia objawów należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. W razie potrzeby należy skorzystać z nadzoru w celu prawidłowego i bezpiecznego montażu i użytkowania produktu. Nie przekraczać limitu wagowego.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nogi produktu są równe i zablokowane, a jeśli pojawią się oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części, przerwij użytkowanie. Produkt należy używać na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozmontowuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, chyba że określono to w instrukcji.

Fizjoterapeuta

1. Przed pierwszym użyciem należy dopasować wysokość i szerokość poręczy do swojej toalety.
2. Cofnij się do toalety, korzystając z urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne), aż tylna strona twoich nóg będzie dotykać toalety.
3. Sięgnij do tyłu po poręcz, mocno ją chwyć i powoli opuść się do pozycji siedzącej na toalecie.
4. Aby powrócić do pozycji stojącej, mocno oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się do pozycji stojącej.
5. Gdy już staniesz, stopniowo puść poręcze i dopiero wtedy chwyć za uchwyt urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne).

WAŻNY



1. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.
2. Stosować wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub poluzowanych części.
4. Czyść regularnie łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie osusz.

5. Przed użyciem należy potwierdzić u swojego lekarza, czy produkt spełnia Twoje szczególne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PART LIST

Podczas rozpakowywania tego produktu sprawdź, czy wymienione poniżej części są dołączone i dokładnie sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jakaś część jest uszkodzona lub brakuje jej, nie próbuj montować ani używać produktu.

NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ	NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
①		Nogi	4	⑩		Wiadro z pokrywką	1
②		Rura poręczy	2	⑪		Siedziba	1
③		Rura podsiodłowa	1	⑫		Oparcie	1
④		Lewa rura oparcia	1	⑬		Pokrętło	4
⑤		Prawa rura oparcia	1	⑭		Zestaw śrub	4
⑥		Rura w kształcie litery T	4	⑮		Uchwyt na ręczniki papierowe	1
⑦		Końcówka przyssawki	4	⑯		Torba	1

⑧		R12.7 Szare C-Clipsy	4	⑰		Śrubokręt sześciokątny	1
⑨		R14.3 Białe klipsy C	4	⑱		Klucz sześciokątny	1

PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760636
Główne materiały	Aluminium
Wysokość siedziska	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Siedziba Obciążenie znamionowe	227 kg/500 funtów

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

6. Montaż

1



Uwaga: Przed montażem należy zdjąć gumową osłonę z końcówki przyssawki .


Wsuń rurki w kształcie litery T ⑥ do rurek poręczy ② , jedną po drugiej, wyrównaj je z otworami i zamocuj za pomocą szarych klipsów C ⑧ .

2



Włóż rurę podsiodłową ③ do zamontowanej rury w kształcie litery T w rurze poręczy, wyrównaj ją z otworem i zamocuj za pomocą białych klipsów C ⑨ (2 poziomy regulowanej szerokości).

3

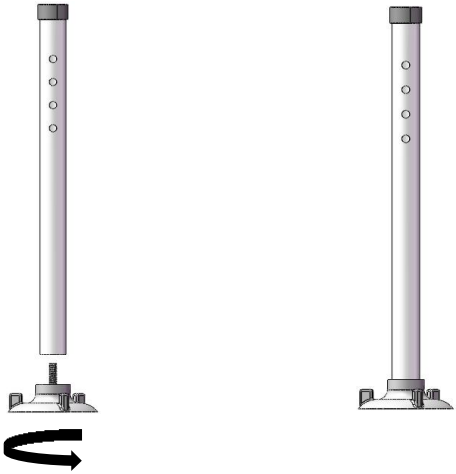

Uwaga: Przed montażem należy zdjąć gumową osłonę z końcówki przyssawki .

Wyrównaj końcówki przyssawek ⑦ z nogami ① i dokręć.

4





Naciśnij ręką przycisk na rurze poręczy i wsuń nogi z przyssawkami w rurki poręczy, jedną po drugiej, aż przycisk wyskoczy (4 poziomy regulacji wysokości) .


5





Wyrównaj lewą rurkę oparcia ④ z prawą rurką oparcia ⑤ oraz dwoma otworami na rurce poręczy, przełóż śruby ⑭ , a następnie dokręć je za pomocą śrubokrętów ⑰ i klucza imbusowego ⑱ .

6

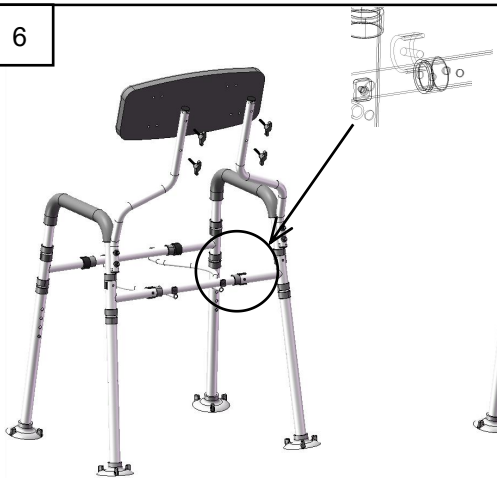



Wyrównaj lewą i prawą rurkę oparcia z otworami oparcia ⑫ i zablokuj je za pomocą pokręteł ⑬ . Istnieją 2 poziomy regulacji szerokości (należy ją ustawić na tym samym poziomie co szerokość ramy siedziska).

7





Umieść wiaderko ⑩ w rurze podsiodłowej.

8



Naciśnij siedzisko ⑪ tak, aby przytwierdziło się do rury podsiodłowej.

9



Jeżeli konieczne jest użycie uchwytu na ręczniki papierowe ⑮ , należy zdjąć jeden z zacisków C na rurce T i włożyć uchwyt na ręczniki papierowe ⑮ .

10





Przywiąż 4 rzepy znajdujące się na torbie ⑯ do rurki poręczy, a torba do przechowywania zostanie zamontowana.

Jak pokazano na rysunku, montaż produktu jest ukończony

2. Instrukcja

1





Zdejmij pokrętła z oparcia, białe klipsy C z siedziska i rury siedziska, pociągnij rurę poręczy w kierunku strzałki, aby wyregulować ją do drugiego poziomu, a następnie załóż z powrotem wyjęte akcesoria, aby zakończyć regulację szerokości (regulacja szerokości w 2 poziomach).

2



Naciśnij przycisk i wysuń nogę, aby dostosować wysokość (4 poziomy regulacji wysokości)

3



Zdejmij górne siedzenie, podnieś je ręcznie otworami do góry, a następnie możesz wyjąć kubełek.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOILET

MODEL: FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760636





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om letsel, productschade of het vervallen van de garantie te voorkomen. Raadpleeg een professional als u ongemak, pijn of verergering van de symptomen ervaart. Zorg indien nodig voor toezicht om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken. Overschrijd de gewichtslimiet niet.

Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Het product moet worden gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakken. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Fysiotherapeut

1. Stel voor het eerste gebruik de hoogte en de breedte van de rail op uw toilet in.
2. Ga met uw hulpmiddel (indien beschikbaar) naar het toilet toe totdat de achterkant van uw benen het toilet raakt .
3. Reik naar achteren naar de leuning, houd deze stevig vast en laat uzelf langzaam zakken tot u op het toilet zit.
4. Om weer rechtop te gaan staan, plaatst u uw handen stevig op de rails en duwt u uzelf omhoog tot u weer rechtop staat.
5. Zodra u staat, laat u de leuningen geleidelijk los en pakt u pas daarna de handgreep van uw hulpmiddel vast (indien beschikbaar).

BELANGRIJK



1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water en spoel eventuele zeepresten af. Droog na het reinigen grondig af.
5. Controleer vóór gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch

advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en controleer ze zorgvuldig op eventuele transportschade. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL	NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
①		Benen	4	⑩		Emmer met deksel	1
②		Leuningbuis	2	⑪		Stoel	1
③		Zitbuis	1	⑫		Rugleuning	1
④		Linker rugleuningbuis	1	⑬		Knop	4
⑤		Rechter rugleuningbuis	1	⑭		Schroevenset	4
⑥		T-vormige buis	4	⑮		Papieren handdoekhouder	1
⑦		Zuignappunt	4	⑯		Tas	1

⑧		R12.7 Grijze C-clips	4	⑰		Zeskantschroevendraaier	1
⑨		R14.3 Witte C-clips	4	⑱		Inbussleutel	1

PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760636
Belangrijkste materialen	Aluminium
Zithoogte	49 0 - 585 mm / 19,3"-23"
Stoel Nominale belasting	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

7. Montage

1



Let op: Verwijder de rubberen huls van de zuignappunt voordat u met de installatie begint .


Steek de T-vormige buizen ⑥ één voor één in de leuningbuizen ② , lijn ze uit met de gaten en zet ze vast met de grijze C - clips ⑧ .

2



Plaats de zitbuis ③ in de geïnstalleerde T-vormige buis in de leuningbuis, lijn deze uit met het gat en bevestig deze met de witte C-clips ⑨ (2 niveaus van verstelbare breedte)

3

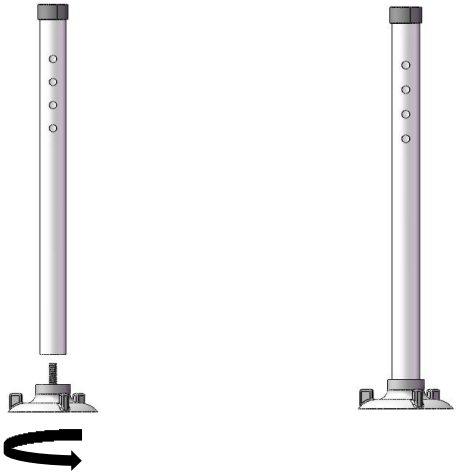

Let op: Verwijder de rubberen huls van de zuignappunt voordat u met de installatie begint .

Lijn de zuignappunten ⑦ uit met de poten ① en draai ze vast.

4





Druk met uw hand op de knop op de leuningbuis en steek de poten met de zuignappunten één voor één in de leuningbuizen totdat de knop eruit springt (4 hoogte-instellingen) .


5





Lijn de linker rugleuningbuis ④ uit met de rechter rugleuningbuis ⑤ en de twee gaten in de leuningbuis, steek de schroeven ⑭ erdoorheen en draai ze vervolgens vast met de schroevendraaiers ⑰ en inbussleutel ⑱ .

6

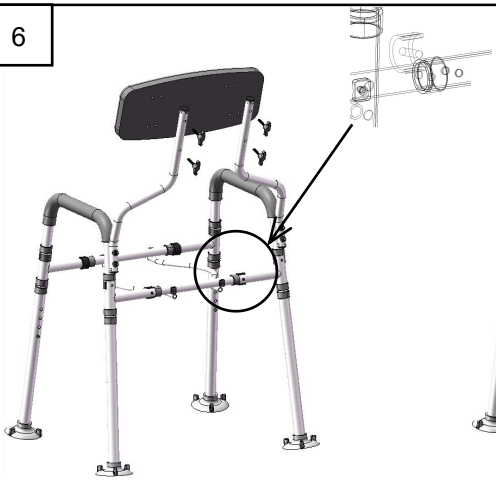



Lijn de linker- en rechterrugleuningbuizen uit met de gaten in de rugleuning ⑫ en vergrendel ze met de knoppen ⑬ . Er zijn twee niveaus om de breedte aan te passen (deze moet op hetzelfde niveau worden afgesteld als de breedte van het zitframe).

7





Plaats de emmer ⑩ in de zitbuis.

8



Druk de zitting ⑪ naar beneden zodat de zitting vastzit op de zitbuis.

9



Als u een keukenrolhouder ⑮ moet gebruiken , verwijdert u een van de C-clips op de T-buis en plaatst u de keukenrolhouder ⑮ .

10





Maak de 4 klittenbandsluitingen van de tas ⑯ vast aan de leuningbuis en de opbergtas is gemonteerd.

Zoals in de afbeelding is weergegeven, is de productassemblage voltooid

2. Instructie

1





Verwijder de knoppen op de rugleuning, de witte C-clips op de zitting en de zitbuis, trek de leuningbuis in de richting van de pijl om deze op het tweede niveau af te stellen en plaats vervolgens de verwijderde accessoires terug om de breedteverstelling te voltooien (breedteverstelling op 2 niveaus)

2



Druk op de knop en trek het pootje uit om de hoogte aan te passen (4 niveaus van hoogteverstelling)

3



Haal de bovenste stoel eraf, til de stoel met de gaten met de hand omhoog en dan kun je de emmer eruit halen.

Zhongshan Bliss Medisch Instrument Co., Ltd.
Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMOD

MODELL: FBL76063 6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELL: FBL760636





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs hela manualen för att undvika skada, produktskador eller att garantin inte gäller. Sök professionell hjälp om du upplever obehag, smärta eller förvärrade symtom. Om det behövs, använd övervakning för att montera och använda produkten korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.
Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

Fysioterapeut

1. Justera skenans höjd och bredd efter din toalett före första användningen.
2. Backa upp till toaletten med ditt hjälpmedel (om tillgängligt) tills baksidan av dina ben nuddar toaletten.
3. Sträck dig bakåt efter toalettstången, håll fast den och sänk dig långsamt ner i sittande position på toaletten.
4. För att återgå till stående position, placera händerna ordentligt på skenorna och tryck dig upp till stående position.
5. När du står upp, släpp gradvis taget om skenorna och först då tar du tag i handtaget på ditt hjälpmedel (om det finns ett).



VIKTIG

1. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten och skölj bort eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PART LIST

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera dem noggrant för att se om det finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

ING A	BILD	NAMN	ANTAL	ING A	BILD	NAMN	ANTAL
①		Ben	4	⑩		Hink med lock	1
②		Ledstångsrör	2	⑪		Plats	1
③		Sadelrör	1	⑫		Ryggstöd	1
④		Vänster ryggstödsrör	1	⑬		Knopp	4
⑤		Höger ryggstödsrör	1	⑭		Skruvsats	4
⑥		T-format rör	4	⑮		Hållare för pappershanddukar	1
⑦		Sugkoppens spets	4	⑯		Väska	1
⑧		12,7 kr Grå C-klämmor	4	⑰		Sexkantskruvmejsel	1

⑨		R14.3 Vita C-klämmor	4	⑱		Sexkantsnyckel	1

PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760636**
Huvudmaterial	Aluminium
Sitthöjd	49 0 - 585 mm/19,3"-23"
Plats Nominell belastning	227 kg/500 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

8. Montering

1



Obs! Ta bort gummihylsan från sugkoppens spets före installation .

För in T - rören ⑥ i ledstångsrören ② ett i taget, rikta in dem med hålen och fäst dem med de grå C - klämmorna ⑧ .


2






Sätt in sadelröret ③ i det monterade T-formade röret i ledstångsröret, rikta in det med hålet och fäst det med de vita C-klämmorna ⑨ (2 nivåer med justerbar bredd)

3





Obs! Ta bort gummihylsan från sugkoppens spets före installation .

Rikta in sugkoppens spetsar ⑦ med benen ① och dra åt dem.

4





Tryck på knappen på räckets rör med handen och för in benen med sugkoppsspetsarna i räckets rör ett i taget tills knappen hoppar ut (4 justerbara höjdnivåer) .


5





Rikta in det vänstra ryggstödsröret ④ med det högra ryggstödsröret ⑤ och de två hålen på ledstödsröret, för in skruvarna ⑭ och dra sedan åt dem med skruvmejslarna ⑰ och insexnyckeln ⑱ .

6

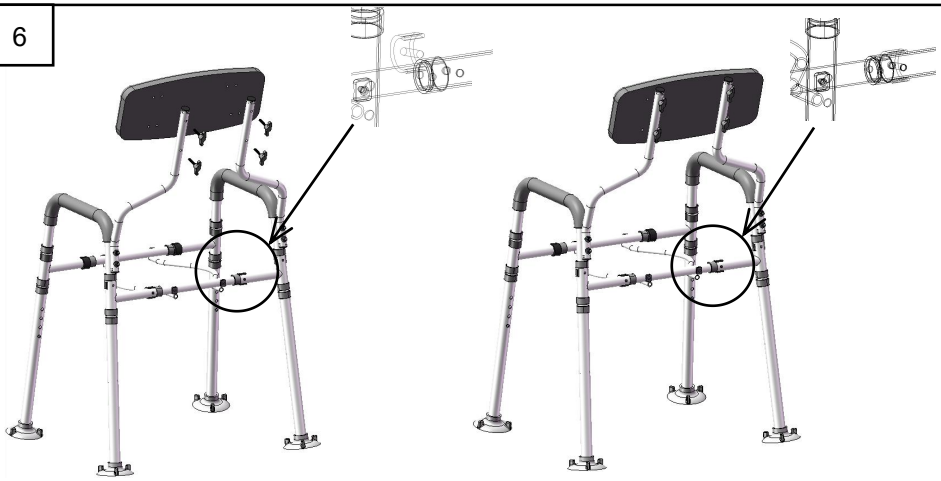

Rikta in vänster och höger ryggstödsrör med hålen i ryggstödet ⑫ och lås dem med vreden ⑬ . Det finns 2 nivåer för att justera bredden (detta måste justeras till samma nivå som sitsramens bredd)

7



Placera hinken ⑩ i sadelröret.

8



Tryck ner sadeln ⑪ så att sadeln sitter fast på sadelröret.

9



Om du behöver använda en pappershanddukshållare ⑮ , ta bort ett av C-klämmorna på T-röret och sätt i pappershanddukshållaren ⑮ .

10





Knyt de fyra kardborrbanden på påsen ⑯ till ledstångsröret, så är förvaringspåsen installerad.

Som visas på bilden är produktmonteringen klar

2. Instruktion

1





Ta bort knopparna på ryggstödet, de vita C-klämmorna på sitsen och sitsröret, dra ledstångsröret i pilens riktning för att justera det till den andra nivån och sätt sedan tillbaka de borttagna tillbehören för att slutföra breddjusteringen (2-nivås breddjustering)

2



Tryck på knappen och dra ut benet för att justera höjden (4 nivåer av höjdjustering)

3



Ta bort det övre sätet, lyft sätet med hål uppåt för hand, och sedan kan du ta ut hinken.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Adress: 3-6F och 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.