VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINER

MODEL:D574-BR

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINER

MODEL: D574-BR




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lock the Caster wheels. Remove the protective cover.Flip the recliner lock bar to the specified position.(from step1 to step2)

2. Slide the back assembly into the square tubes of the lower frame assembly so that the holes in the back rest line up with the holes located on horizontal brace of the lower frame assembly. (from step2 to step3)


3. Insert screws through holes of the horizontal brace and tighten all screws with screwdriver.(from step2 to step3)

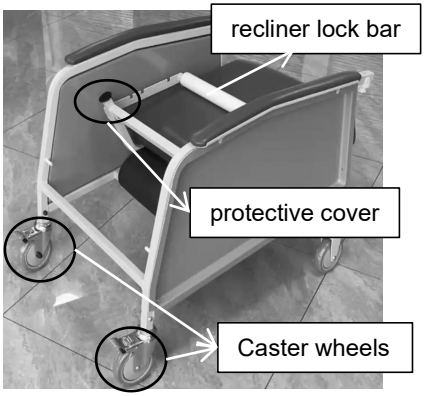


Step 1



Step 2

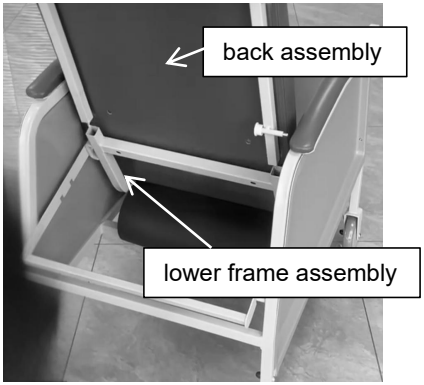

Step 3

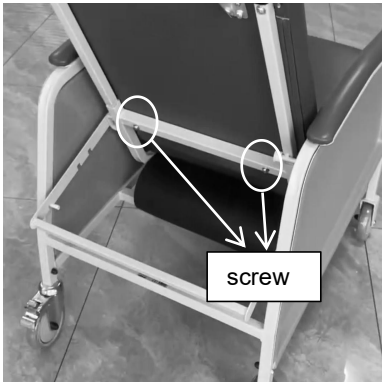

Step 4

Figure 1

NOTE: Make sure that the screw on both sides of the back assembly are sufficiently secure before using recliner.

NOTE: Periodically inspect all parts and replace as needed . Occupant weight should not exceed 250 lbs.

Caster wheels should be locked during occupant transfer.

OPERATING INSTRUCTIONS1

1. TO PLACE UNIT IN RECLINING POSITION

1) Ensure that recliner lock bar is in stored position. See fig.2.
2) Stand at either side of recliner.
3) Grasp armrest with one hand,and PVC push bar(J).
4) Push down on push bar to recline the back to the first recline position, push on push bar again to achieve second and third recline position.
5) To raise upright, pull forward on push bar.
6) Set recliner Lock Bar(F).

NOTE: The table can only be used in upright sitting position.

Patient should be transported in reclined position with recliner lock set.

2. RECLINING LOCK OPERATION

To lock recliner:

1) Place recliner into desired position.
2) Pull out Lock-Release Pull Button(G) to release Lock bar (F) from stored position.
3) Rotate recliner Lock Bar(F)down until notches are fully engaged over Locking Pins(H).

To unlock recliner:

1) Lift recliner lock bar(F) up to disengage from Locking Pins.
2) While holding Lock-Release Pull Button(G) out,rotate recline Lock Bar (F)all the way up until completely against seat back.
3) Release Lock-Release Pull Button(G) to hold recliner Lock Bar in stored position.

NOTE: Do not attempt to change position of chair with recliner lock bar engaged. This could cause damage to mechanism.

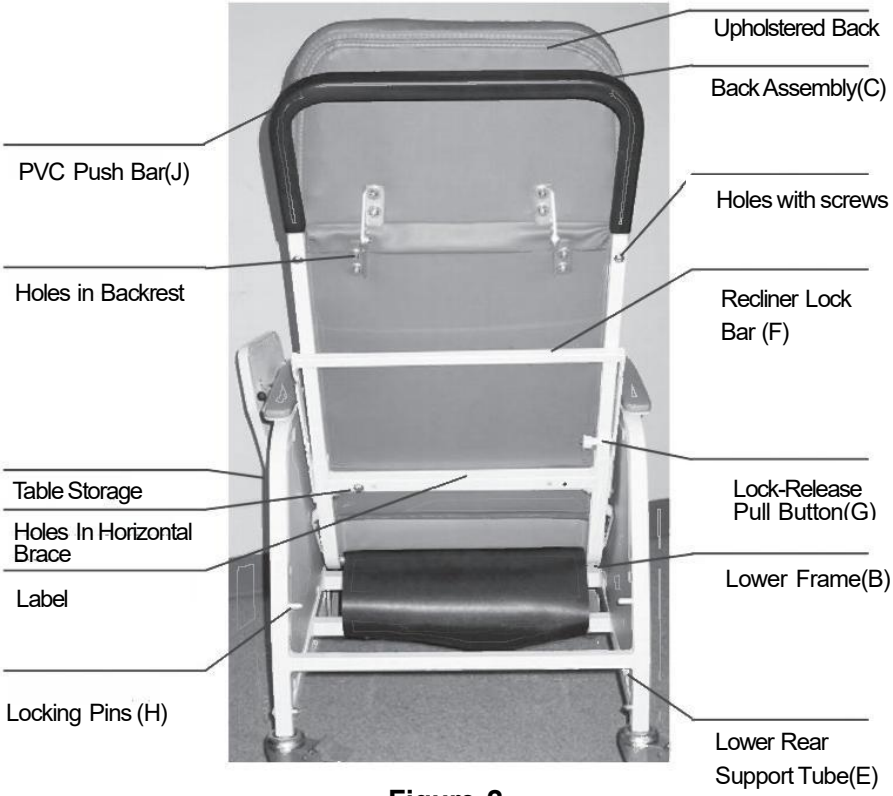


Figure 2

OPERATING INSTRUCTIONS2

3. TO ADJUST ARTICULATING HEADREST:

Articulating headrest may be adjusted to desired position by pulling forward or pushing back.

4. TO OPERATE TABLE:

1) Underneath each arm, pull down and hold pull button(Fig.3 A&B)and slide lockout keys forward on both sides (D).
2) Pick up table by circular table arm and slide into receiving lubes in front of each arm.
3) Table can slide on and off by keeping lock/lockout key forward.

4) Table can be locked into one of five positions.Pull down the pull button, hold the pull button and slide the key backwards.Proceed to the other arm and move that key backwards Table will now be locked.

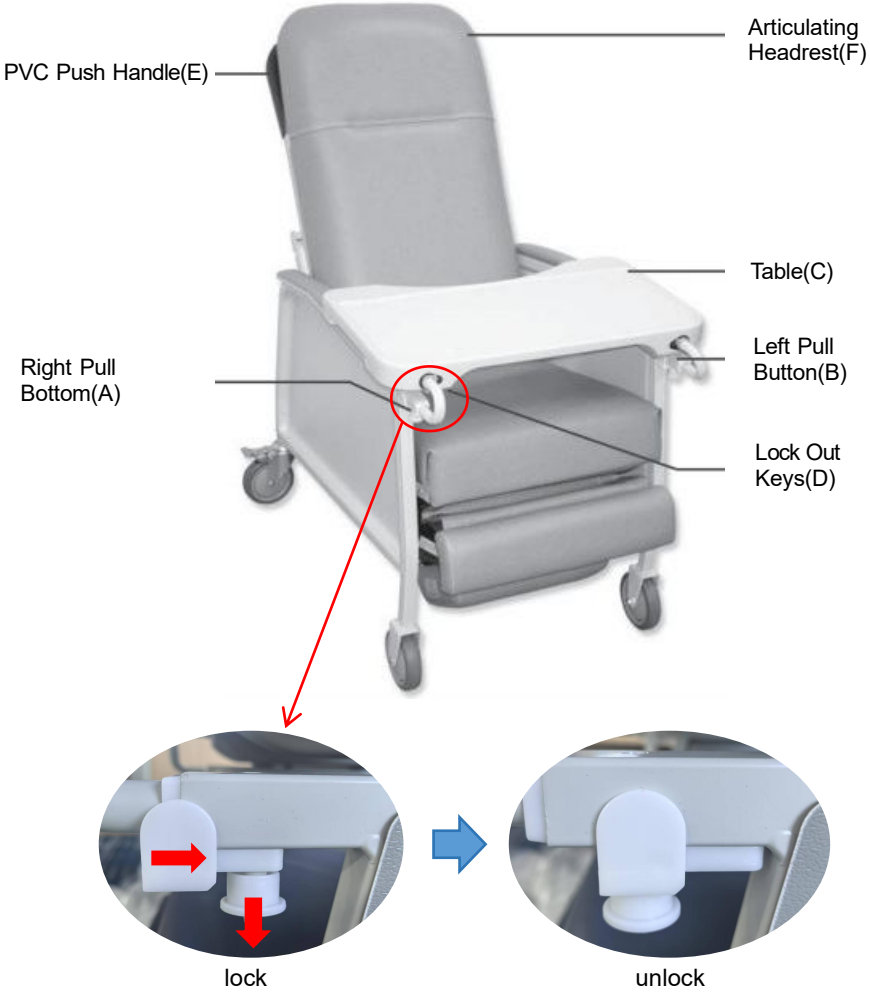


Figure 3

NOTE: This chair is equipped with two swivel rear casters for improved maneuverability. They are also equiped with locking features.


5. CASTERS LOCK OPERATION

To lock casters:


To prevent the rear casters from turning, step on the rear pedal of the caster until the pedal engages. (Front of pedal will protrude from wheel cover).

To unlock casters:

Step on the protruding front part of the pedal to disengage lock to unlatch.

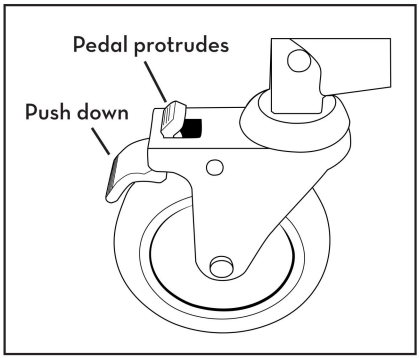

To Lock

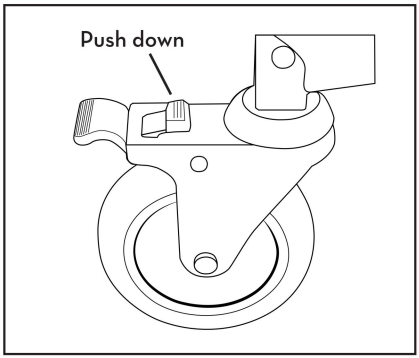

To Unlock

Figure 4

CAUTION:

Do not operate recliner by applying force or pressure to the legrest. Avoid placing hands or legs in creases near recliner mechanism.

Casters must be locked except during transport.

MAINTENANCE&CLEANING

EVERY THREE MONTHS

Check and clean casters/Tighten nuts/Check brakes on casters/Check and clean lock recline mechanism

For upholstery maintenance and stain removal, the following hints will be helpful:

Ordinary dirt: Wash with warm awater and a mild soap or detergent.

Stubbon dirt: Using a soff bristle brush, follow directions above.

Ground-in dirt: Scrub with powdered cleanser or similar detergent.

Chewing gum: Scrape carefully.

Nail polish and remover: Blot immediately to prevent damage.

Ball point pen: Blot immediately with a white cloth dampened in watch or mineral oil.
Waxing and reffnishing: Improver wearability. Use any quality paste wax.
A diluted solution of 10% (or less) of bleach or clorox may be used when cleaning this chair.

Manufacturer: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd
Address: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province,214400,China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL INCLINABLE

MODÈLE : D574-BR

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL INCLINABLE

MODÈLE : D574-BR



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Verrouillez les roulettes. Retirez le couvercle de protection. Placez la barre de verrouillage du fauteuil inclinable dans la position souhaitée (étape 1 à étape 2).

2. Faites glisser l'ensemble du dossier dans les tubes carrés de l'ensemble du cadre inférieur de sorte que les trous du dossier soient alignés avec les trous situés sur le support horizontal de l'ensemble du cadre inférieur. (de l'étape 2 à l'étape 3)

3. Insérez les vis dans les trous du support horizontal et serrez toutes les vis avec un tournevis. (de l'étape 2 à l'étape 3)

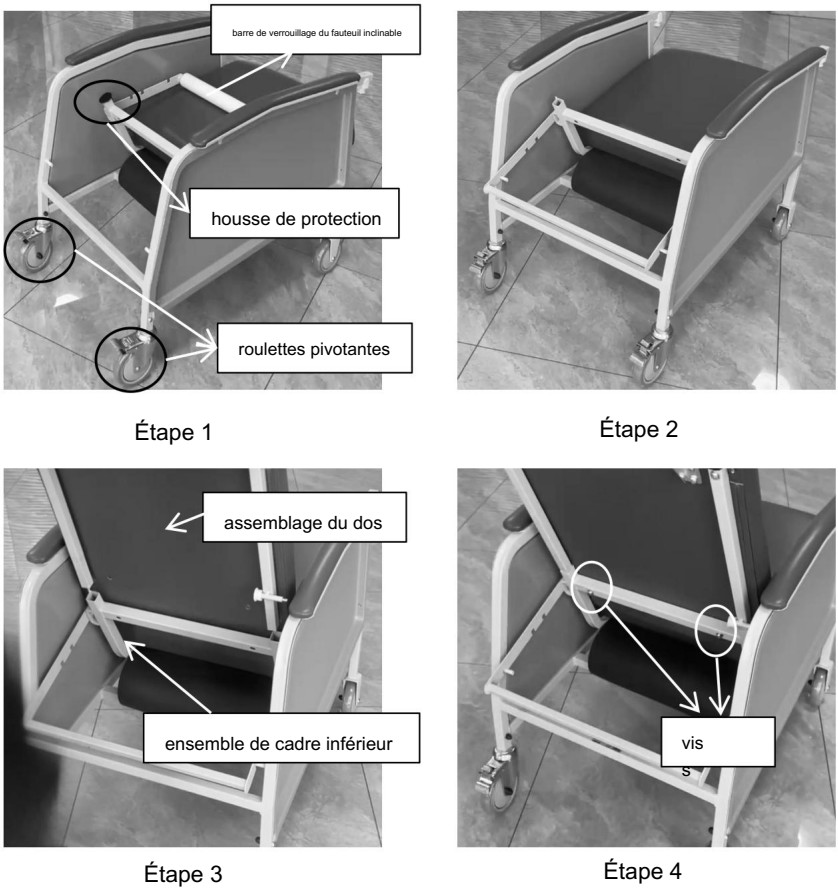


Figure 1

Machine Translated by Google

REMARQUE : Assurez-vous que les vis des deux côtés de l'assemblage arrière sont

suffisamment sécurisé avant d'utiliser le fauteuil inclinable.

REMARQUE : Inspectez périodiquement toutes les pièces et remplacez-les si nécessaire. Poids de l'occupant

ne doit pas dépasser 250 lb.

Les roulettes pivotantes doivent être verrouillées pendant le transfert de l'occupant.

MODE D'EMPLOI1

1. POUR PLACER L'UNITÉ EN POSITION INCLINÉE

1) Assurez-vous que la barre de verrouillage du fauteuil inclinable est en position de rangement. Voir fig. 2.

2) Placez-vous de chaque côté du fauteuil inclinable.

3) Saisissez l'accoudoir d'une main et la barre de poussée en PVC (J).

4) Appuyez sur la barre de poussée pour incliner le dossier jusqu'à la première position d'inclinaison, poussez

Appuyez à nouveau sur la barre de poussée pour atteindre la deuxième et la troisième position d'inclinaison.

5) Pour relever la verticale, tirez vers l'avant sur la barre de poussée.

6) Réglez la barre de verrouillage du fauteuil inclinable (F).

REMARQUE : La table ne peut être utilisée qu'en position assise droite.

Le patient doit être transporté en position inclinée avec le verrouillage du fauteuil inclinable réglé.

2. FONCTIONNEMENT DU VERROUILLAGE INCLINABLE

Pour verrouiller le fauteuil inclinable :

1) Placez le fauteuil inclinable dans la position souhaitée.

2) Tirez sur le bouton de déverrouillage (G) pour libérer la barre de verrouillage (F) de sa position stockée.

position.

3) Faites pivoter la barre de verrouillage du fauteuil inclinable (F) vers le bas jusqu'à ce que les encoches soient complètement engagées sur le verrouillage

Broches (H).

Pour déverrouiller le fauteuil inclinable :

1) Soulevez la barre de verrouillage du fauteuil inclinable (F) pour la dégager des goupilles de verrouillage.

2) Tout en maintenant le bouton de déverrouillage (G) enfoncé, faites pivoter la barre de verrouillage d'inclinaison (F) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

jusqu'à ce qu'il soit complètement contre le dossier du siège.

3) Relâchez le bouton de verrouillage (G) pour maintenir la barre de verrouillage du fauteuil inclinable en place

position.

REMARQUE : N'essayez pas de changer la position du fauteuil lorsque la barre de verrouillage du fauteuil inclinable est engagée.

Cela pourrait endommager le mécanisme.

Machine Translated by Google

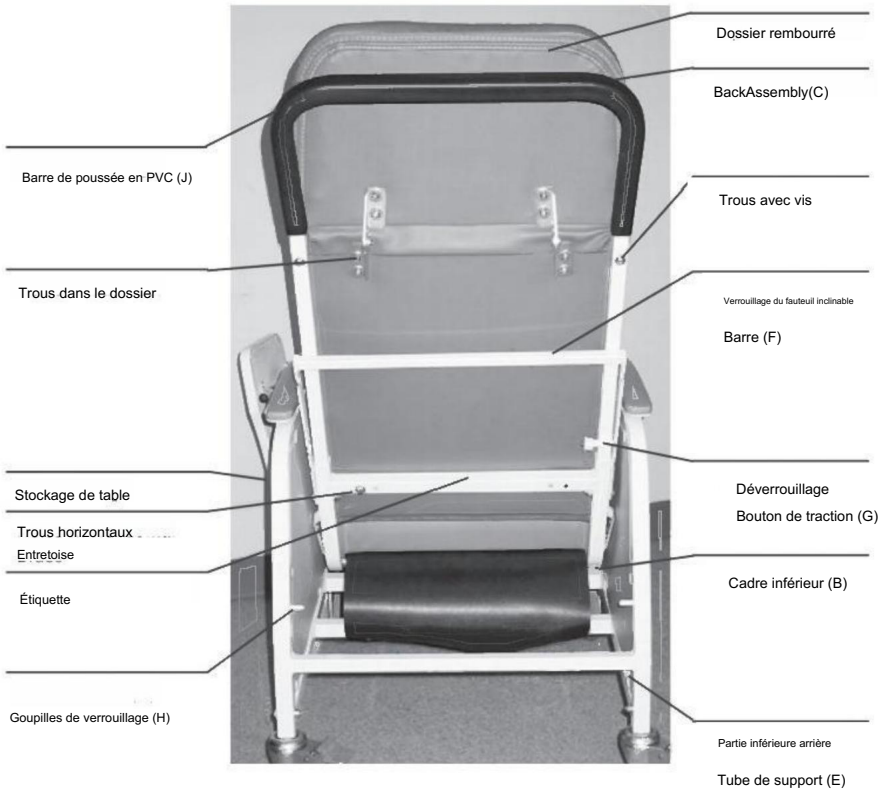


Figure 2

MODE D'EMPLOI2

3. POUR RÉGLER L'APPUI-TÊTE ARTICULÉ :

L'appui-tête articulé peut être réglé à la position souhaitée en tirant vers l'avant ou en poussant vers l'arrière.

4. POUR UTILISER LA TABLE : 1)

Sous chaque bras, tirez vers le bas et maintenez le bouton de traction (Fig. 3 A et B) et faites glisser clés de verrouillage vers l'avant des deux côtés (D).

2) Prenez la table par le bras circulaire de la table et faites-la glisser dans le récipient de réception des lubrifiants devant chaque bras.

3) La table peut coulisser vers le haut et vers le bas en maintenant la clé de verrouillage/déverrouillage vers l'avant.

Machine Translated by Google

4) La table peut être verrouillée dans l'une des cinq positions. Abaissez le bouton de traction, maintenez le bouton de traction et faites glisser la clé vers l'arrière. Passez à l'autre bras et déplacez cette clé vers l'arrière. La table sera maintenant verrouillée.

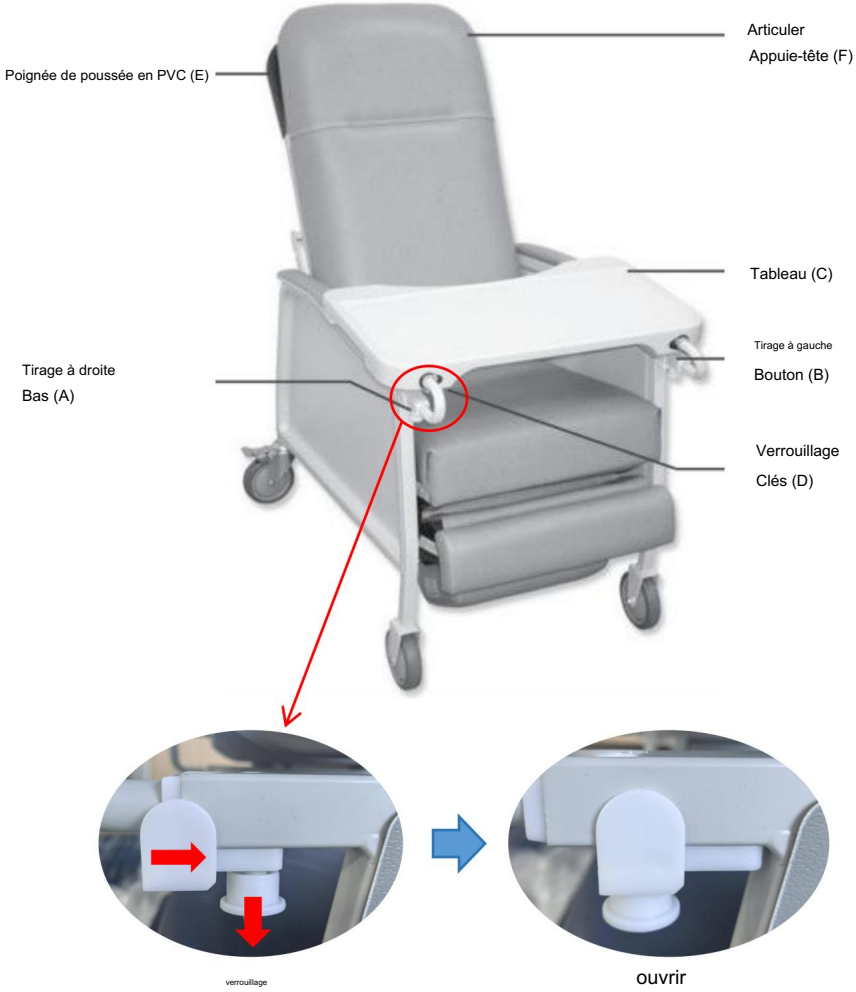


Figure 3

REMARQUE : Ce fauteuil est équipé de deux roulettes arrière pivotantes pour une meilleure maniabilité. Elles sont également équipées de dispositifs de verrouillage.

Machine Translated by Google

5. FONCTIONNEMENT DU VERROUILLAGE DES ROULETTES

Pour verrouiller les roulettes :

Pour éviter que les roulettes arrière ne tournent, appuyez sur la pédale arrière de la roulette jusqu'à ce que la pédale s'engage. (L'avant de la pédale dépassera du couvre-roue).

Pour déverrouiller les roulettes :

Appuyez sur la partie avant saillante de la pédale pour déverrouiller le verrou.

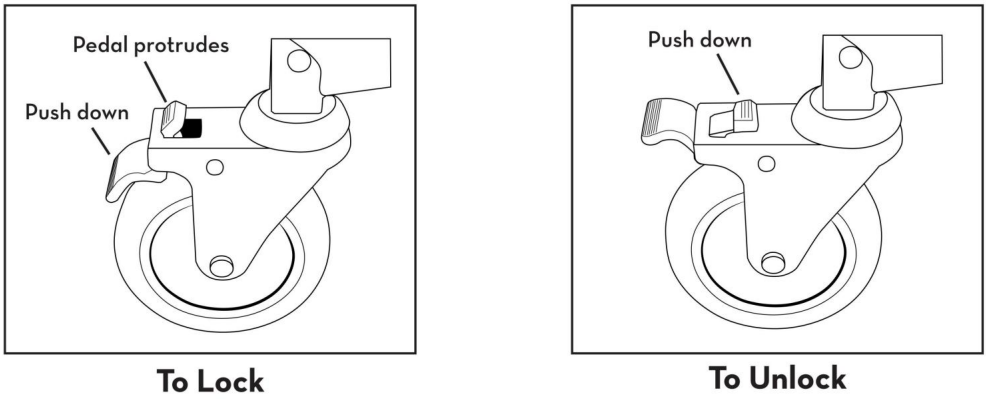


Figure 4

PRUDENCE:

N'utilisez pas le fauteuil inclinable en appliquant une force ou une pression sur le repose-jambes. Évitez de placer mains ou jambes dans les plis près du mécanisme du fauteuil inclinable.

Les roulettes doivent être verrouillées sauf pendant le transport.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

TOUS LES TROIS MOIS

Vérifier et nettoyer les roulettes/Serrer les écrous/Vérifier les freins des roulettes/Vérifier et nettoyer mécanisme d'inclinaison de verrouillage

Pour l'entretien des tissus d'ameublement et l'élimination des taches, les conseils suivants vous seront utiles :

Saleté ordinaire : laver avec de l'eau tiède et un savon ou un détergent doux.

Saleté tenace : à l'aide d'une brosse à poils doux, suivez les instructions ci-dessus.

Saleté incrustée : frotter avec un nettoyant en poudre ou un détergent similaire.

Chewing-gum : grattez soigneusement.

Vernis à ongles et dissolvant : Tamponnez immédiatement pour éviter tout dommage.

Machine Translated by Google

Stylo à bille : Tamponnez immédiatement avec un chiffon blanc imbibé d'huile de montre ou de minéraux huile.

Cirage et finition : Améliore la résistance à l'usure. Utiliser une cire en pâte de qualité.

Une solution diluée à 10 % (ou moins) d'eau de Javel ou de Clorox peut être utilisée lors du nettoyage. cette chaise.

Fabricant : Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adresse : No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Liegesessel

MODELL:D574-BR

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Liegesessel

MODELL: D574-BR



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


Machine Translated by Google

MONTAGEANLEITUNG

1. Sperren Sie die Lenkrollen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung. Klappen Sie die Verriegelung des Ruhesessels in die angegebene Position (von Schritt 1 bis Schritt 2).

2. Schieben Sie die Rückenlehne in die Vierkantrohre der unteren Rahmenbaugruppe, sodass die Löcher in der Rückenlehne mit den Löchern in der horizontalen Strebe der unteren Rahmenbaugruppe übereinstimmen. (von Schritt 2 bis Schritt 3)


3. Führen Sie die Schrauben durch die Löcher der horizontalen Strebe und ziehen Sie alle Schrauben mit einem Schraubendreher fest. (von Schritt 2 bis Schritt 3)

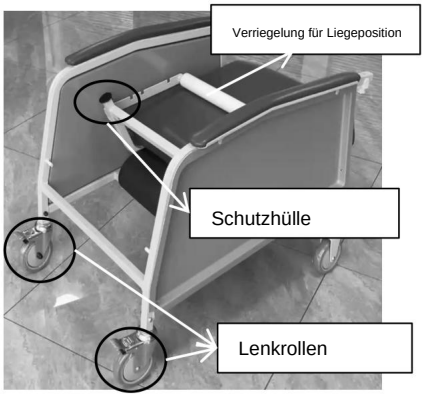


Schritt 1



Schritt 2

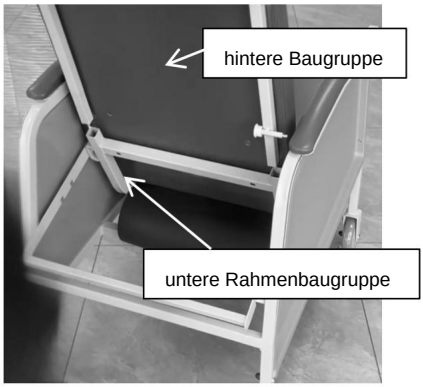

Schritt 3

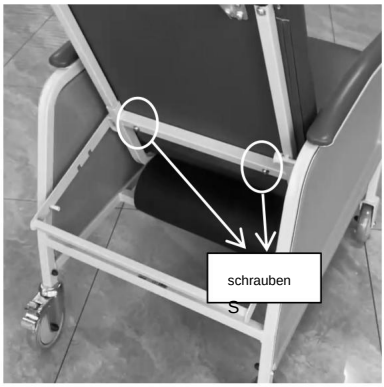

Schritt 4

Abbildung 1

Machine Translated by Google

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Schrauben auf beiden Seiten der Rückwand

Sichern Sie den Ruhesessel vor der Verwendung ausreichend.

HINWEIS: Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

sollte 250 Pfund nicht überschreiten.

Während des Personentransfers sollten die Lenkrollen blockiert sein.

BEDIENUNGSANLEITUNG1

1. DAS GERÄT IN DIE LIEGEPOSITION BRINGEN

1) Stellen Sie sicher, dass sich die Verriegelung der Rückenlehne in der Ruheposition befindet. Siehe Abb. 2.

2) Stellen Sie sich auf eine der beiden Seiten des Liegesessels.

3) Greifen Sie mit einer Hand die Armlehne und die PVC-Schiebestange (J).

4) Drücken Sie die Schubstange nach unten, um die Rückenlehne in die erste Liegeposition zu bringen, drücken Sie

Drücken Sie die Schubstange erneut, um die zweite und dritte Liegeposition zu erreichen.

5) Um aufzurichten, ziehen Sie die Schubstange nach vorne.

6) Stellen Sie die Verriegelung (F) des Liegestuhls ein.

HINWEIS: Der Tisch kann nur in aufrechter Sitzposition verwendet werden.

Der Patient sollte in liegender Position und mit aktivierter Liegeverriegelung transportiert werden.

2. Bedienung der Liegeverriegelung

So verriegeln Sie den Ruhesessel:

1) Bringen Sie den Sessel in die gewünschte Position.

2) Ziehen Sie den Entriegelungsknopf (G) heraus, um den Riegel (F) aus der

Position.

3) Drehen Sie die Verriegelung (F) des Ruhesessels nach unten, bis die Kerben vollständig über der Verriegelung eingerastet sind

Stifte (H).

So entsperren Sie den Ruhesessel:

1) Heben Sie die Verriegelung (F) der Liege nach oben, um sie von den Verriegelungsstiften zu lösen.

2) Halten Sie den Entriegelungsknopf (G) gedrückt und drehen Sie die Neigungsverriegelungsstange (F) ganz

ganz nach oben, bis es vollständig an der Rückenlehne anliegt.

3) Lassen Sie den Entriegelungsknopf (G) los, um die Verriegelung des Ruhesessels in der verstauten Position zu halten.

Position.

HINWEIS: Versuchen Sie nicht, die Position des Stuhls zu ändern, wenn die Verriegelung der Rückenlehne eingerastet ist.

Dies könnte zu Schäden am Mechanismus führen.

Machine Translated by Google

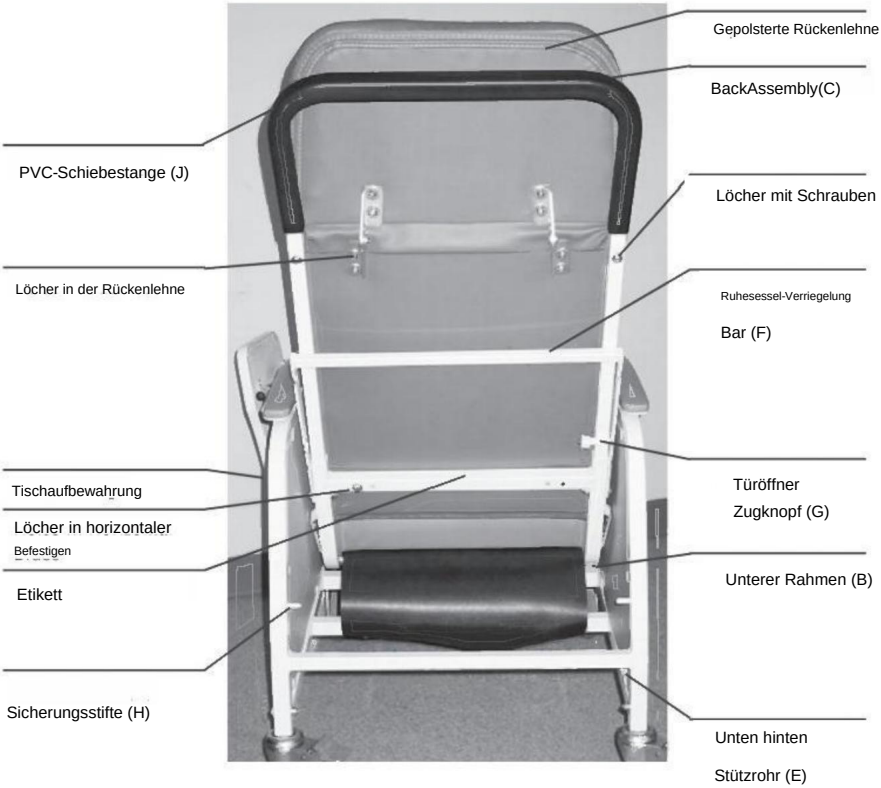


Abbildung 2

BEDIENUNGSANLEITUNG2

3. So stellen Sie die bewegliche Kopfstütze ein:

Die bewegliche Kopfstütze kann durch Ziehen nach vorne oder Drücken nach hinten in die gewünschte Position gebracht werden.

4. BEDIENUNG DES TISCHES: 1)

Unter jedem Arm den Zugknopf nach unten ziehen und halten (Abb. 3 A&B) und schieben
Sperrschlüssel auf beiden Seiten nach vorne (D).

2) Den Tisch mit dem runden Tischarm anheben und in die Aufnahme der Schmiermittel vor dem
jeden Arm.

3) Der Tisch kann auf- und abgeschoben werden, indem der Verriegelungs-/Sperrschlüssel nach vorne gehalten wird.

Machine Translated by Google

4) Der Tisch kann in einer von fünf Positionen arretiert werden. Ziehen Sie den Zugknopf nach unten, halten Sie den Zugknopf gedrückt und schieben Sie den Schlüssel nach hinten. Gehen Sie zum anderen Arm und bewegen Sie den Schlüssel nach hinten. Der Tisch ist jetzt arretiert.

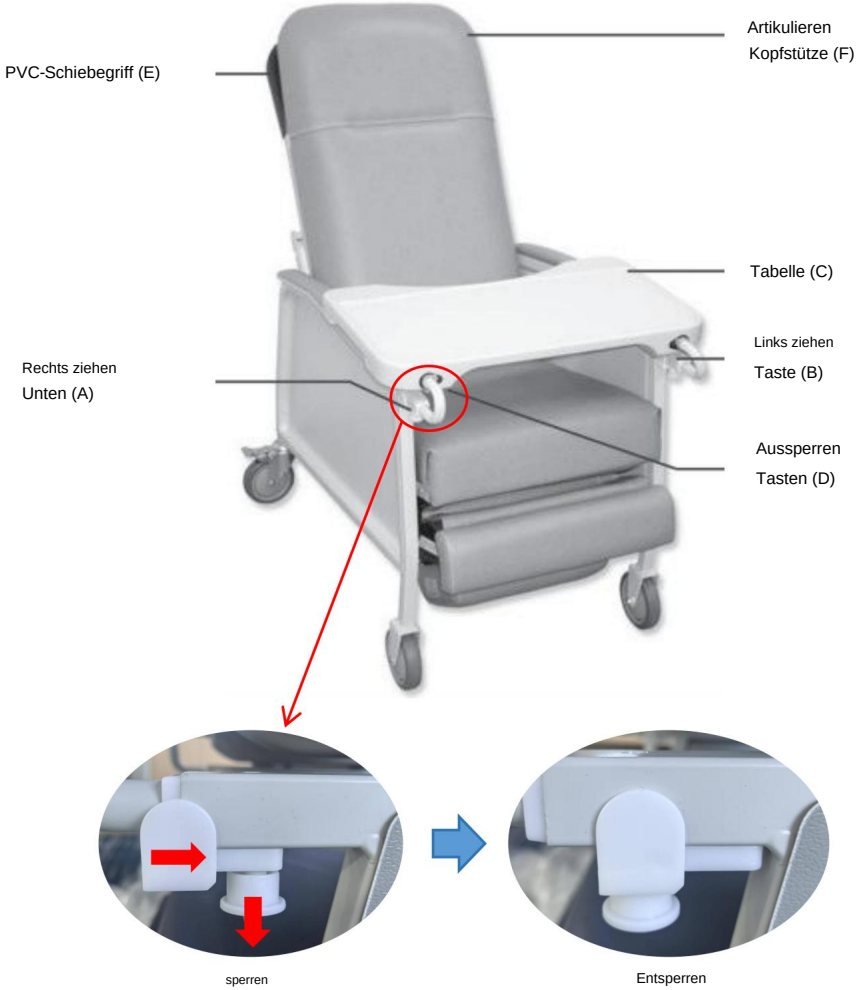


Abbildung 3

HINWEIS: Dieser Stuhl ist für eine bessere Manövrierfähigkeit mit zwei Lenkrollen hinten ausgestattet. Sie verfügen außerdem über Feststellvorrichtungen.

Machine Translated by Google

5. FESTSTELLFUNKTION DER ROLLEN

So arretieren Sie die Rollen:

Um zu verhindern, dass sich die hinteren Lenkrollen drehen, treten Sie auf das hintere Pedal der Lenkrolle, bis

das Pedal rastet ein. (Die Vorderseite des Pedals ragt aus der Radabdeckung heraus).

So entsperren Sie Rollen:

Um die Sperre zu lösen und zu entriegeln, treten Sie auf den hervorstehenden vorderen Teil des Pedals.

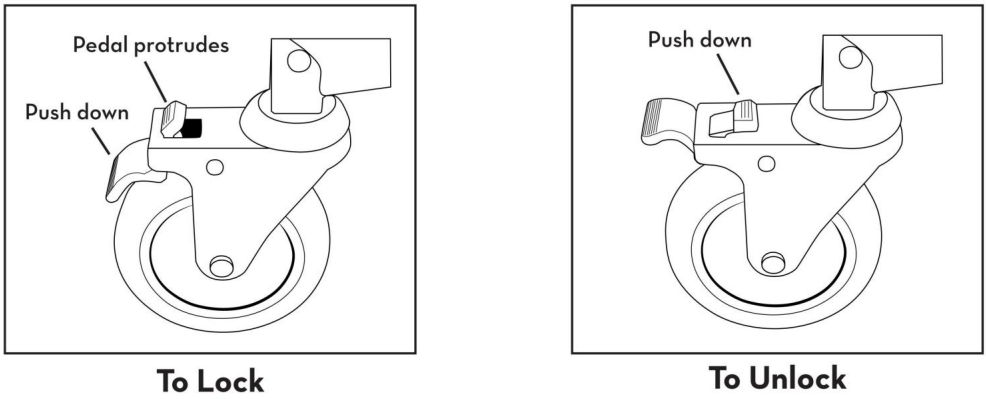


Abbildung 4

VORSICHT:

Bedienen Sie den Ruhesessel nicht durch Krafteinwirkung oder Druck auf die Beinstütze. Vermeiden Sie es,

Hände oder Beine in Falten in der Nähe des Liegemechanismus.

Außer während des Transports müssen die Rollen festgestellt werden.

WARTUNG & REINIGUNG

ALLE DREI MONATE

Rollen prüfen und reinigen/Muttern festziehen/Bremsen an den Rollen prüfen/Prüfen und reinigen

Verriegelungsmechanismus für die Neigung

Zur Polsterpflege und Fleckenentfernung sind folgende Hinweise hilfreich:

Normaler Schmutz: Mit warmem Wasser und einer milden Seife oder einem milden Reinigungsmittel waschen.

Hartnäckiger Schmutz: Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten und befolgen Sie die obigen Anweisungen.

Festsitzender Schmutz: Mit Pulverreiniger oder einem ähnlichen Reinigungsmittel schrubben.

Kaugummi: Vorsichtig abkratzen.

Nagellack und Nagellackentferner: Sofort abtupfen, um Schäden zu vermeiden.

Machine Translated by Google

Kugelschreiber: Sofort mit einem in Uhren- oder Mineralwasser getränkten weißen Tuch abtupfen
Öl.

Wachsen und Nachbearbeiten: Verbessert die Tragbarkeit. Verwenden Sie ein hochwertiges Pastenwachs.

Eine verdünnte Lösung von 10 % (oder weniger) Bleichmittel oder Clorox kann zum Reinigen verwendet werden dieser Stuhl.

Hersteller: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd.

Adresse: Nr. 589 Hualu Road, Stadt Jiangyin, Stadt Wuxi, Jiangsu
Provinz, 214400, China

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLTRONA RECLINABILE

MODELLO:D574-BR

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLTRONA RECLINABILE

MODELLO: D574-BR



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Bloccare le ruote girevoli. Rimuovere la copertura protettiva. Girare la barra di blocco della poltrona reclinabile nella posizione specificata. (dal passaggio 1 al passaggio 2)

2. Far scorrere il gruppo posteriore nei tubi quadrati del gruppo telaio inferiore in modo che i fori nello schienale siano allineati con i fori situati sul rinforzo orizzontale del gruppo telaio inferiore. (dal passaggio 2 al passaggio 3)


3. Inserire le viti attraverso i fori del supporto orizzontale e serrare tutte le viti con il cacciavite (dal passaggio 2 al passaggio 3).

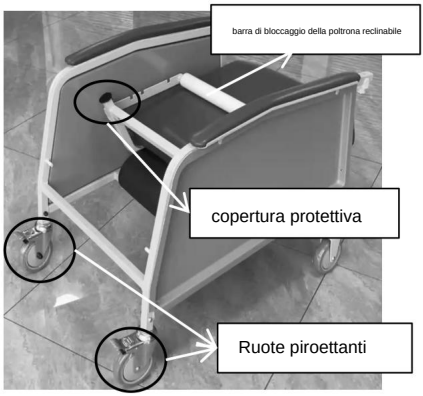


Passo 1



Passo 2

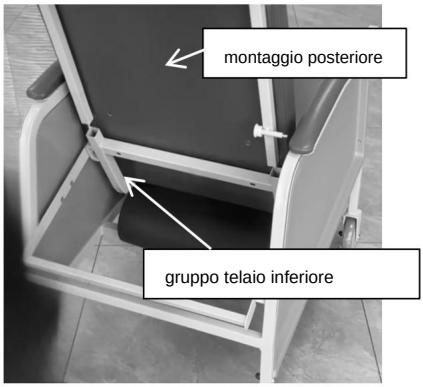

Passo 3

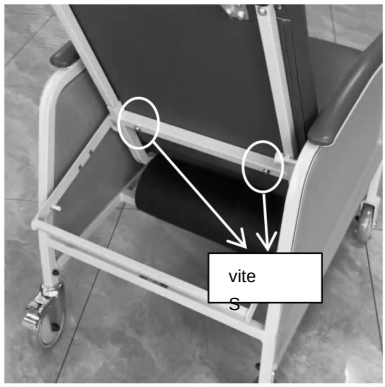

Passo 4

Figura 1

Machine Translated by Google

NOTA: assicurarsi che le viti su entrambi i lati del gruppo posteriore siano

sufficientemente sicuro prima di utilizzare la poltrona reclinabile.

NOTA: ispezionare periodicamente tutte le parti e sostituirle se necessario. Peso dell'occupante

non dovrebbe superare le 250 libbre.

Le ruote girevoli devono essere bloccate durante il trasferimento degli occupanti.

ISTRUZIONI PER L'USO1

1. PER POSIZIONARE L'UNITÀ IN POSIZIONE RECLINABILE

1) Assicurarsi che la barra di bloccaggio della poltrona reclinabile sia in posizione di riposo. Vedere fig.2.

2) Posizionarsi ai lati della poltrona reclinabile.

3) Afferrare il bracciolo con una mano e la barra di spinta in PVC (J).

4) Spingere verso il basso la barra di spinta per reclinare lo schienale fino alla prima posizione di reclinazione, spingere

nuovamente sulla barra di spinta per raggiungere la seconda e la terza posizione di reclinazione.

5) Per sollevare il dispositivo in posizione verticale, tirare in avanti la barra di spinta.

6) Impostare la barra di bloccaggio della poltrona reclinabile (F).

NOTA: il tavolo può essere utilizzato solo in posizione seduta eretta.

Il paziente deve essere trasportato in posizione reclinata con il blocco della reclinazione impostato.

2. FUNZIONAMENTO DEL BLOCCO RECLINABILE

Per bloccare la poltrona reclinabile:

1) Posizionare la poltrona reclinabile nella posizione desiderata.

2) Estrarre il pulsante di sblocco e rilascio (G) per rilasciare la barra di blocco (F) dalla posizione di memorizzazione

posizione.

3) Ruotare la barra di bloccaggio della poltrona reclinabile (F) verso il basso fino a quando le tacche non sono completamente inserite sul bloccaggio

Perni (H).

Per sbloccare la poltrona reclinabile:

1) Sollevare la barra di bloccaggio della poltrona reclinabile (F) per sganciarla dai perni di bloccaggio.

2) Tenendo premuto il pulsante di rilascio del blocco (G), ruotare la barra di bloccaggio reclinabile (F) per tutto il tempo

fino a toccare completamente lo schienale del sedile.

3) Rilasciare il pulsante di trazione (G) per tenere la barra di blocco della poltrona reclinabile in posizione riposta

posizione.

NOTA: non tentare di cambiare la posizione della sedia quando la barra di bloccaggio della reclinazione è inserita.

Ciò potrebbe danneggiare il meccanismo.

Machine Translated by Google

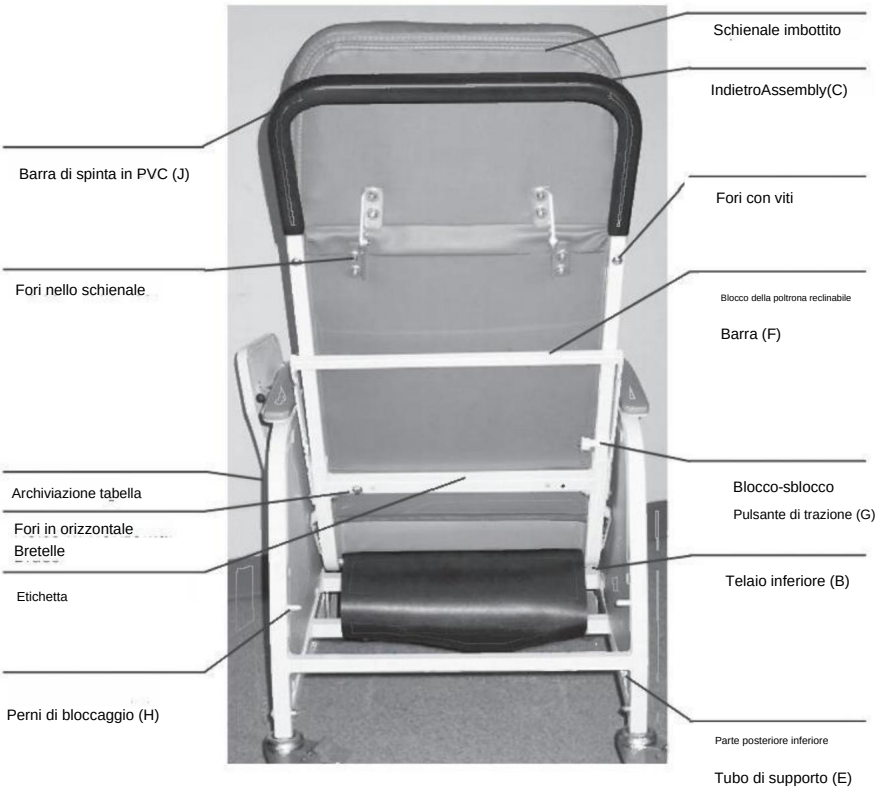


Figura 2

ISTRUZIONI PER L'USO2

3. PER REGOLARE IL POGGIATESTA ARTICOLATO:

Il poggiatesta articolato può essere regolato nella posizione desiderata tirandolo in avanti o spingendolo indietro.

4. PER OPERARE IL TAVOLO: 1)

Sotto ogni braccio, tirare verso il basso e tenere premuto il pulsante di trazione (Fig. 3 A&B) e far scorrere chiavi di blocco in avanti su entrambi i lati (D).

2) Sollevare il tavolo tramite il braccio circolare e farlo scorrere nel contenitore dei lubrificanti di fronte ogni braccio.

3) Il tavolo può scorrere dentro e fuori tenendo la chiave di blocco/sblocco in avanti.

Machine Translated by Google

4) Il tavolo può essere bloccato in una delle cinque posizioni. Tirare verso il basso il pulsante di trazione, tenerlo premuto e far scorrere la chiave all'indietro. Passare all'altro braccio e spostare la chiave all'indietro. Ora il tavolo sarà bloccato.

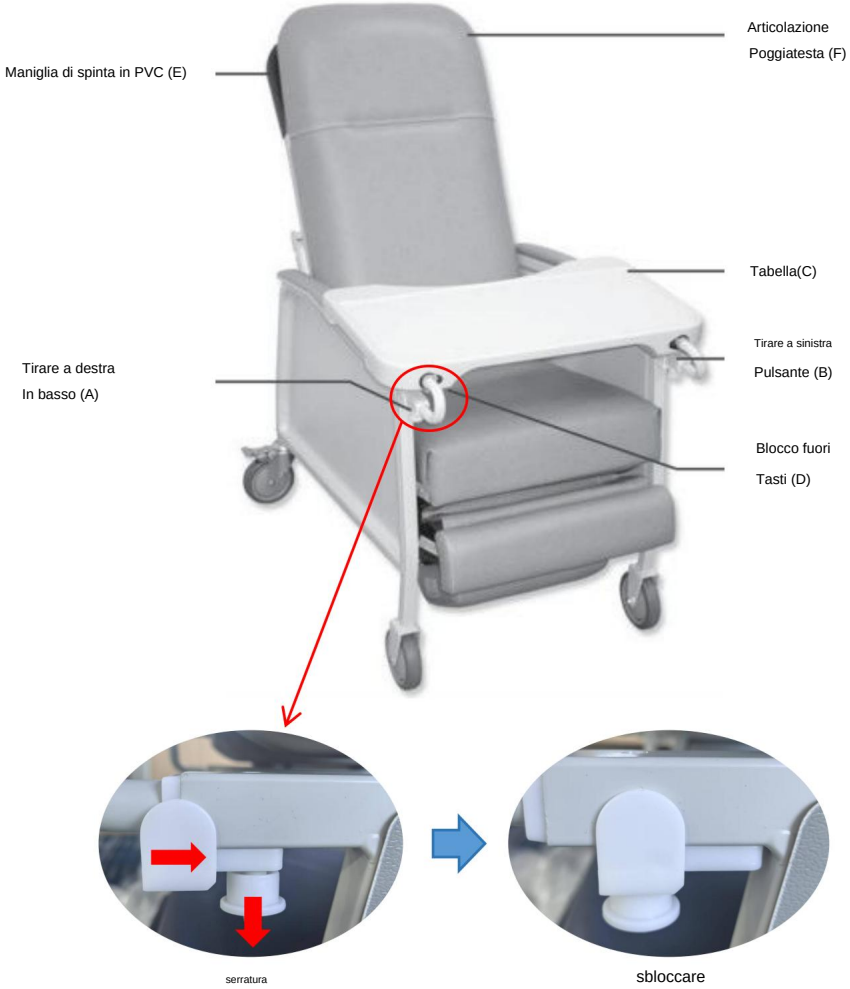


Figura 3

NOTA: questa sedia è dotata di due ruote posteriori girevoli per una migliore manovrabilità. Sono inoltre dotate di funzioni di bloccaggio.

Machine Translated by Google

5. FUNZIONAMENTO DEL BLOCCAGGIO DELLE RUOTE

Per bloccare le rotelle:

Per evitare che le rotelle posteriori girino, premere il pedale posteriore della rotella finché

il pedale si innesta. (La parte anteriore del pedale sporgerà dal copriruota).

Per sbloccare le rotelle:

Premere sulla parte anteriore sporgente del pedale per sbloccare il bloccaggio.

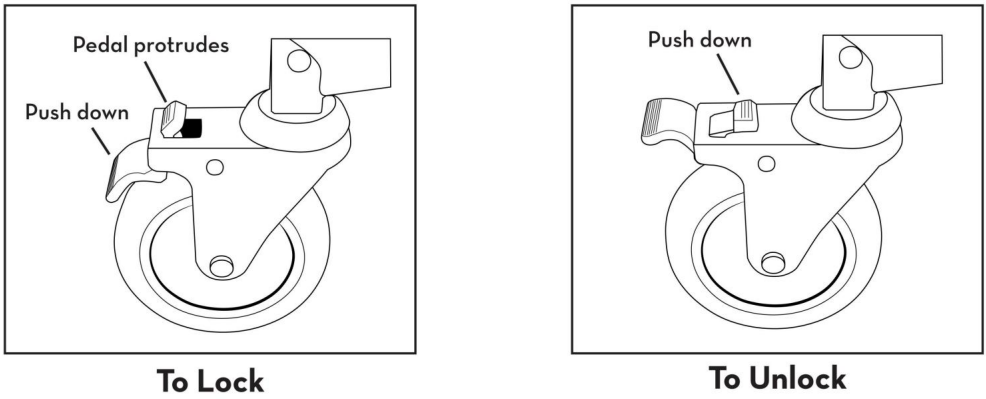


Figura 4

ATTENZIONE:

Non azionare la poltrona reclinabile applicando forza o pressione al poggiagambe. Evitare di posizionare

mani o gambe nelle pieghe vicino al meccanismo della poltrona reclinabile.

Le rotelle devono essere bloccate, tranne durante il trasporto.

MANUTENZIONE E PULIZIA

OGNI TRE MESI

Controllare e pulire le rotelle/Serrare i dadi/Controllare i freni delle rotelle/Controllare e pulire

meccanismo di bloccaggio reclinabile

Per la manutenzione dei rivestimenti e la rimozione delle macchie, i seguenti suggerimenti saranno utili:

Sporco ordinario: lavare con acqua tiepida e un sapone o un detergente delicato.

Sporco ostinato: utilizzando una spazzola a setole morbide, seguire le istruzioni riportate sopra.

Sporcizia incrostata: strofinare con detergente in polvere o un detergente simile.

Gomma da masticare: raschiare con cura.

Smalto e solvente per unghie: tamponare immediatamente per evitare danni.

Machine Translated by Google

Penna a sfera: Tamponare immediatamente con un panno bianco inumidito con acqua per orologi o minerali olio.

Ceratura e rifinitura: Miglioramento della vestibilità. Utilizzare qualsiasi cera in pasta di qualità.

Per la pulizia è possibile utilizzare una soluzione diluita al 10% (o meno) di candeggina o clorox questa sedia.

Produttore: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Indirizzo: n. 589 Hualu Road, città di Jiangyin, città di Wuxi, Jiangsu Provincia,214400,Cina

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINABLE

MODELO: D574-BR

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINABLE

MODELO: D574-BR



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Bloquee las ruedas. Retire la cubierta protectora. Gire la barra de bloqueo del sillón reclinable a la posición indicada (del paso 1 al 2).

2. Deslice el conjunto del respaldo en los tubos cuadrados del conjunto del marco inferior de modo que los orificios del respaldo se alineen con los orificios ubicados en el soporte horizontal del conjunto del marco inferior. (del paso 2 al paso 3)


3. Inserte los tornillos a través de los orificios del soporte horizontal y apriete todos los tornillos con un destornillador (del paso 2 al paso 3).

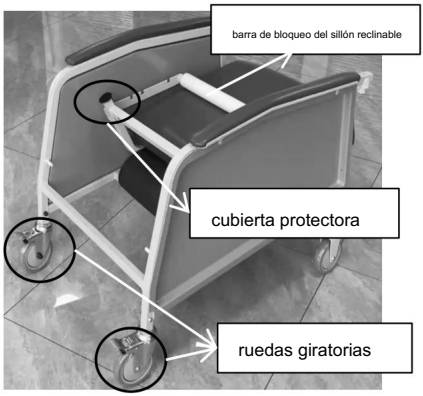


Paso 1



Paso 2

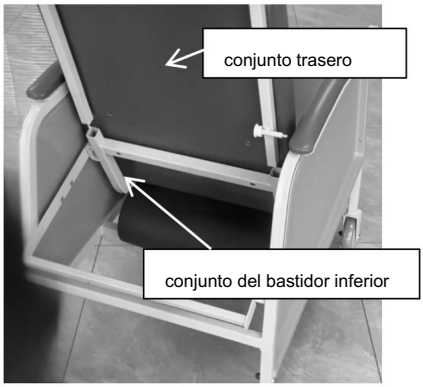

Paso 3

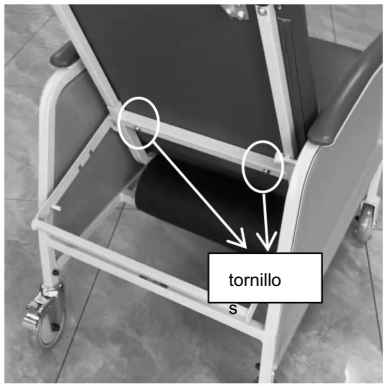

Paso 4

Figura 1

Machine Translated by Google

NOTA: Asegúrese de que los tornillos en ambos lados del ensamblaje posterior estén

Asegúrese de que esté lo suficientemente seguro antes de usar el sillón reclinable.

NOTA: Inspeccione periódicamente todas las piezas y reemplácelas según sea necesario. Peso del ocupante
no debe exceder las 250 libras.

Las ruedas giratorias deben bloquearse durante el traslado de los ocupantes.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO1

1. PARA COLOCAR LA UNIDAD EN POSICIÓN RECLINADA

1) Asegúrese de que la barra de bloqueo del sillón reclinable esté en la posición de guardado. Véase la fig. 2.

2) Párese a cada lado del sillón reclinable.

3) Sujete el apoyabrazos con una mano y la barra de empuje de PVC (J).

4) Empuje hacia abajo la barra de empuje para reclinar el respaldo a la primera posición reclinada, empuje
en la barra de empuje nuevamente para lograr la segunda y tercera posición reclinada.

5) Para levantar la posición vertical, tire hacia adelante la barra de empuje.

6) Coloque la barra de bloqueo del sillón reclinable (F).

NOTA: La mesa sólo se puede utilizar en posición sentada vertical.

El paciente debe ser transportado en posición reclinada con el bloqueo del reclinador activado.

2. FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE RECLINACIÓN

Para bloquear el sillón reclinable:

1) Coloque el sillón reclinable en la posición deseada.

2) Tire del botón de liberación del bloqueo (G) para liberar la barra de bloqueo (F) del lugar guardado.
posición.

3) Gire la barra de bloqueo del sillón reclinable (F) hacia abajo hasta que las muescas estén completamente enganchadas en el bloqueo.
Pasadores(H).

Para desbloquear el sillón reclinable:

1) Levante la barra de bloqueo del sillón reclinable (F) para soltarla de los pasadores de bloqueo.

2) Mientras mantiene presionado el botón de liberación de bloqueo (G), gire la barra de bloqueo de reclinación (F) completamente.
hasta que esté completamente contra el respaldo del asiento.

3) Suelte el botón de liberación y bloqueo (G) para mantener la barra de bloqueo del sillón reclinable en su lugar.
posición.

NOTA: No intente cambiar la posición de la silla con la barra de bloqueo del sillón reclinable activada.

Esto podría causar daños al mecanismo.

Machine Translated by Google

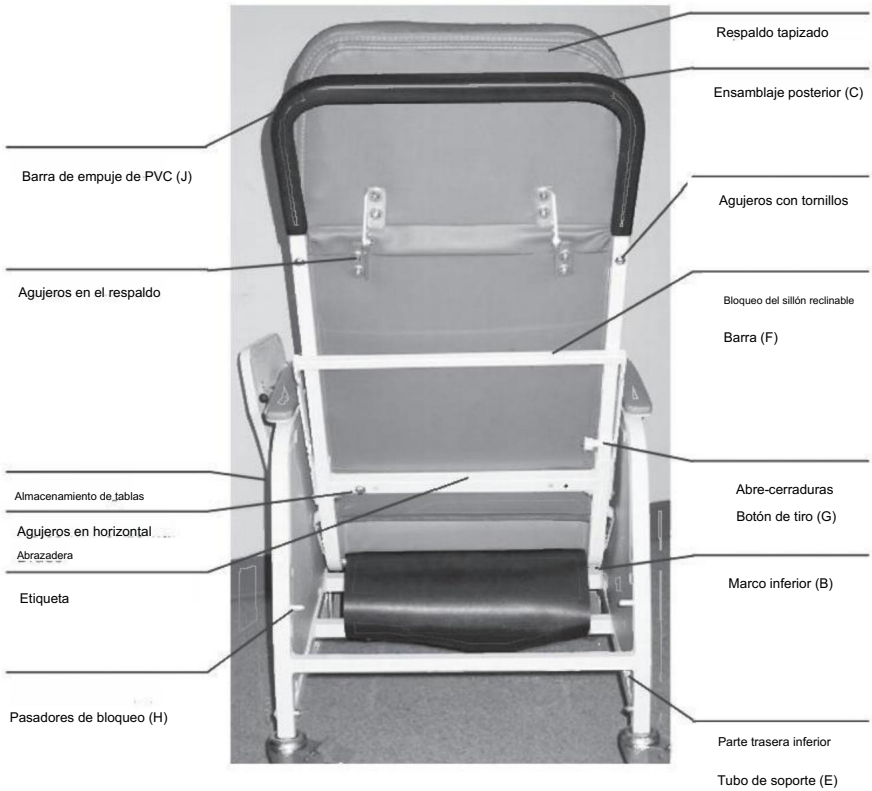


Figura 2

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO2

3. PARA AJUSTAR EL REPOSACABEZAS ARTICULADO:

El reposacabezas articulado se puede ajustar a la posición deseada tirando hacia adelante o empujando hacia atrás.

4. PARA OPERAR LA MESA: 1)

Debajo de cada brazo, tire hacia abajo y mantenga presionado el botón de tiro (Fig. 3 A y B) y deslícelo Teclas de bloqueo hacia adelante en ambos lados (D).

2) Tome la mesa por el brazo circular y deslícela hacia los lubricadores receptores en frente de cada brazo.

3) La mesa se puede deslizar hacia adentro y hacia afuera manteniendo la llave de bloqueo/bloqueo hacia adelante.

Machine Translated by Google

4) La mesa se puede bloquear en una de cinco posiciones. Presione el botón de tiro, manténgalo presionado y deslice la llave hacia atrás. Pase al otro brazo y mueva la llave hacia atrás. La mesa ahora estará bloqueada.

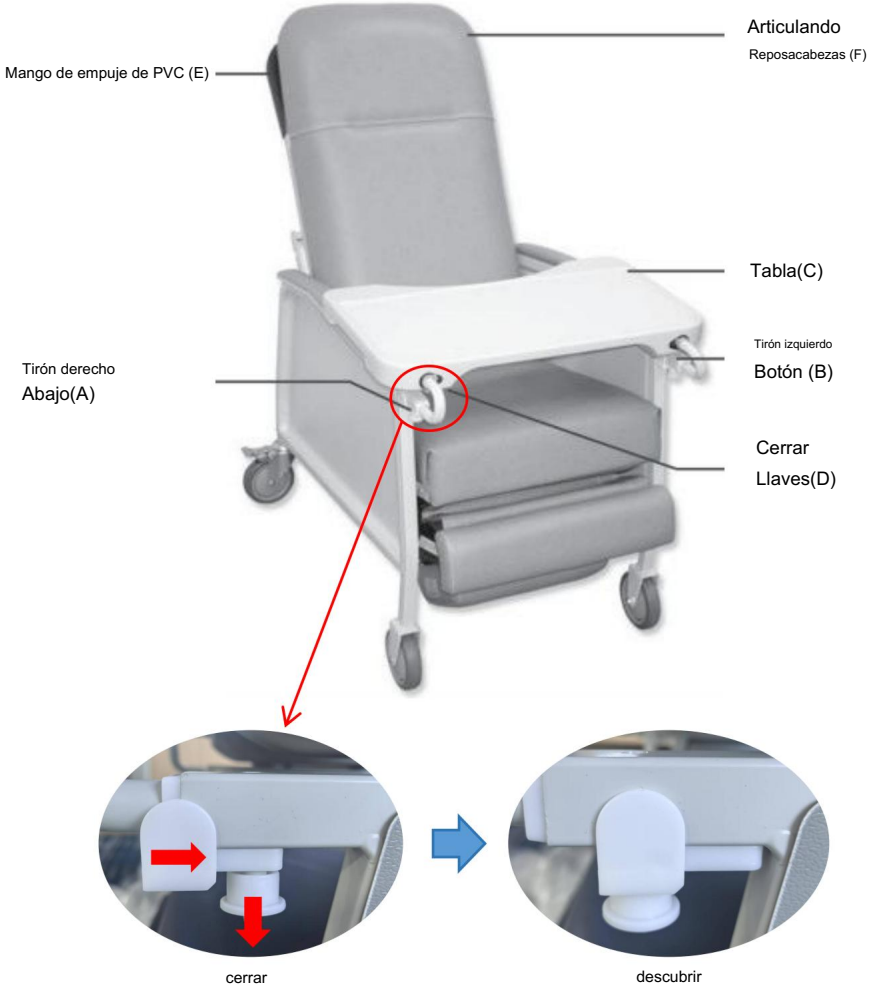


Figura 3

NOTA: Esta silla cuenta con dos ruedas traseras giratorias para mayor maniobrabilidad. También cuentan con sistema de bloqueo.

Machine Translated by Google

5. FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE LAS RUEDAS

Para bloquear las ruedas:

Para evitar que las ruedas traseras giren, pise el pedal trasero de la rueda hasta que

El pedal se acopla. (La parte delantera del pedal sobresaldrá de la cubierta de la rueda).

Para desbloquear las ruedas:

Pise la parte delantera que sobresale del pedal para desenganchar el bloqueo y desbloquearlo.

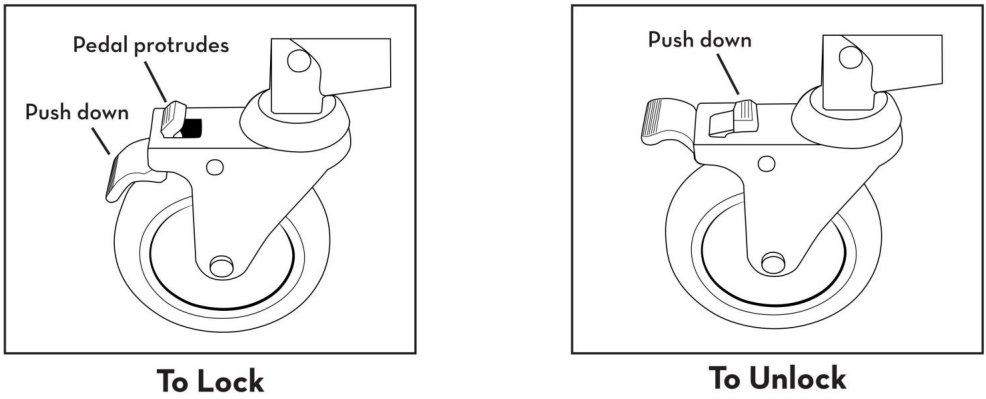


Figura 4

PRECAUCIÓN:

No opere el sillón reclinable aplicando fuerza o presión sobre el reposapiernas. Evite colocar

manos o piernas en los pliegues cerca del mecanismo reclinable.

Las ruedas deben bloquearse excepto durante el transporte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CADA TRES MESES

Revisar y limpiar las ruedas/Apretar las tuercas/Revisar los frenos de las ruedas/Revisar y limpiar

mecanismo de reclinación con bloqueo

Para el mantenimiento de la tapicería y la eliminación de manchas, los siguientes consejos serán útiles:

Suciedad común: Lavar con agua tibia y un jabón o detergente suave.

Suciedad difícil de eliminar: utilice un cepillo de cerdas suaves y siga las instrucciones anteriores.

Suciedad incrustada: frote con un limpiador en polvo o un detergente similar.

Chicle: Raspar con cuidado.

Esmalte y quitaesmalte: Seque inmediatamente para evitar daños.

Machine Translated by Google

Bolígrafo: Seque inmediatamente con un paño blanco humedecido en solución para relojes o minerales.
aceite.

Encerado y reacabado: Mejora la durabilidad. Use cera en pasta de cualquier calidad.

Se puede utilizar una solución diluida de 10% (o menos) de blanqueador o clorox para limpiar
Esta silla.

Fabricante: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd.

Dirección: No. 589 Hualu Road, ciudad de Jiangyin, ciudad de Wuxi, Jiangsu
Provincia,214400,China

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL REGULOWANY

MODEL:D574-BR

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL REGULOWANY

MODEL: D574-BR



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zablokuj kółka jezdne. Zdejmij osłonę ochronną. Obróć drążek blokujący fotel do określonej pozycji. (od kroku 1 do kroku 2)

2. Wsuń zespół oparcia do kwadratowych rur dolnej ramy tak, aby otwory w oparciu pokrywały się z otworami znajdującymi się na poziomym usztywnieniu dolnej ramy. (od kroku 2 do kroku 3)


3. Włóż śruby przez otwory w usztywnieniu poziomym i dokręć wszystkie śruby śrubokrętem. (od kroku 2 do kroku 3)

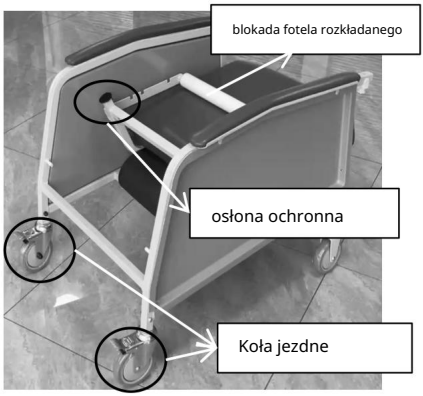


Krok 1



Krok 2

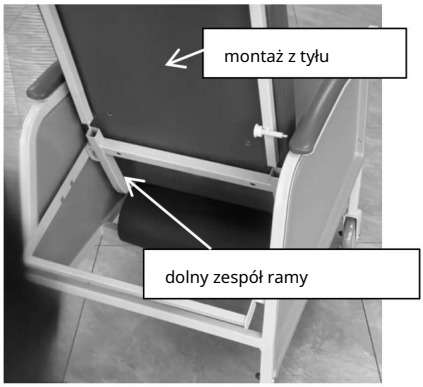

Krok 3

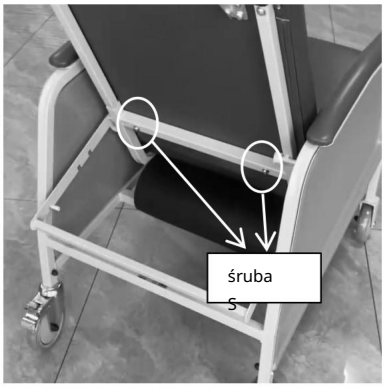

Krok 4

Rysunek 1

Machine Translated by Google

UWAGA: Upewnij się, że śruby po obu stronach tylnego zespołu są dokręcone.

odpowiednio zabezpieczone przed użyciem fotela rozkładanego.

UWAGA: Okresowo sprawdzaj wszystkie części i wymieniaj je w razie potrzeby. Masa pasażera
nie powinna przekraczać 250 funtów.

Podczas przemieszczania pasażerów kółka jezdne powinny być zablokowane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI1

1. USTAWIANIE URZĄDZENIA W POZYCJI ODCHYLONEJ

1) Upewnij się, że blokada fotela jest w pozycji złożonej. Zobacz rys.2.

2) Stań po obu stronach fotela.

3) Chwyć podłokietnik jedną ręką i uchwyt z tworzywa sztucznego (J).

4) Naciśnij uchwyt do pchania, aby odchylić oparcie do pierwszej pozycji odchylenia, pchnij

Ponownie naciśnij uchwyt, aby uzyskać drugą i trzecią pozycję odchylenia.

5) Aby podnieść dziecko do pozycji pionowej, pociągnij do przodu za rączkę do pchania.

6) Ustaw blokadę fotela (F).

UWAGA: Ze stołu można korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.

Pacjent powinien być transportowany w pozycji leżącej z włączoną blokadą pozycji leżącej.

2. DZIAŁANIE BLOKADY ODCHYLENIA

Aby zablokować fotel rozkładany:

1) Ustaw fotel w żądanej pozycji.

2) Wyciągnij przycisk zwalniający blokadę (G), aby zwolnić blokadę (F) z przechowywanej blokady.

pozycja.

3) Obróć blokadę fotela (F) w dół, aż wycięcia będą całkowicie zatrzaśnięte nad blokadą.

Kołki (H).

Aby odblokować fotel:

1) Podnieś blokadę fotela (F) w górę, aby odłączyć ją od kołków blokujących.

2) Przytrzymując przycisk zwalniania blokady (G), obróć blokadę odchylenia (F) do oporu.

aż do całkowitego oparcia fotela.


3) Zwolnij przycisk zwalniający blokadę (G), aby przytrzymać drążek blokujący fotela w pozycji złożonej.

pozycja.

UWAGA: Nie próbuj zmieniać pozycji fotela, gdy blokada fotela jest włączona.

Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

Machine Translated by Google

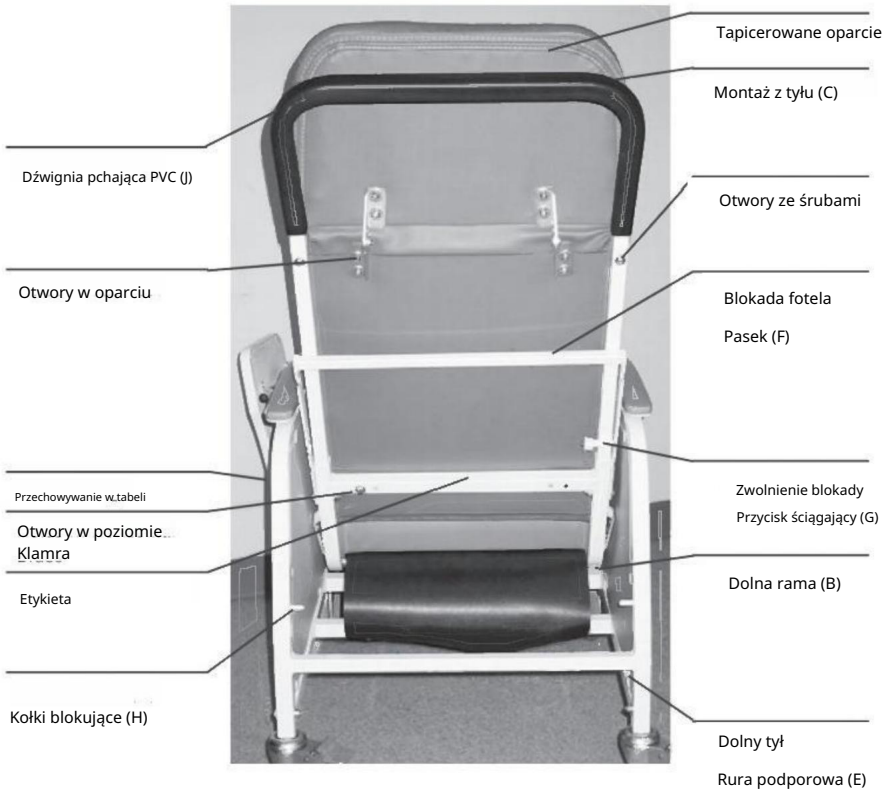

Rysunek 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI2

3. ABY WYREGULOWAĆ REGULOWANY ZAGŁÓWEK:

Przegubowy zagłówek można ustawić w żądanej pozycji poprzez pociągnięcie go do przodu lub odsunięcie do tyłu.

4. OBSŁUGA STOŁU: 1) Pod


każdym ramieniem pociągnij w dół i przytrzymaj przycisk pociągania (rys. 3 A i B) i przesuń klucze blokady do przodu po obu stronach (D).

2) Podnieś stół za okrągłe ramię stołu i wsuń je do pojemnika na smary znajdującego się przed nim każde ramię.

3) Stół można wsuwać i wysuwać, przytrzymując kluczyk blokady z przodu.

Machine Translated by Google

4) Stół można zablokować w jednej z pięciu pozycji. Pociągnij przycisk otwierania, przytrzymaj go i przesuń klucz do tyłu. Przejdź do drugiego ramienia i przesuń klucz do tyłu. Stół będzie teraz zablokowany.

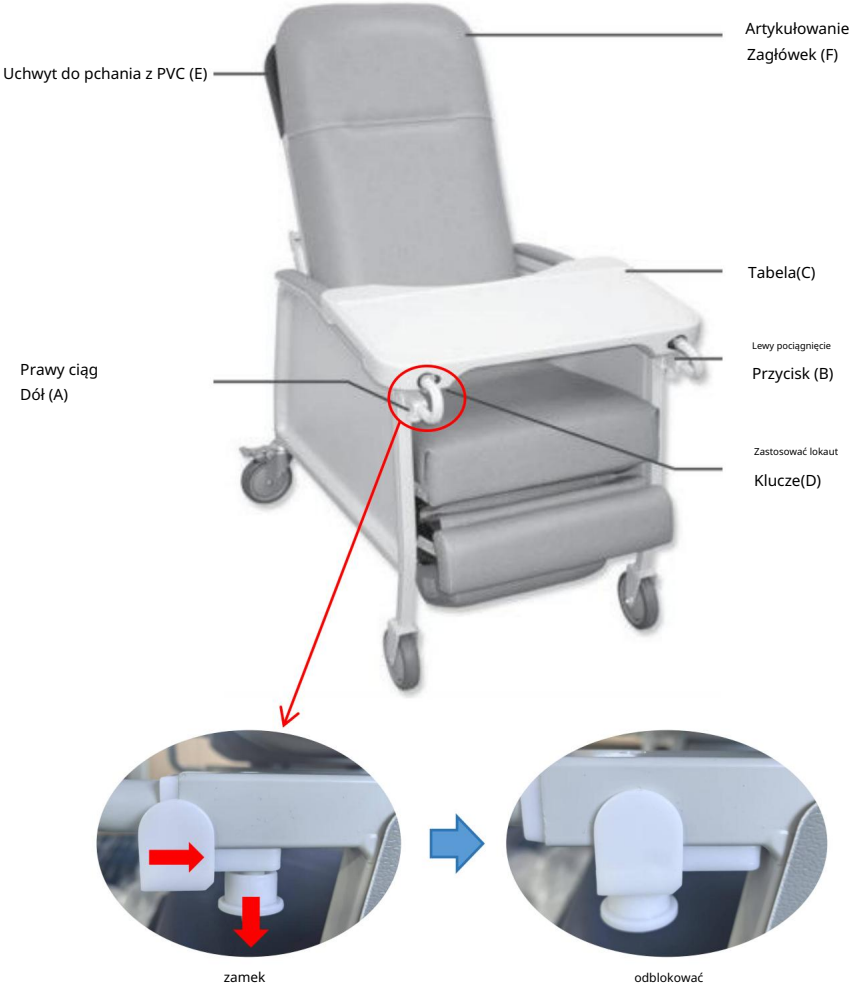

Rysunek 3

UWAGA: Ten fotel jest wyposażony w dwa obrotowe tylne kółka dla lepszej zwrotności. Są one również wyposażone w funkcje blokowania.

Machine Translated by Google


5. DZIAŁANIE BLOKADY KÓŁEK

Aby zablokować kółka:


Aby zapobiec obracaniu się tylnych kółek, naciśnij tylny pedał kółka, aż pedał się załącza. (Przód pedału będzie wystawać poza osłonę koła).

Aby odblokować kółka:

Naciśnij wystającą przednią część pedału, aby zwolnić blokadę i odblokować.

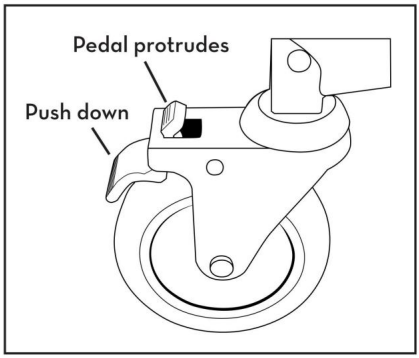

To Lock

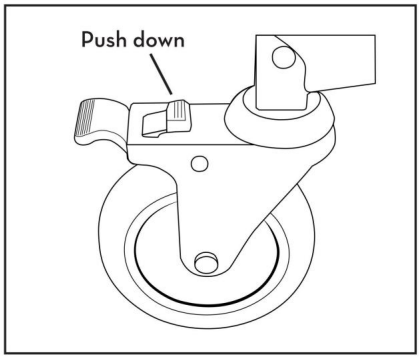

To Unlock

Rysunek 4

OSTROŻNOŚĆ:

Nie należy obsługiwać fotela, stosując siłę lub nacisk na podnóżek. Unikać umieszczania ręce lub nogi w zagłębieniach w pobliżu mechanizmu fotela.

Kółka muszą być zablokowane, z wyjątkiem czasu transportu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CO TRZY MIESIĄCE

Sprawdź i wyczyść kółka/Dokręć nakrętki/Sprawdź hamulce kółek/Sprawdź i wyczyść blokada mechanizmu odchylania

Przy konserwacji tapicerki i usuwaniu plam pomocne będą poniższe wskazówki:

Zwykłe zabrudzenia: Myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego mydła lub detergentu.

Trudne zabrudzenia: Używając miękkiej szczotki, postępuj zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Wnikliwy brud: Szorować proszkiem czyszczącym lub podobnym detergentem.

Guma do żucia: ostrożnie zeskrobuj.

Lakier do paznokci i zmywacz: Natychmiast osusz, aby zapobiec uszkodzeniom.

Machine Translated by Google

Długopis: Natychmiast osusz białą szmatką zwilżoną płynem do zegarków lub minerałów.
olej.

Woskowanie i odnawianie: Poprawa noszenia. Użyj dowolnego wosku w paście.

Do czyszczenia można stosować rozcieńczony roztwór wybielacza lub chlorku sodu w stężeniu 10% (lub niższym)
to krzesło.

Producent: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd
Adres: nr 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu
Prowincja,214400,Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIGGENDE STOEL

MODEL:D574-BR

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIGSTOEL

MODEL: D574-BR



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


Machine Translated by Google

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Vergrendel de zwenkwielen. Verwijder de beschermkap. Draai de vergrendelstang van de relaxfauteuil naar de aangegeven positie. (van stap 1 naar stap 2)

2. Schuif de rugleuning in de vierkante buizen van de onderste frameconstructie, zodat de gaten in de rugleuning op één lijn liggen met de gaten op de horizontale beugel van de onderste frameconstructie. (van stap 2 naar stap 3)


3. Steek de schroeven door de gaten van de horizontale beugel en draai alle schroeven vast met een schroevendraaier. (van stap 2 tot stap 3)

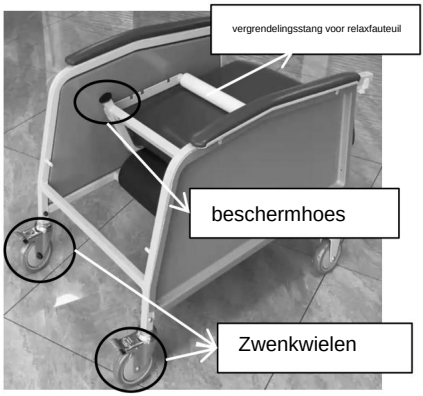


Stap 1



Stap 2

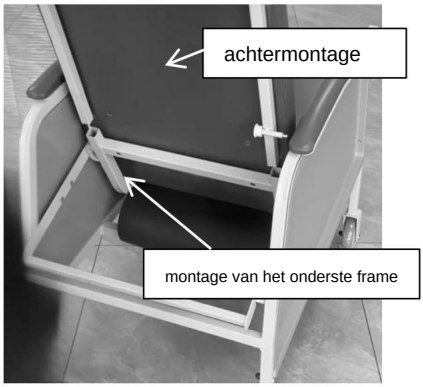

Stap 3

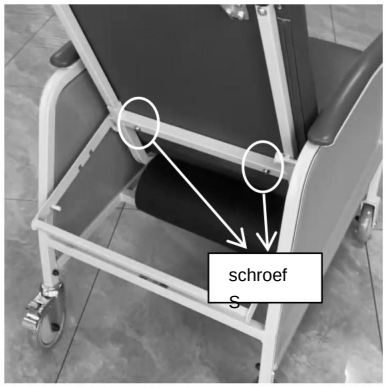

Stap 4

Figuur 1

Machine Translated by Google

OPMERKING: Zorg ervoor dat de schroeven aan beide zijden van de achterkant goed vastzitten.

voldoende stevig vastzitten voordat u de relaxfauteuil gebruikt.

OPMERKING: Controleer regelmatig alle onderdelen en vervang ze indien nodig. Gewicht van de inzittende

mag niet zwaarder zijn dan 250 lbs.

De zwenkwielen moeten worden geblokkeerd tijdens het verplaatsen van de gebruiker.

GEBRUIKSAANWIJZING1

1. EENHEID IN EEN LIGGEND POSITIE ZETTEN

1) Zorg ervoor dat de vergrendelingsstang van de relaxfauteuil in de opgeborgen positie staat. Zie fig.2.

2) Ga aan beide kanten van de stoel staan.

3) Pak de armleuning met één hand vast en de PVC duwstang (J).

4) Duw de duwstang naar beneden om de rugleuning naar de eerste ligpositie te kantelen, duw

Druk nogmaals op de duwstang om de tweede en derde ligpositie te bereiken.

5) Om het apparaat rechtop te zetten, trekt u de duwstang naar voren.

6) Vergrendelingsstang (F) voor de relaxfunctie instellen.

LET OP: De tafel kan alleen in rechtop zittende positie worden gebruikt.

De patiënt moet in een liggende positie worden vervoerd, met de stoelvergrendeling ingeschakeld.

2. BEDIENING VAN HET LIGGEND SLOT

Om de relaxfauteuil te vergrendelen:

1) Plaats de relaxfauteuil in de gewenste positie.

2) Trek de ontgrendelingsknop (G) eruit om de vergrendelingsstang (F) uit de opslag te halen

positie.

3) Draai de vergrendelingsstang (F) van de relaxfauteuil naar beneden totdat de inkepingen volledig vastzitten boven de vergrendelingsstang.

Pinnen (H).

Om de relaxfauteuil te ontgrendelen:

1) Til de vergrendelingsstang (F) van de relaxfauteuil omhoog om deze los te maken van de vergrendelingspennen.

2) Terwijl u de vergrendelingsknop (G) ingedrukt houdt, draait u de vergrendelingsstang (F) helemaal naar achteren.

helemaal tot tegen de rugleuning van de stoel.


3) Ontgrendel de ontgrendelingsknop (G) om de vergrendelingsstang van de relaxfauteuil in de opgeborgen positie te houden

positie.

LET OP: Probeer niet de positie van de stoel te veranderen als de vergrendelingshendel van de relaxfunctie is vastgezet.

Dit kan schade aan het mechanisme veroorzaken.

Machine Translated by Google

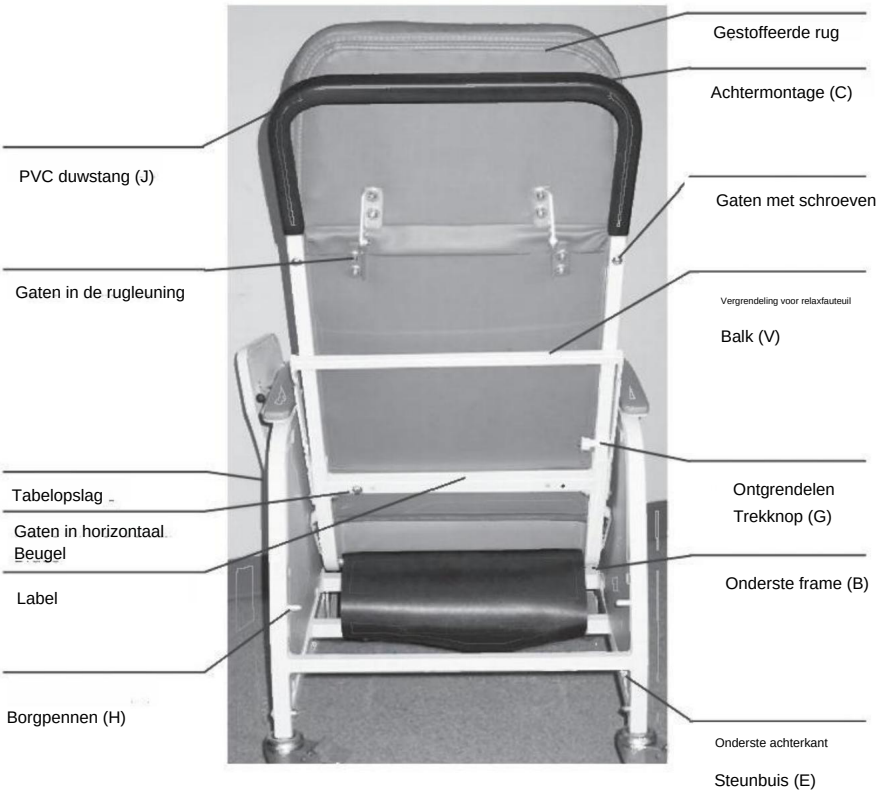

Figuur 2

GEBRUIKSAANWIJZING2

3. OM DE BEWEEGBARE HOOFDSTEUN AAN TE PASSEN:

De verstelbare hoofdsteun kan in de gewenste positie worden gezet door hem naar voren te trekken of naar achteren te duwen.

4. BEDIENING VAN DE TAFEL:


1) Trek onder elke arm de trekknop (Fig. 3 A&B) naar beneden en houd deze vast, en schuif Lockout-sleutels aan beide zijden naar voren (D).

2) Pak de tafel vast bij de ronde tafelarm en schuif deze in de ontvangende smeermiddelen vooraan elke arm.

3) De tafel kan op en af geschoven worden door de vergrendel-/blokkeersleutel naar voren te houden.

Machine Translated by Google

4) De tafel kan in een van de vijf standen worden vergrendeld. Trek de trekknop naar beneden, houd de trekknop ingedrukt en schuif de sleutel naar achteren. Ga naar de andere arm en beweeg ook die sleutel naar achteren. De tafel is nu vergrendeld.

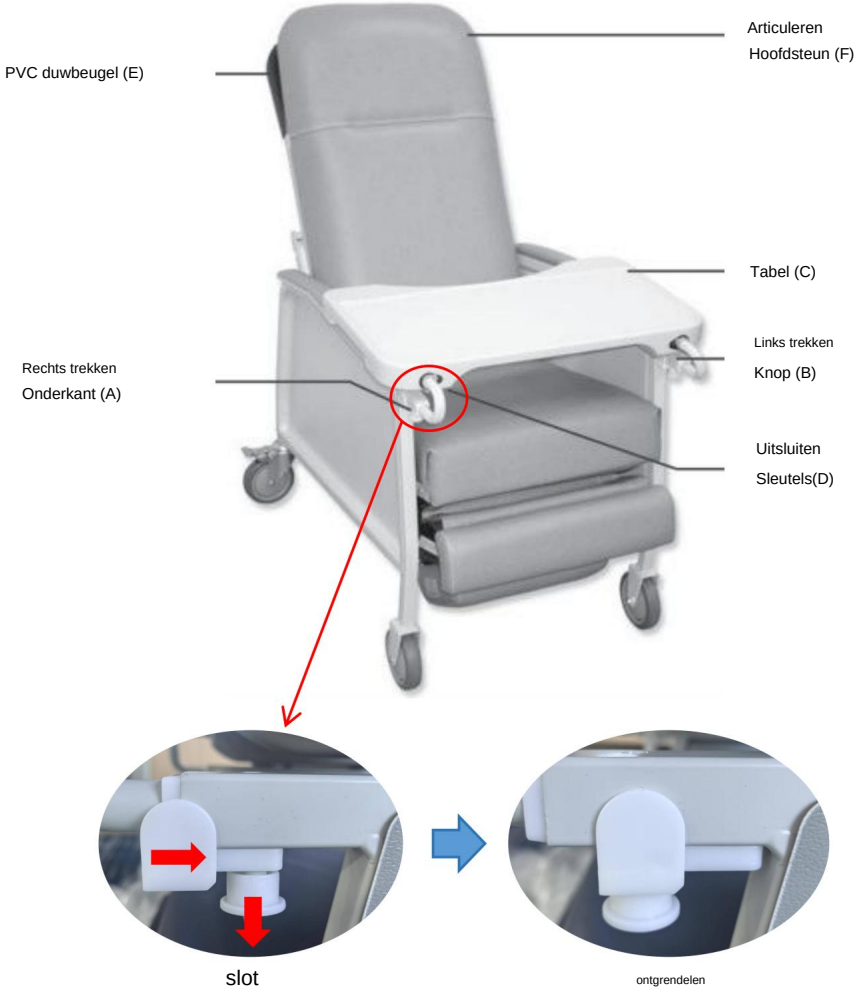

Figuur 3

OPMERKING: Deze stoel is uitgerust met twee zwenkwielen aan de achterkant voor verbeterde wendbaarheid. Ze zijn ook uitgerust met vergrendelingsfuncties.

Machine Translated by Google


5. WERKING VAN DE WIELENVERGRENDELING

Om de wielen te vergrendelen:

Om te voorkomen dat de achterste zwenkwielen draaien, trapt u op het achterste pedaal van het zwenkwiel totdat het pedaal grijpt in. (De voorkant van het pedaal steekt uit de wielkap).

Om de wielen te ontgrendelen:

Trap op het uitstekende voorste deel van het pedaal om de vergrendeling los te maken en te ontgrendelen.

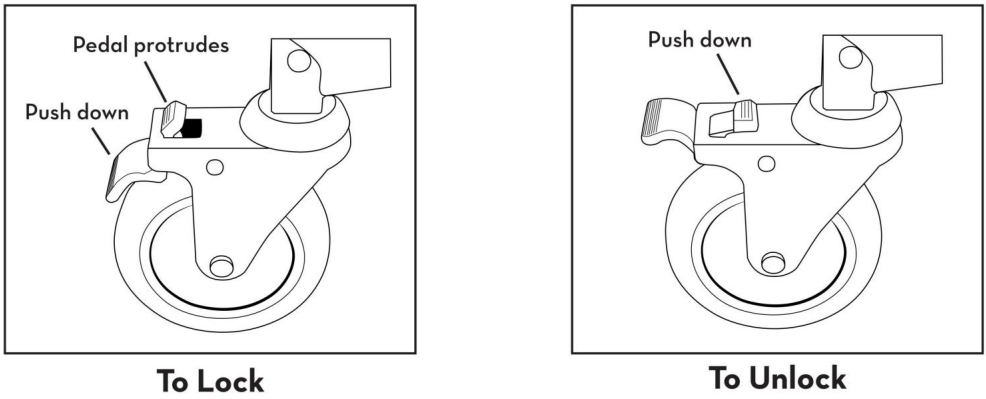

Figuur 4

VOORZICHTIGHEID:

Bedien de relaxfauteuil niet door kracht of druk uit te oefenen op de beensteun. Vermijd het plaatsen handen of benen in vouwen bij het relaxmechanisme.

De wielen moeten vergrendeld zijn, behalve tijdens transport.

ONDERHOUD&REINIGING

ELKE DRIE MAANDEN

Controleer en reinig de wielen/Draai de moeren aan/Controleer de remmen op de wielen/Controleer en reinig slot kantelmechanisme

Voor het onderhouden van stoffering en het verwijderen van vlekken zijn de volgende tips nuttig:

Normaal vuil: Wassen met warm water en een milde zeep of wasmiddel.

Hardnekkig vuil: Gebruik een zachte borstel en volg de bovenstaande instructies.

Ingetrokken vuil: schrob met een reinigingspoeder of een soortgelijk reinigingsmiddel.

Kauwgom: Voorzichtig schrapen.

Nagellak en nagellakremover: Dep de vlek onmiddellijk om schade te voorkomen.

Machine Translated by Google

Balpen: Dep onmiddellijk met een witte doek die is bevochtigd met horloge- of mineraalwater.
olie.

Waxen en opnieuw afwerken: Verbetert de draagbaarheid. Gebruik elke kwaliteit pasta wax.

Bij het schoonmaken kan een verdunde oplossing van 10% (of minder) bleekmiddel of chloor worden gebruikt deze stoel.

Fabrikant: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adres: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu
Provincie,214400,China

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VILSTOL

MODELL:D574-BR

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

VILSTOL

MODELL: D574-BR



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


Machine Translated by Google

MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Lås länkhjulen. Ta bort skyddskåpan. Vänd liggstolens låsstång till angivet läge. (från steg 1 till steg 2)

2. Skjut in ryggdelen i fyrkantsrören på den nedre ramenheten så att hålen i ryggstödet är i linje med hålen på den nedre ramenhetens horisontella stöd. (från steg 2 till steg 3)


3. Sätt in skruvarna genom hålen i den horisontella stöden och dra åt alla skruvar med en skruvmejsel.(från steg 2 till steg 3)

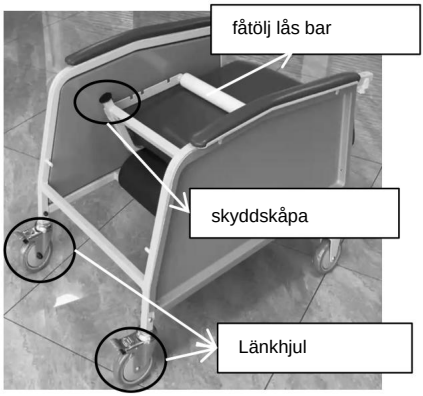


Steg 1



Steg 2

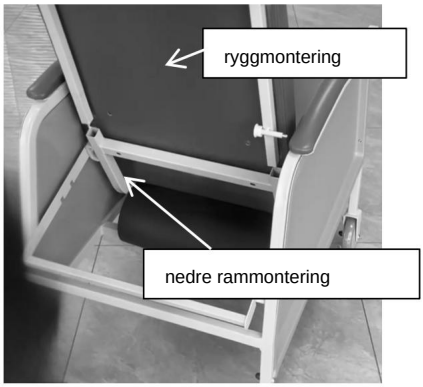

Steg 3

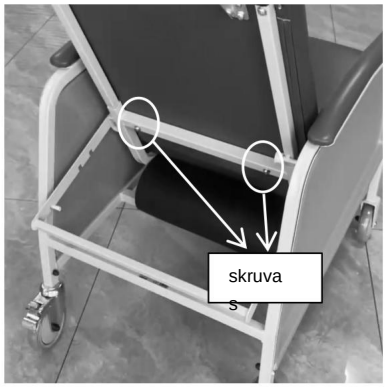

Steg 4

Figur 1

Machine Translated by Google

OBS: Se till att skruven på båda sidor av den bakre delen är tillräckligt säker innan vilstolen används.

OBS: Inspektera regelbundet alla delar och byt ut vid behov. Passagerarens vikt bör inte överstiga 250 lbs.

Länkhjul ska vara låsta under förflyttning av passagerare.

DRIFTSINSTRUKTIONER1

1. ATT PLACERA ENHETEN I LIGGANDE LÄGE

1) Se till att vilstolens låsbygel är i lagrat läge. Se fig.2.

2) Stå på vardera sidan av vilstolen.

3) Fatta armstödet med en hand och PVC-skjutstången (J).

4) Tryck ned tryckstången för att luta tillbaka ryggen till det första lutningsläget, tryck på tryckstången igen för att uppnå andra och tredje lutningsläge.

5) För att höja upprätt, dra framåt på tryckstången.

6) Ställ in vilstolens låsstång (F).

OBS: Bordet kan endast användas i upprätt sittande läge.

Patienten ska transporteras i tillbakalutat läge med ett låsset för vilstol.

2. ANVÄNDNING AV LIGGANDE LÅS

För att låsa vilstolen:

1) Placera vilstolen i önskad position.

2) Dra ut låsknappen (G) för att frigöra låsstången (F) från lagrad placera.

3) Vrid vilstolens låsstång (F) nedåt tills skårorna är helt i ingrepp över låsningen Pins(H).

Så här låser du upp vilstolen:


1) Lyft upp vilstolens låsstång (F) för att lossa från låsstiften.

2) Medan du håller ut Lås-Release Pull-knappen (G) vrider du den luta låsstången (F) hela långt upp tills helt mot ryggstödet.

3) Släpp lås- och släpp-dragknappen (G) för att hålla vilstolens låsstång i förvarad placera.

OBSERVERA: Försök inte att ändra stolens position med vilstolens låsstång inkopplad. Detta kan orsaka skada på mekanismen.

Machine Translated by Google

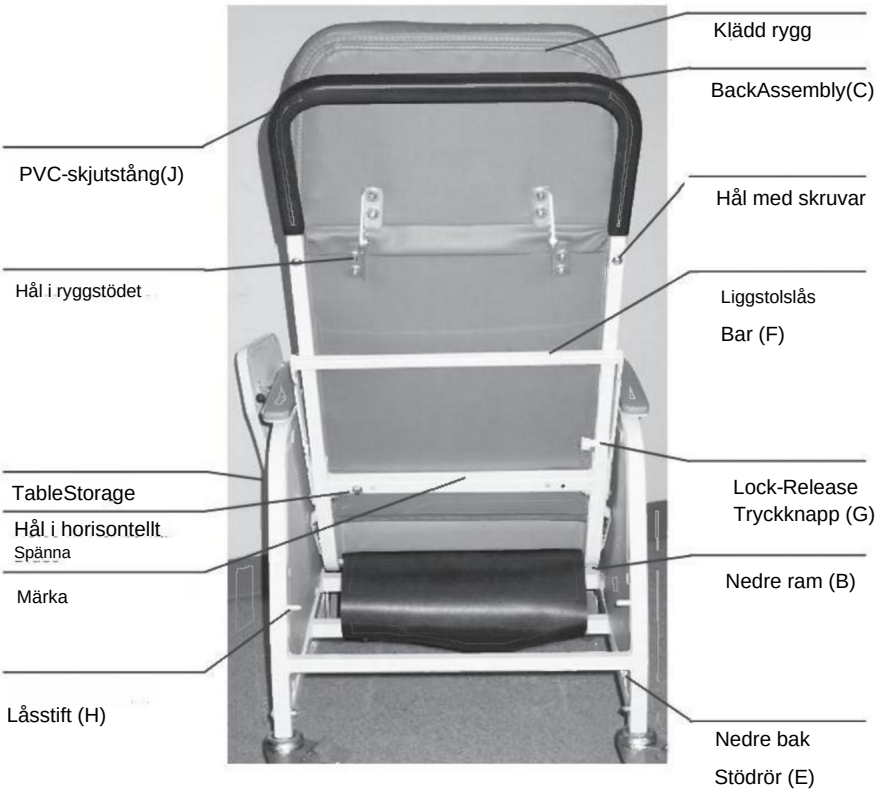

Figur 2

DRIFTSINSTRUKTIONER2

3. FÖR ATT JUSTERA LEDANDE NACKSTÖD:

Det ledade nackstödet kan justeras till önskat läge genom att dra framåt eller trycka bakåt.


4. ATT ANVÄNDA BORDET: 1) Under varje arm, dra ner och håll in dragknappen (Fig.3 A&B) och skjut spärrnycklar framåt på båda sidor (D).

2) Plocka upp bordet med den cirkulära bordsarmen och skjut in det i mottagande smörjmedel framför varje arm.

3) Bordet kan skjutas på och av genom att hålla lås-/låsningsnyckeln framåt.

Machine Translated by Google

4) Bordet kan låsas i en av fem positioner. Dra ner dragknappen, håll dragknappen och skjut nyckeln bakåt. Fortsätt till den andra armen och flytta nyckeln bakåt. Bordet kommer nu att låsas.

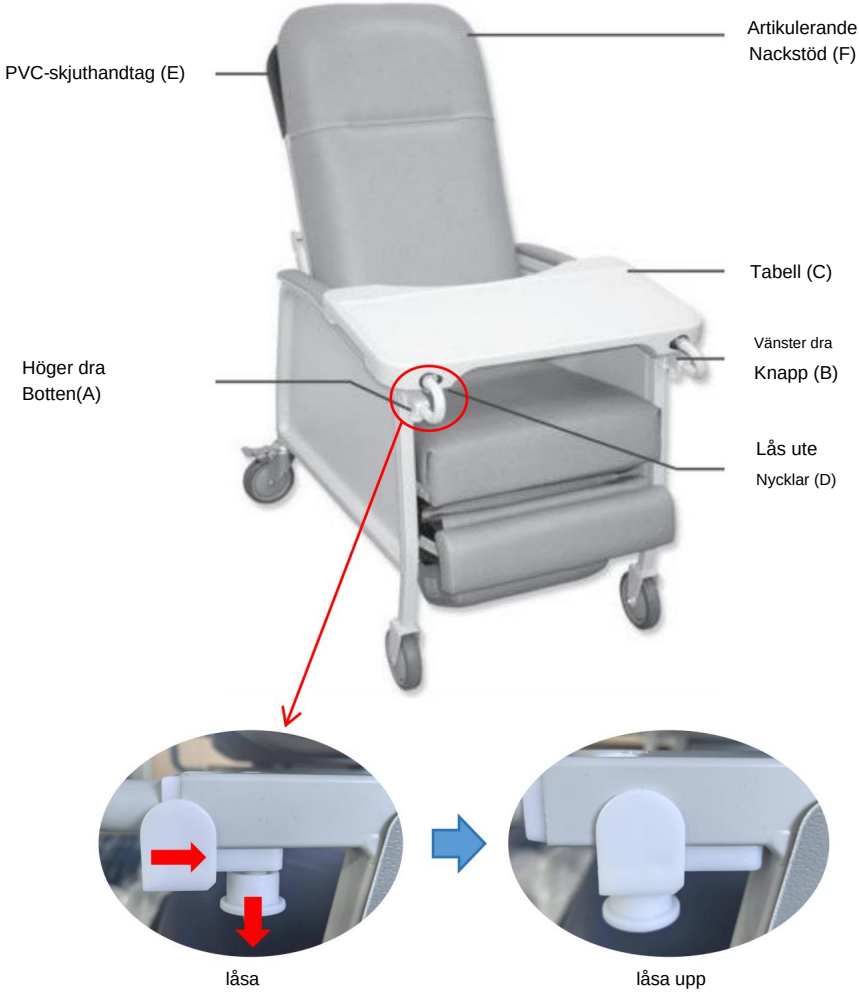

Figur 3

OBS: Denna stol är utrustad med två svängbara bakhjul för förbättrad manövrerbarhet. De är också utrustade med låsfunktioner.

Machine Translated by Google


5. HJULLÅSFUNKTION

Så här låser du hjul:

För att förhindra att de bakre hjulen svänger, trampa på den bakre pedalen på hjulet tills pedalen kopplas in. (Framsidan av pedalen kommer att sticka ut från hjulkåpan).

Så här låser du upp hjul:

Trampa på den utskjutande främre delen av pedalen för att frigöra låset för att låsa upp.

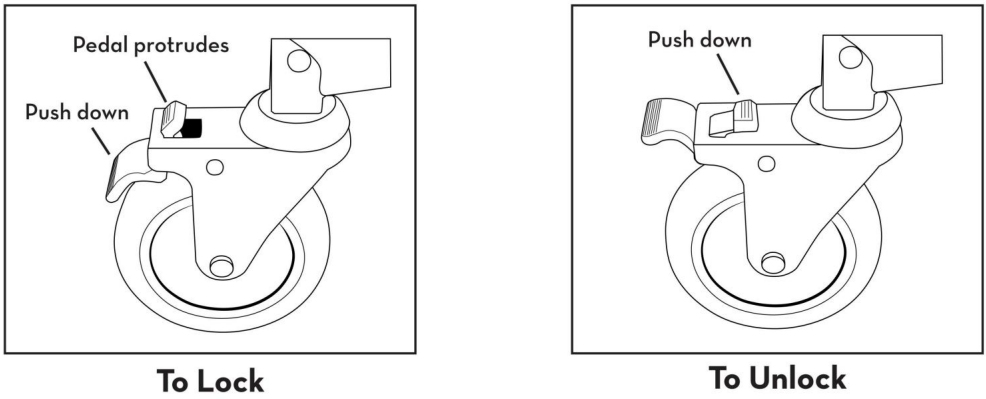

Figur 4

FÖRSIKTIGHET:

Använd inte vilstolen genom att utöva kraft eller tryck på benstödet. Undvik att placera händer eller ben i veck nära vilstolsmekanismen.

Hjulen måste vara låsta förutom under transport.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

VAR TREDJE MÅNAD

Kontrollera och rengör hjul/Dra åt muttrar/Kontrollera bromsar på hjul/Kontrollera och rengör låsmekanism för lutning

För underhåll av klädsel och fläckborttagning kommer följande tips att vara till hjälp:

Vanlig smuts: Tvätta med varmt vatten och en mild tvål eller rengöringsmedel.

Envis smuts: Använd en mjuk borste och följ anvisningarna ovan.

Nedslipad smuts: Skrubba med pulveriserat rengöringsmedel eller liknande rengöringsmedel.

Tuggummi: Skrapa försiktigt.

Nagellack och remover: Blotta omedelbart för att förhindra skador.

Machine Translated by Google

Kulspetspenna: Blotta omedelbart med en vit trasa fuktad i klocka eller mineral olja.

Vaxning och refnishing: Förbättra bärbarheten. Använd valfritt kvalitetspastavax.

En utspädd lösning med 10 % (eller mindre) blekmedel eller clorox kan användas vid rengöring denna stol.

Tillverkare: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adress: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Provins, 214400, Kina

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support