VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760637

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL:FBL760637



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual. WARNING: The pedal must be retracted before standing up in order to avoid potential falls injury.

Physiotherapist

1. Before first use, adjust the height and the width of the rail to your toilet.
2. Back up to the toilet with your assistive device (if available) until the back of your legs is touching the toilet.
3. Reach back for the rail, hold firmly, and slowly lower yourself into a seated position on the toilet.
4. To return to a standing position, place your hands on the rails firmly and push yourself up into a standing position.
5. Once you are standing, gradually let go of the rails, and only then, grab the handle of your assistive device (if available).


IMPORTANT

1. Don't exceed the maximum weight capacity.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, and rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect them for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Handrail tube	2	⑧		Bucket	1
②		Backrest	1	⑨		Seat tube	1
③		Footrest	1	⑩		6x58 Screw set	12
④		Front U-shaped connecting tube	1	⑪		6x42 Screw set	2
⑤		Rear U-shaped connecting tube	1	⑫		6x32 Screw set	2
⑥		Wheel	4	⑬		Hexagon screwdriver	1
⑦		Seat	1	⑭		Hexagon wrench	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760637
Main Materials	Aluminum
Seat Height	490mm/19.3"
Seat Rated Load	159kg/350lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Installation Procedures

1

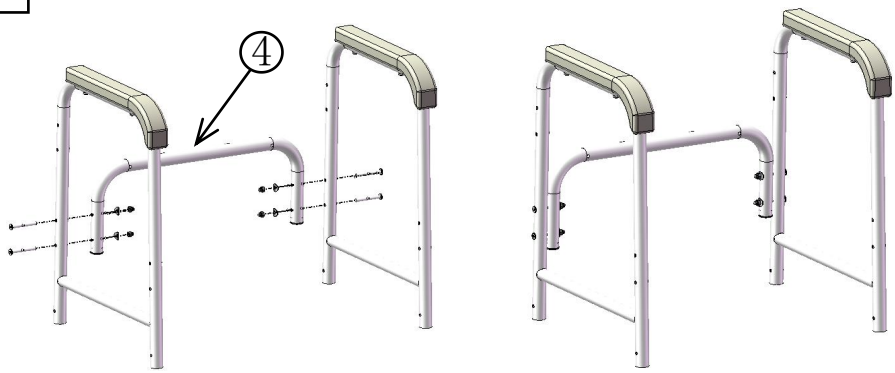


Use 4pcs 6x58 screw sets⑩ to lock the rear U-shaped connecting tube⑤ to the handrail tubes①.

2




Insert the seat tube⑨ into the rear U-shaped connecting tube hole.


3

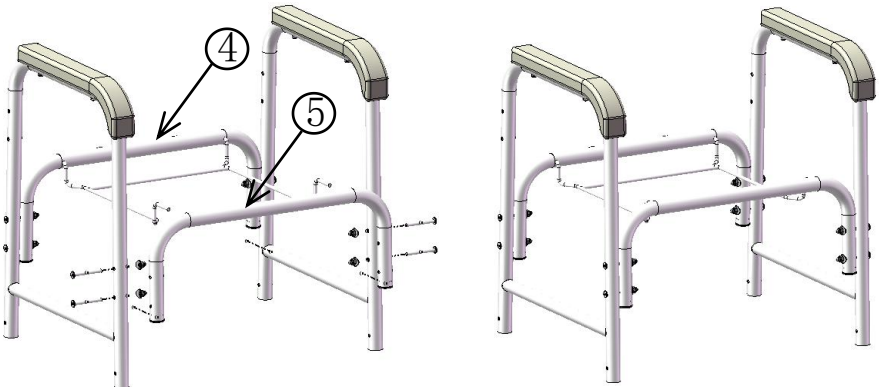

Insert the front U-shaped connecting tube④ into the seat tube and then lock it with the handrail using 4pcs 6x58 screws⑩.


4

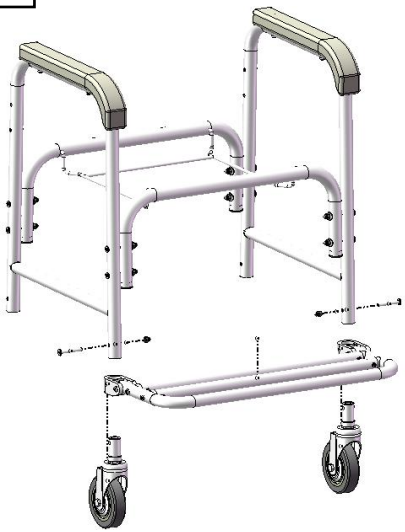


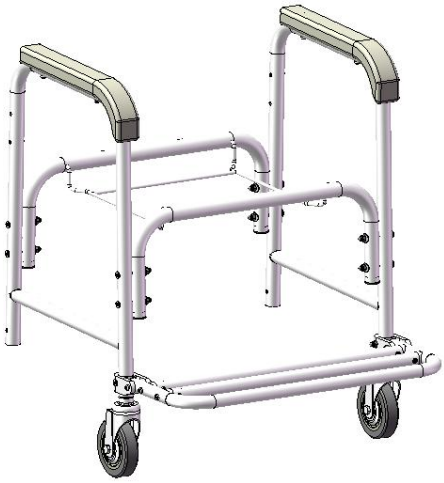

Lock the wheels⑥ and footrest to the handrail tubes with 2pcs 6x42 screw sets⑪.


5

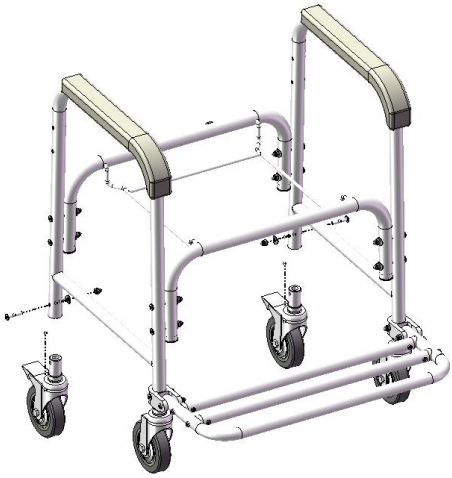


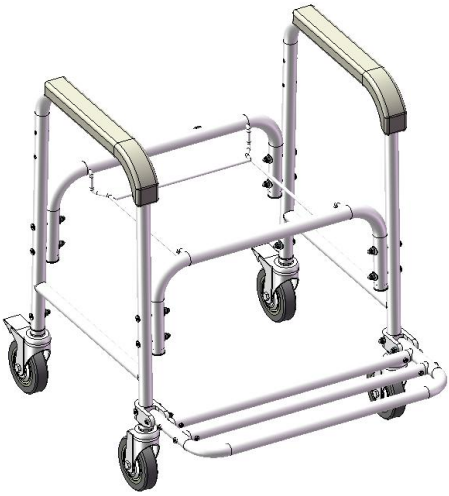

Lock the wheels⑥ to the handrail tubes with 2pcs 6x32 screw sets⑫.


6

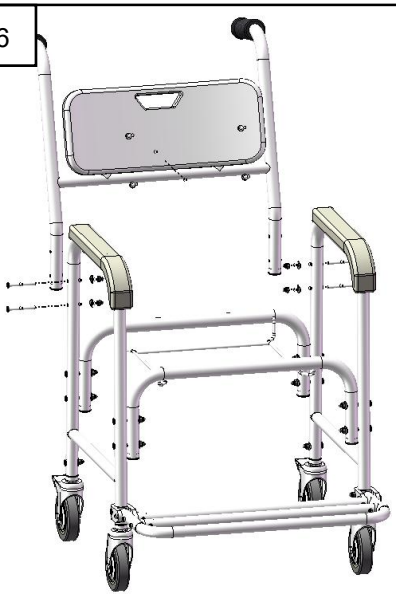

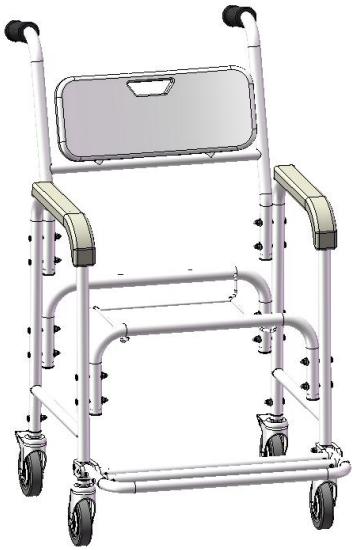

Use 4pcs 6x58 screw sets⑩ to lock the backrest② to the handrail tube.

7

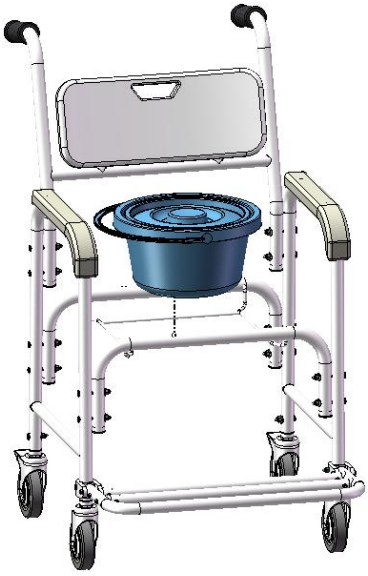



Place the bucket⑧ in the seat tube.

8



Install the seat⑦ onto the seat frame.


9



As shown in the figure, the installation is completed.

2.Instruction

1

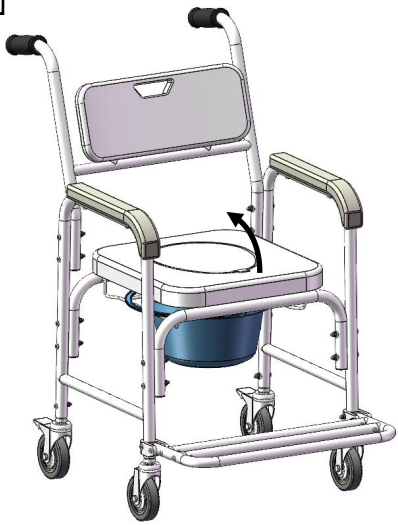



Take off the top seat, lift the seat with holes upwards by hand, and then you can take out the bucket.

2





WARNING: The pedal must be retracted before standing up in order to avoid potential fall injury.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE: FBL76063 7

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODÈLE : FBL760637



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement le manuel afin d'éviter tout risque de blessure, d'endommagement du produit ou d'annulation de la garantie. Consultez un professionnel en cas d'inconfort, de douleur ou d'aggravation des symptômes. Si nécessaire, assurez-vous d'être supervisé afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids.

Vérifiez régulièrement la solidité de l'assemblage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ce produit doit être utilisé sur une surface plane et stable. Ne le démontez pas si nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel.
ATTENTION : La pédale doit être rétractée avant de se lever afin d'éviter d'éventuelles blessures dues à une chute.

Physiothérapeute

1. Avant la première utilisation, ajustez la hauteur et la largeur de la barre à votre toilette.
2. Reculez jusqu'aux toilettes avec votre appareil d'assistance (si disponible) jusqu'à ce que l'arrière de vos jambes touche les toilettes.
3. Attrapez la rampe, tenez-la fermement et abaissez-vous lentement en position assise sur les toilettes.
4. Pour revenir à la position debout, placez fermement vos mains sur les rails et poussez-vous vers le haut pour vous mettre debout.
5. Une fois debout, lâchez progressivement les rails, puis saisissez la poignée de votre appareil d’assistance (si disponible).


IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d’usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, puis rincez tout résidu de savon. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PART LIST

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces listées ci-dessous sont bien présentes et inspectez- les soigneusement pour détecter tout dommage éventuel survenu pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NON	IMAGE	NOM	Qté	NON	IMAGE	NOM	Qté
1		Tube de main courante	2	⑧		Seau	1
②		Dossier	1	⑨		Tube de selle	1
③		Repose-pieds	1	⑩		Jeu de vis 6x5 8	12
④		Tube de raccordement avant en forme de U	1	⑪		2 vis 6x4	2
5		Tube de liaison arrière en forme de U	1	⑫		2 vis 6x3	2
6		Roue	4	⑬		Tournevis hexagonal	1

⑦		Siège	1	⑭		Clé hexagonale	1


PRODUCT PAREMETERS

Modèle	**FBL760637**
Principaux matériaux	Aluminium
Hauteur du siège	49 0 mm/ 19,3 "
Siège Charge nominale	159 kg/350 lb

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

2. Procédures d'installation

1

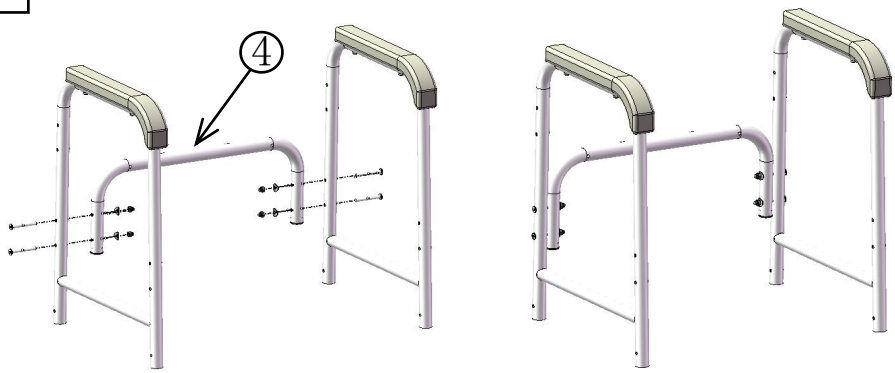


Utilisez 4 jeux de vis 6x58 ⑩ pour verrouiller le tube de connexion arrière en forme de U ⑤ aux tubes de la main courante ① .

2




Insérez le tube de selle ⑨ dans le trou du tube de connexion arrière en forme de U.


3

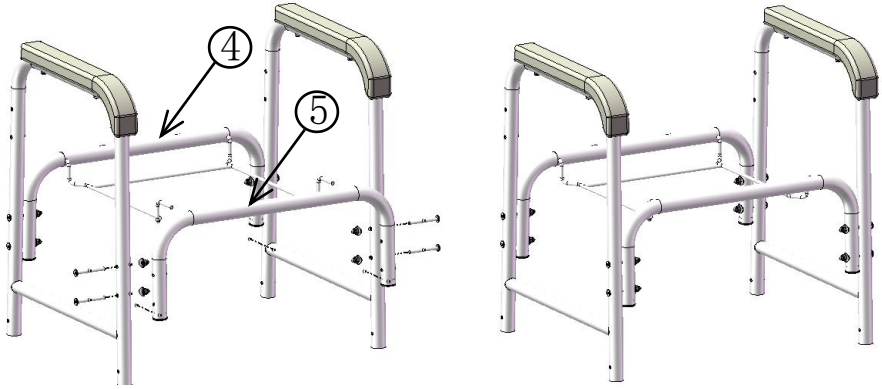

Insérez le tube de connexion avant en forme de U ④ dans le tube de selle, puis verrouillez-le avec la main courante à l'aide de 4 vis 6x58 ⑩ .


4

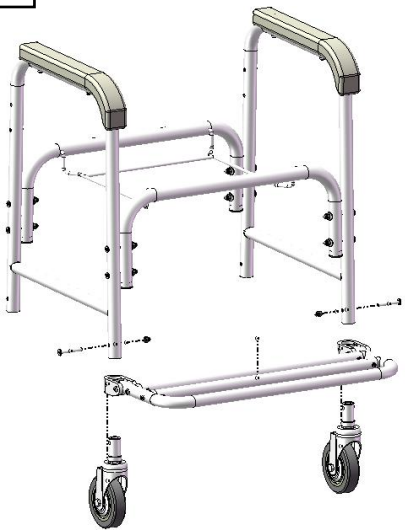


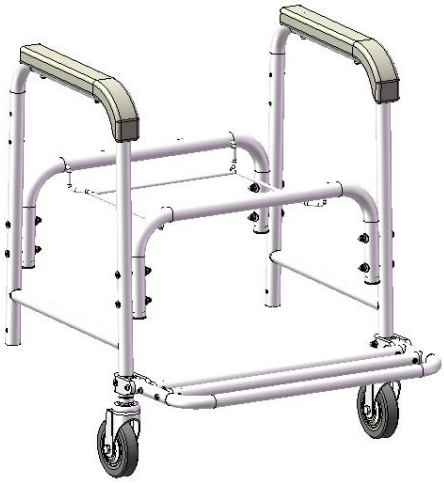

Verrouillez les roues ⑥ et le repose-pieds sur les tubes de la main courante avec 2 jeux de vis 6x42 ⑪ .

5

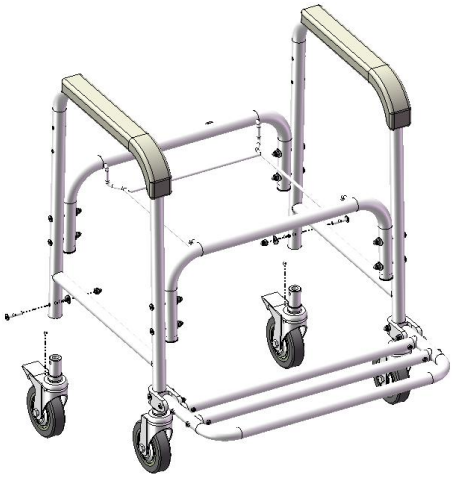


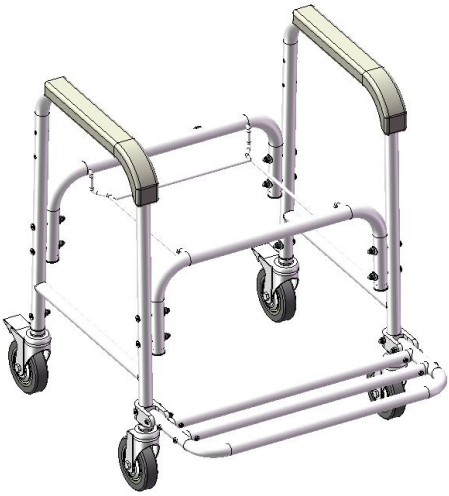


Verrouillez les roues ⑥ sur les tubes de la main courante avec 2 jeux de vis

6x32 ⑫ .

6

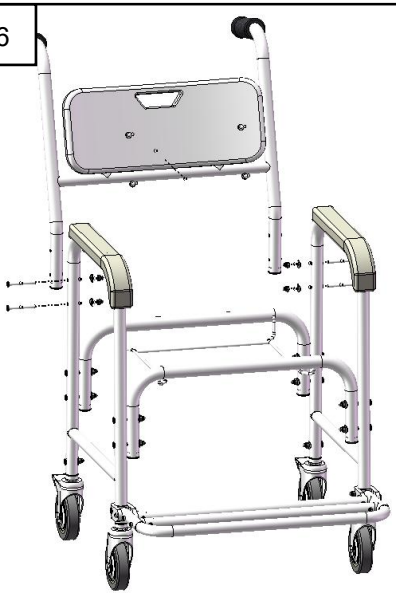

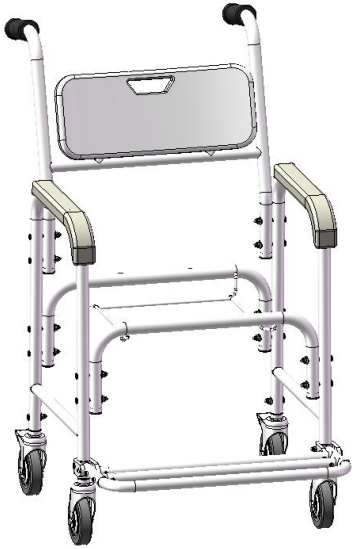

Utilisez 4 jeux de vis 6x58 ⑩ pour verrouiller le dossier ② sur le tube de la main courante.

7



Placez le seau ⑧ dans le tube de selle.

8



Installez le siège ⑦ sur le cadre du siège.

9



Comme le montre la figure, l'installation est terminée .

2.Instruction

1





Retirez le siège supérieur, soulevez le siège avec les trous vers le haut à la main, puis vous pouvez retirer le seau.

2





AVERTISSEMENT : La pédale doit être rétractée avant de se lever afin d'éviter toute blessure potentielle en cas de chute.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse : 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMODE

MODELL: FBL76063 7

COMMODE

MODELL: FBL760637



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG:

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, um Verletzungen, Produktschäden oder Garantieverlust zu vermeiden. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung der Symptome verspüren. Lassen Sie das Produkt gegebenenfalls beaufsichtigen, um es korrekt und sicher

zusammenzubauen und zu verwenden. Überschreiten Sie nicht das zulässige Gesamtgewicht.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Das Produkt ist auf ebenen, stabilen Flächen zu verwenden. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.
WARNUNG: Um mögliche Sturzverletzungen zu vermeiden, muss das Pedal vor dem Aufstehen eingefahren werden.

Physiotherapeut

1. Passen Sie vor dem ersten Gebrauch die Höhe und Breite der Stange an Ihre Toilette an.
2. Gehen Sie mit Ihrem Hilfsmittel (sofern vorhanden) rückwärts zur Toilette, bis die Rückseite Ihrer Beine die Toilette berührt .
3. Greifen Sie nach hinten zum Haltegriff, halten Sie ihn fest und lassen Sie sich langsam in eine sitzende Position auf der Toilette hinunter.
4. Um wieder in die stehende Position zurückzukehren, stützen Sie sich mit den Händen fest auf den Schienen ab und drücken Sie sich hoch, bis Sie stehen.
5. Sobald Sie stehen, lassen Sie die Stangen langsam los und greifen Sie erst dann nach dem Griff Ihres Hilfsmittels (falls vorhanden).

WICHTIG



1. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität.
2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder losen Teilen vorliegen.
4. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser und spülen Sie Seifenreste ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

5. Besprechen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt, ob das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

PART LIST

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und prüfen Sie sie sorgfältig auf Transportschäden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

NEIN	BILD	NAME	MENGE	NEIN	BILD	NAME	MENGE
①		Handlaufrohr	2	⑧		Eimer	1
②		Rückenlehne	1	⑨		Sattelrohr	1
③		Fußstütze	1	⑩		6x5 8 Schraubensatz	12
④		Vorderes U-förmiges Verbindungsrohr	1	⑪		6x4 2 Schraubensatz	2

⑤		Hinteres U-förmiges Verbindungsrohr	1	⑫		6x3 2 Schraubensatz	2
⑥		Rad	4	⑬		Sechskantschraubendreher	1
⑦		Sitz	1	⑭		Sechskantschlüssel	1


PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760637**
Hauptmaterialien	Aluminium
Sitzhöhe	49 0 mm/19. 3 "
Sitz Nennlast	159 kg/350 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

3. Installationsverfahren

1

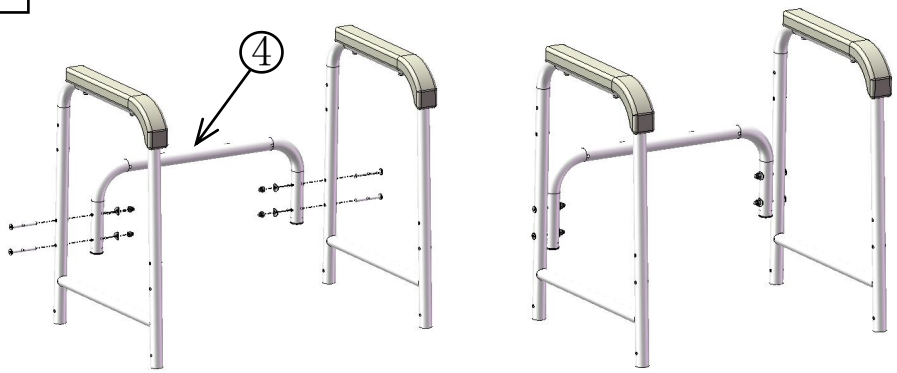


Mit 4 Stück 6x58 Schraubensätzen ⑩ das hintere U-förmige Verbindungsrohr ⑤ an den Handlaufrohren ① befestigen .

2




Stecken Sie das Sattelrohr ⑨ in die hintere U-förmige Verbindungsrohröffnung.


3

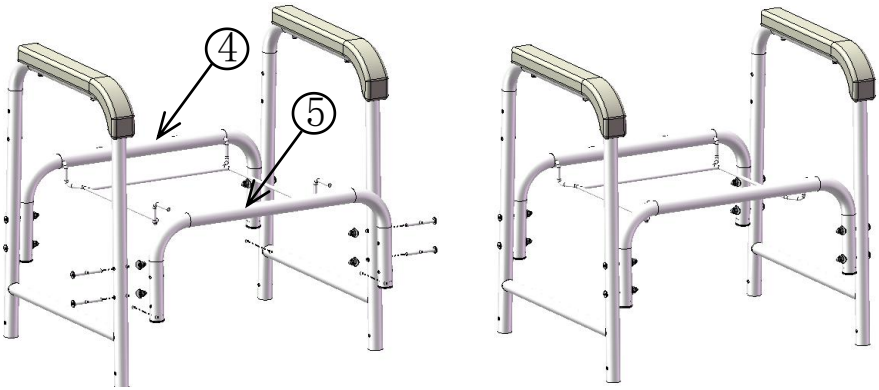

Führen Sie das vordere U-förmige Verbindungsrohr ④ in das Sattelrohr ein und verriegeln Sie es anschließend mit dem Handlauf mithilfe von 4 Stück 6x58 Schrauben ⑩ .


4

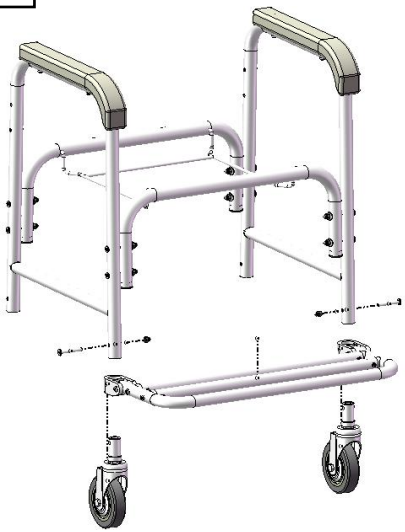


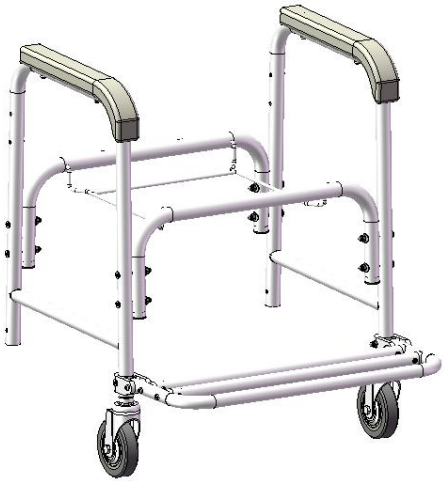

Befestigen Sie die Räder ⑥ und die Fußstütze mit 2 Stück 6x42 Schraubensätzen ⑪ an den Handlaufrohren .

5

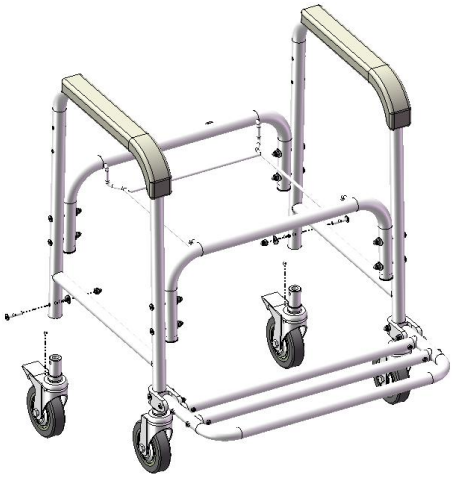


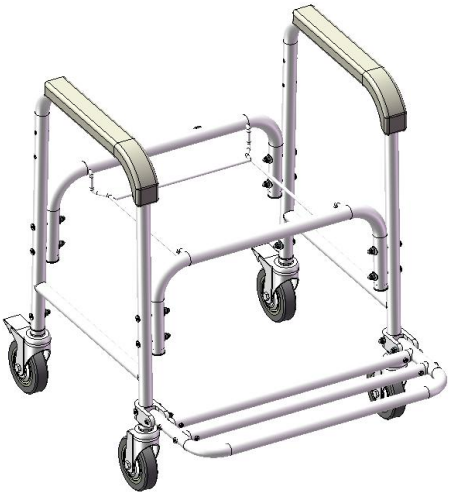


Befestigen Sie die Räder ⑥ mit 2 Stück 6x32 Schraubensätzen ⑫ an den

Handlaufrohren .

6

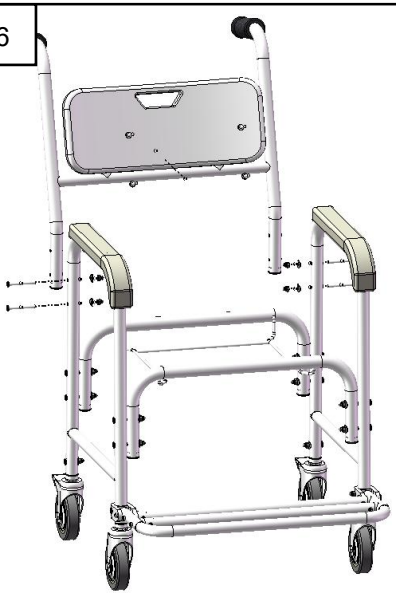

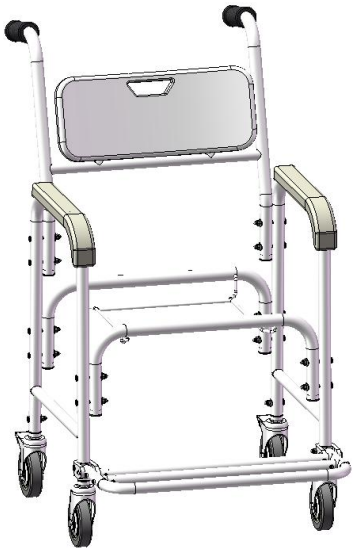

Zur Befestigung der Rückenlehne ② am Handlaufrohr verwenden Sie 4 Stück 6x58 Schraubensätze ⑩ .

7



Setzen Sie den Eimer ⑧ in das Sattelrohr ein.

8



Montieren Sie den Sitz ⑦ auf dem Sitzrahmen.

9



Wie in der Abbildung gezeigt, ist die Installation abgeschlossen .

2.Anweisung

1





Nehmen Sie den oberen Sitz ab, heben Sie den Sitz mit den Löchern mit der Hand nach oben und dann können Sie den Eimer herausnehmen.

2





WARNUNG: Um mögliche Sturzverletzungen zu vermeiden, muss das Pedal vor dem Aufstehen eingefahren werden.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMÒ

MODELLO: FBL76063 7

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELLO: FBL760637



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il manuale per evitare lesioni, danni al prodotto o invalidare la garanzia. Consultare un professionista in caso di disagio, dolore o peggioramento dei sintomi. Se necessario, sottoporsi a supervisione per montare e utilizzare il prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso.

Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe comprometterne la longevità. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.
ATTENZIONE: per evitare possibili infortuni dovuti a cadute, il pedale deve essere retratto prima di alzarsi in piedi.

Fisioterapista

1. Prima del primo utilizzo, adattare l'altezza e la larghezza della barra al WC.
2. Torna indietro verso il water con il tuo dispositivo di assistenza (se disponibile) finché la parte posteriore delle gambe non tocca il water.
3. Raggiungi la ringhiera, tienila saldamente e abbassati lentamente fino a raggiungere la posizione seduta sul water.
4. Per tornare in posizione eretta, appoggia saldamente le mani sui corrimano e spingiti verso l'alto per tornare in posizione eretta.
5. Una volta in piedi, lascia andare gradualmente i corrimano e solo allora afferra la maniglia del tuo dispositivo di assistenza (se disponibile).



IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso massima.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente con un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali residui di sapone. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PART LIST

Quando si disimballa il prodotto, verificare che i componenti elencati di seguito siano inclusi e ispezionarli attentamente per eventuali danni verificatisi durante il trasporto. Se un componente risulta mancante o danneggiato, non tentare di montare o utilizzare il prodotto.

NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ	NO	IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
①		Tubo corrimano	2	⑧		Secchio	1
②		Schienale	1	⑨		Tubo sella	1
3.		Poggiapiedi	1	⑩		Set di viti 6x5 8	12
④		Tubo di collegamento anteriore a forma di U	1	⑪		Set di 2 viti 6x4	2
⑤		Tubo di collegamento posteriore a forma di U	1	⑫		Set di 2 viti 6x3	2
⑥		Ruota	4	⑬		Cacciavite esagonale	1

⑦		Posto a sedere	1	⑭		Chiave esagonale	1


PRODUCT PAREMETERS

Modello	**FBL760637**
Materiali principali	Alluminio
Altezza del sedile	49 0 mm/ 19,3 "
Posto a sedere Carico nominale	159 kg/350 libbre

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

4. Procedure di installazione

1

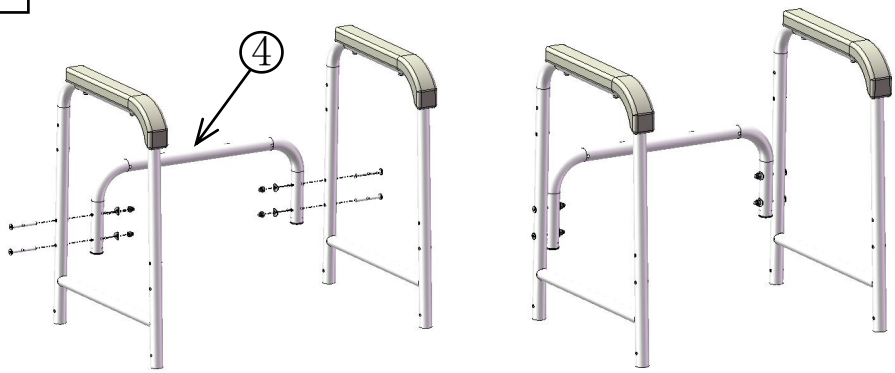


Utilizzare 4 set di viti 6x58 ⑩ per bloccare il tubo di collegamento posteriore a forma di U ⑤ ai tubi del corrimano ① .

2




Inserire il tubo sella ⑨ nel foro del tubo di collegamento posteriore a forma di U.


3

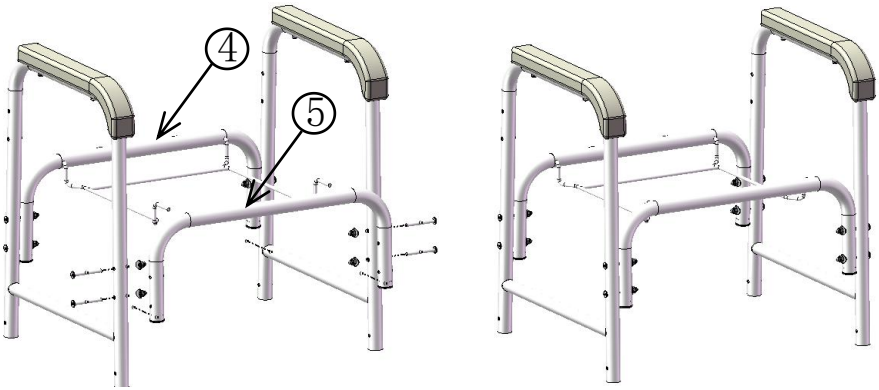

Inserire il tubo di collegamento anteriore a forma di U ④ nel tubo del sedile e quindi bloccarlo con il corrimano utilizzando 4 viti 6x58 ⑩ .


4

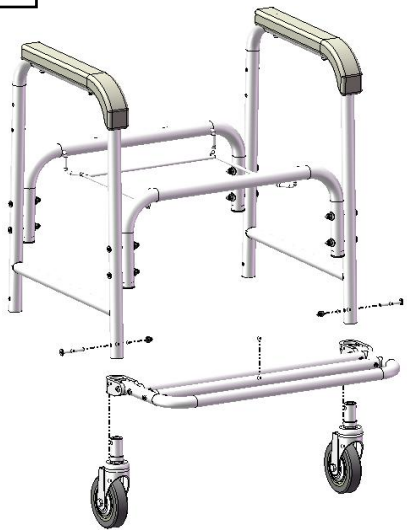


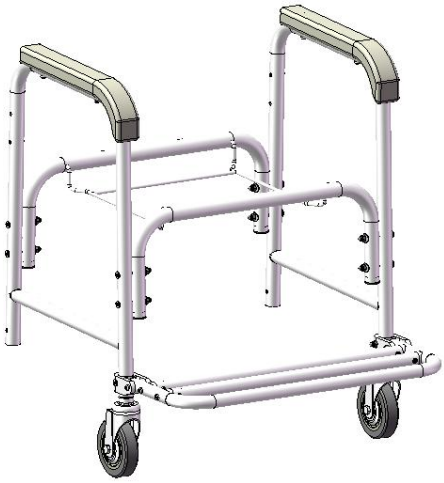

Bloccare le ruote ⑥ e il poggiapiedi ai tubi del corrimano con 2 set di viti 6x42 ⑪ .


5

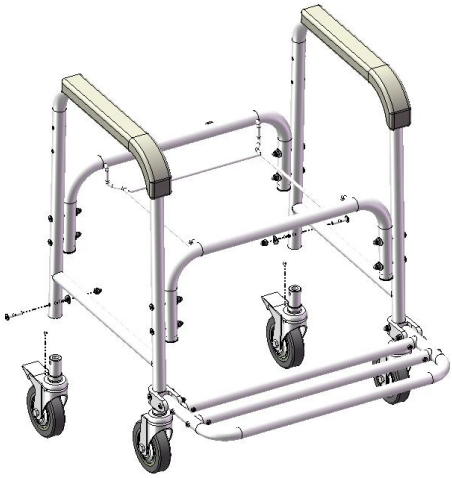

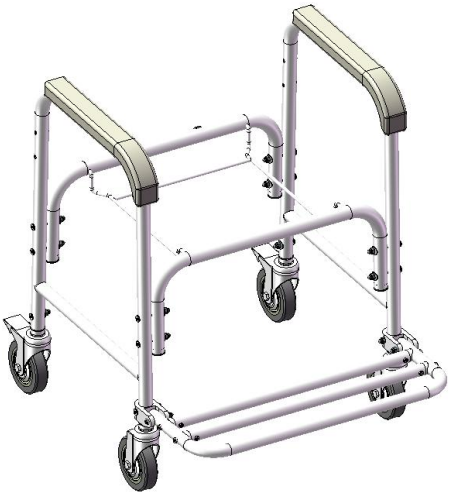

Bloccare le ruote ⑥ ai tubi del corrimano con 2 set di viti 6x32 ⑫ .

6

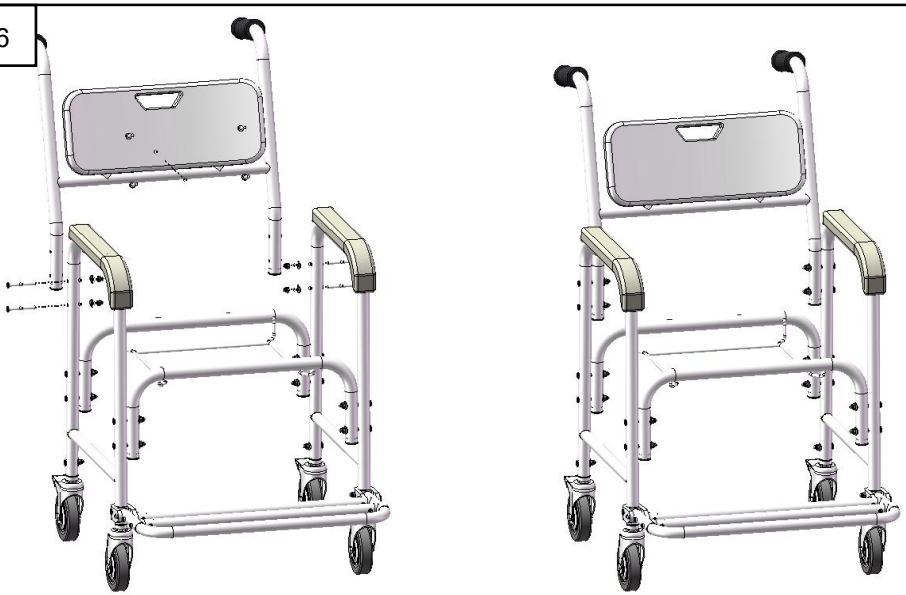

Utilizzare 4 set di viti 6x58 ⑩ per bloccare lo schienale ② al tubo del corrimano.

7



Posizionare il secchio ⑧ nel tubo del sedile.

8



Installare il sedile ⑦ sul telaio del sedile.


9



Come mostrato nella figura, l'installazione è completata .

2.Istruzione

1

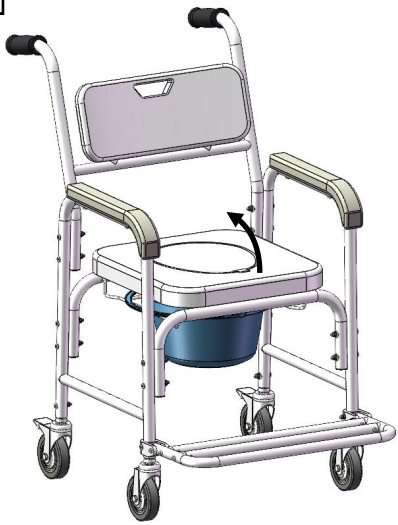



Togliere il sedile superiore, sollevare manualmente il sedile con i fori verso l'alto e quindi estrarre il secchio.

2





ATTENZIONE: per evitare possibili infortuni dovuti a cadute, il pedale deve essere retratto prima di alzarsi in piedi.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CÓMODA

MODELO: FBL76063 7

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELO: FBL760637



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea el manual completo para evitar daños al producto o la anulación de la garantía. Busque ayuda profesional si experimenta molestias, dolor o empeoramiento de los síntomas. Si es necesario, utilice la supervisión de un adulto para ensamblar y usar este producto de forma correcta y segura. No

exceda el límite de peso.

Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y, en caso de duda, contacte con el servicio de asistencia. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. El producto debe utilizarse sobre superficies planas y estables. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.
ADVERTENCIA: El pedal debe estar retraído antes de ponerse de pie para evitar posibles lesiones por caídas.

Fisioterapeuta

1. Antes del primer uso, ajuste la altura y el ancho del riel a su inodoro.
2. Retroceda hasta el inodoro con su dispositivo de asistencia (si está disponible) hasta que la parte posterior de sus piernas toque el inodoro.
3. Alcance la barandilla hacia atrás, agárrese firmemente y bájese lentamente hasta quedar en posición sentada en el inodoro.
4. Para volver a la posición de pie, coloque las manos firmemente sobre los rieles y empújese hacia arriba hasta quedar de pie.
5. Una vez que esté de pie, suelte gradualmente los pasamanos y, solo entonces, agarre el mango de su dispositivo de asistencia (si está disponible).


IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad máxima de peso.
2. Úselo únicamente en superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, y enjuague cualquier residuo de jabón. Después de limpiar, seque bien.
5. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PART LIST

Al desembalar este producto, compruebe que las piezas que se indican a continuación estén incluidas e inspecciónelas cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD	NO	IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
①		Tubo de pasamanos	2	⑧		Balde	1
2		Respaldo	1	⑨		tubo del asiento	1
③		Reposapiés	1	⑩		Juego de tornillos 6x5 8	12
④		Tubo de conexión delantero en forma de U	1	⑪		de 2 tornillos 6x4	2
5		Tubo de conexión trasero en forma de U	1	⑫		de 2 tornillos 6x3	2

⑥		Rueda	4	⑬		destornillador hexagonal	1
⑦		Asiento	1	⑭		llave hexagonal	1


PRODUCT PAREMETERS

Modelo	**FBL760637**
Materiales principales	Aluminio
Altura del asiento	490 mm / 19,3 "
Asiento Carga nominal	159 kg/350 libras

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

5. Procedimientos de instalación

1

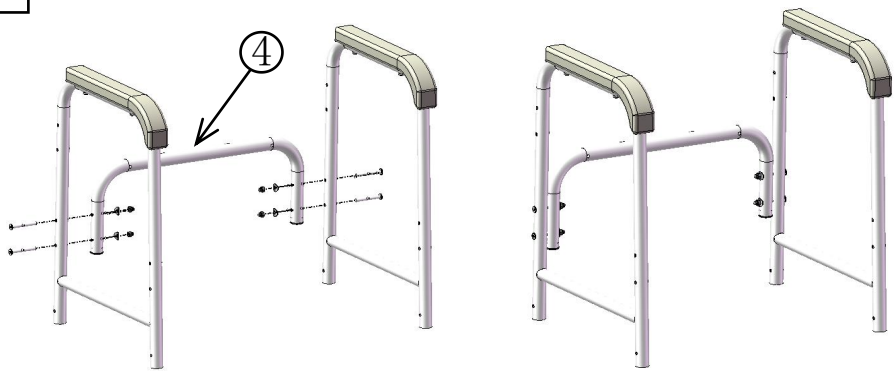


Utilice 4 juegos de tornillos 6x58 ⑩ para bloquear el tubo de conexión trasero en forma de U ⑤ a los tubos del pasamanos ① .

2




Inserte el tubo del asiento ⑨ en el orificio del tubo de conexión trasero en forma de U.


3

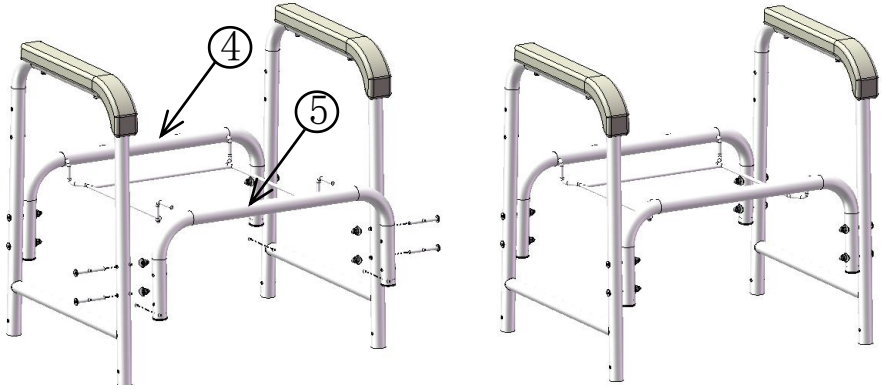

Inserte el tubo de conexión delantero en forma de U ④ en el tubo del asiento y luego bloquéelo con el pasamanos usando 4 tornillos 6x58 ⑩ .


4

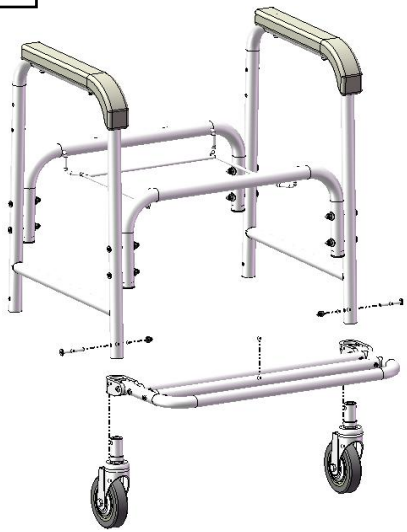


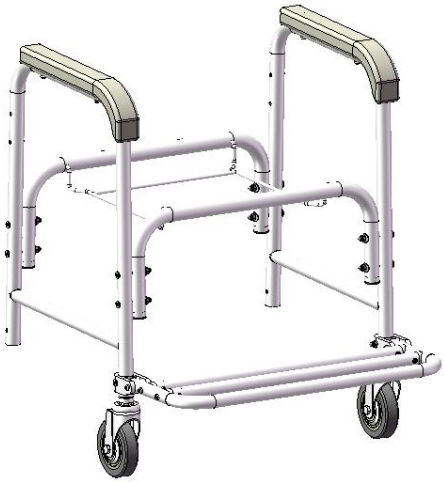

Bloquee las ruedas ⑥ y el reposapiés a los tubos del pasamanos con 2 juegos de tornillos 6x42 ⑪ .

5

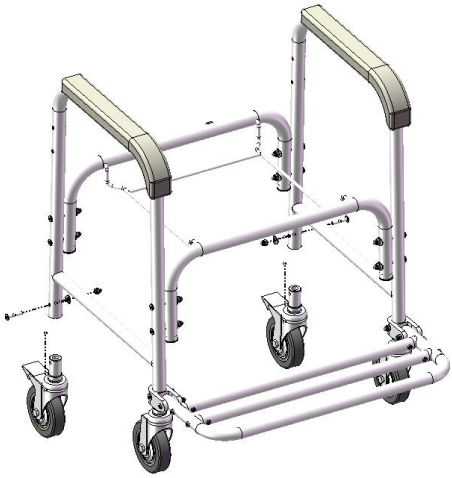


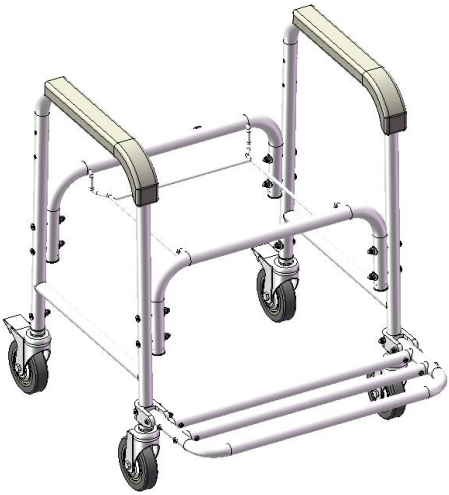


Bloquee las ruedas ⑥ a los tubos del pasamanos con 2 juegos de tornillos 6x32

⑫ .

6

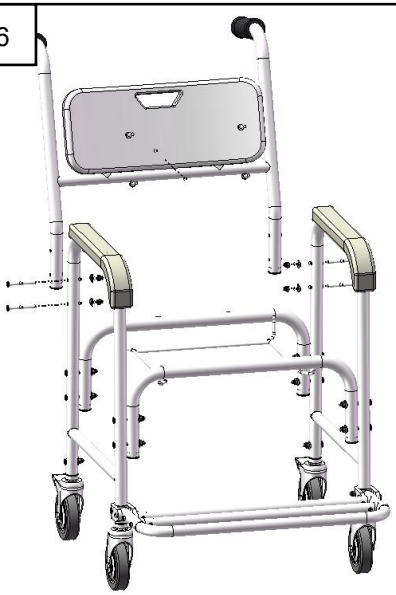

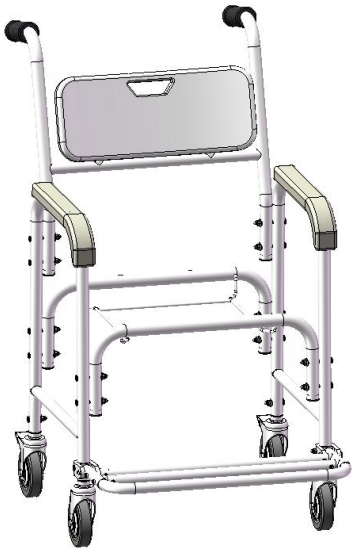

Utilice 4 juegos de tornillos 6x58 ⑩ para bloquear el respaldo ② al tubo del pasamanos.

7



Coloque el cubo ⑧ en el tubo del asiento.

8



Instale el asiento ⑦ en el marco del asiento.


9



Como se muestra en la figura, la instalación está completa .

2.Instrucción

1

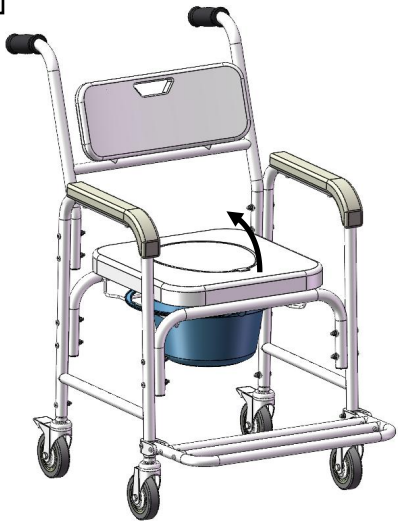



Quita el asiento superior, levanta el asiento con los orificios hacia arriba con la mano y luego podrás sacar el cubo.

2





ADVERTENCIA: El pedal debe estar retraído antes de ponerse de pie para evitar posibles lesiones por caídas.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMODA

MODEL: FBL76063 7

COMMODE

MODEL: FBL760637



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj instrukcję w całości, aby uniknąć szkód, uszkodzeń produktu lub naruszenia gwarancji. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub pogorszenia objawów należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. W razie potrzeby należy skorzystać z nadzoru w celu prawidłowego i bezpiecznego montażu i

użytkowania produktu. Nie przekraczać limitu wagowego.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nogi produktu są równe i zablokowane, a jeśli pojawią się oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części, przerwij użytkowanie. Produkt należy używać na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie rozmontowuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, chyba że określono to w instrukcji.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem, przed wstaniem należy cofnąć pedał.

Fizjoterapeuta

1. Przed pierwszym użyciem należy dopasować wysokość i szerokość poręczy do swojej toalety.
2. Cofnij się do toalety, korzystając z urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne), aż tylna strona twoich nóg będzie dotykać toalety.
3. Sięgnij do tyłu po poręcz, mocno ją chwyć i powoli opuść się do pozycji siedzącej na toalecie.
4. Aby powrócić do pozycji stojącej, mocno oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się do pozycji stojącej.
5. Gdy już staniesz, stopniowo puść poręcze i dopiero wtedy chwyć za uchwyt urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne).


WAŻNY

1. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciężaru.
2. Stosować wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub poluzowanych części.
4. Czyść regularnie łagodnym detergentem i ciepłą wodą, spłucz wszelkie pozostałości mydła. Po czyszczeniu dokładnie osusz.
5. Przed użyciem należy potwierdzić u swojego lekarza, czy produkt spełnia Twoje szczególne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PART LIST

Podczas rozpakowywania tego produktu sprawdź, czy wymienione poniżej części są dołączone i dokładnie sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jakaś część jest uszkodzona lub brakuje jej, nie próbuj montować ani używać produktu.

NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ	NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	ILOŚĆ
①		Rura poręczy	2	⑧		Wiaderko	1
②		Oparcie	1	⑨		Rura podsiodłowa	1
③		Podnóżek	1	⑩		Zestaw śrub 6x58	12
④		Przednia rura łącząca w kształcie litery U	1	⑪		6x4 2 zestaw śrub	2
⑤		Tylna rura łącząca w kształcie litery U	1	⑫		6x3 2 zestaw śrub	2

⑥		Koło	4	⑬		Śrubokręt sześciokątny	1
⑦		Siedziba	1	⑭		Klucz sześciokątny	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760637
Główne materiały	Aluminium
Wysokość siedziska	49,0 mm / 19,3 cala
Siedziba Obciążenie znamionowe	159 kg/350 funtów

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

6. Procedury instalacyjne

1

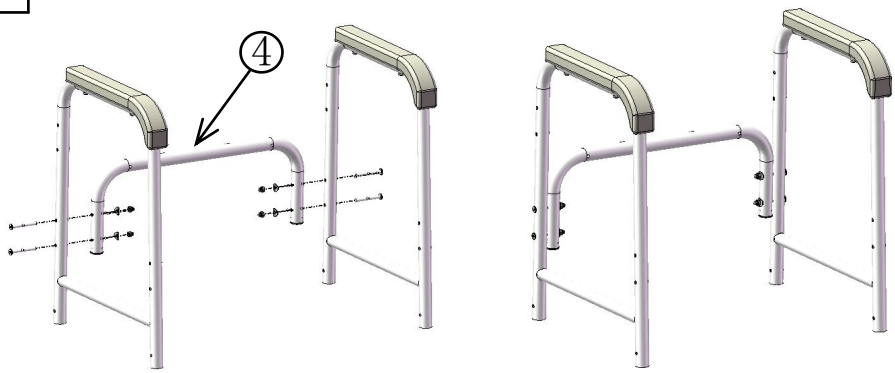


Za pomocą 4 zestawów śrub 6x58 ⑩ zamocuj tylną rurę łączącą w kształcie litery U ⑤ do rur poręczy ① .

2




Włóż rurę podsiodłową ⑨ do tylnego otworu łączącego w kształcie litery U.


3

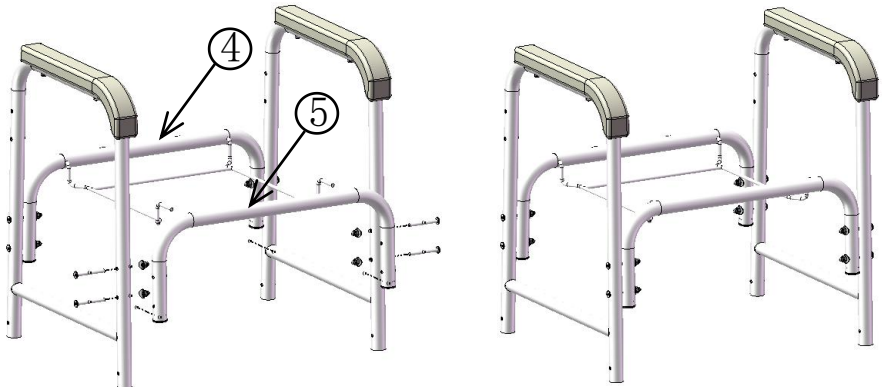

Włóż przednią rurę łączącą w kształcie litery U ④ do rury podsiodłowej, a następnie zablokuj ją przy poręczy za pomocą 4 śrub 6x58 ⑩ .


4

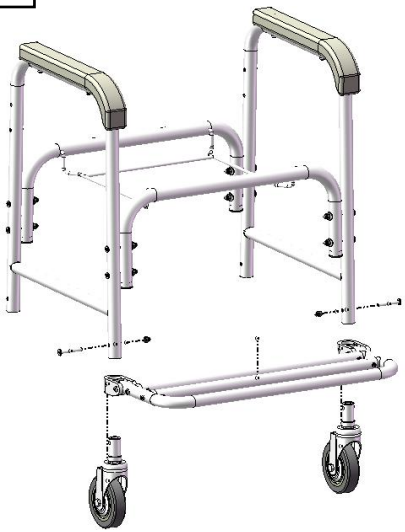


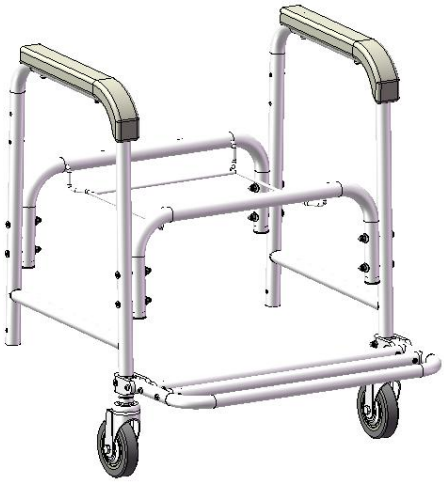

Zablokuj koła ⑥ i podnóżek do rur poręczy za pomocą 2 zestawów śrub 6x42 ⑪ .


5

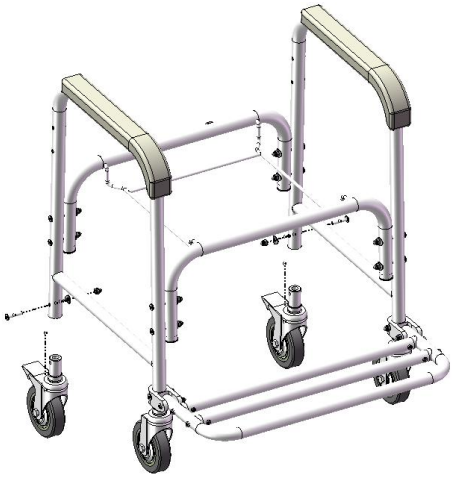

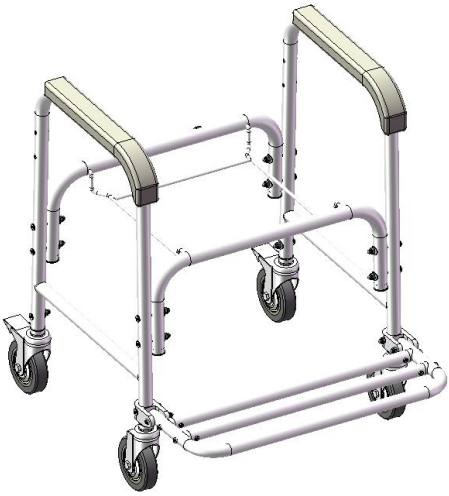

Zablokuj kółka ⑥ do rur poręczy za pomocą 2 zestawów śrub 6x32 ⑫ .

6

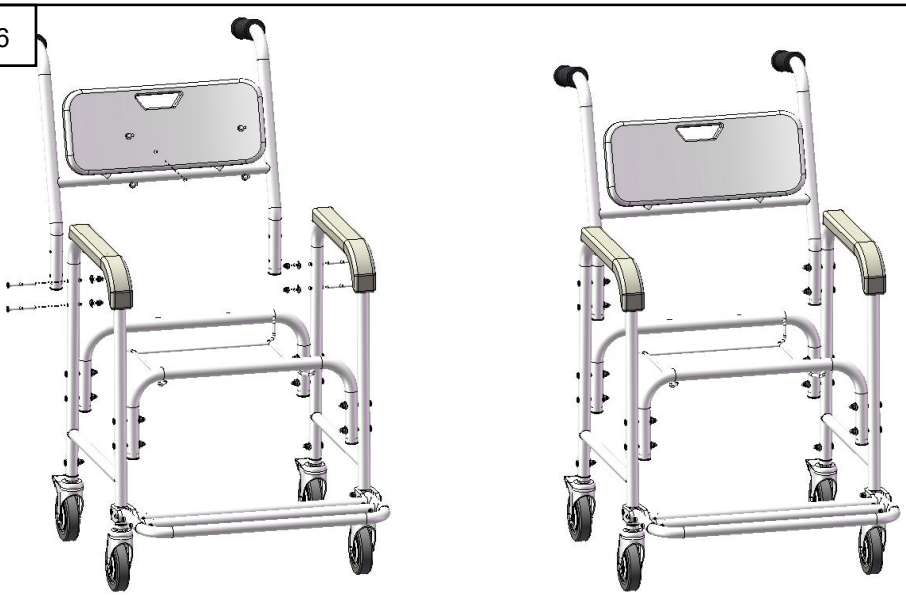

Za pomocą 4 zestawów śrub 6x58 ⑩ zamocuj oparcie ② do rury poręczy.

7



Umieść wiaderko ⑧ w rurze podsiodłowej.

8



Zamontuj siedzisko ⑦ na ramie siedziska.


9



Jak pokazano na rysunku, instalacja jest ukończona .

2. Instrukcja

1

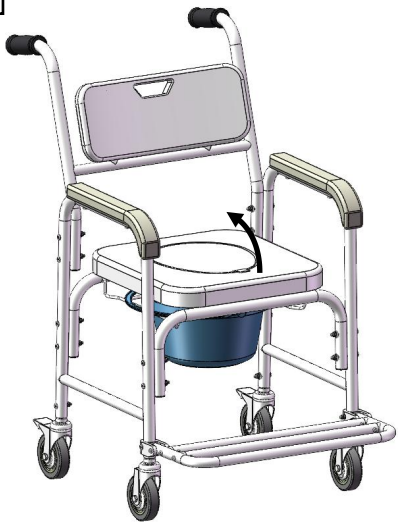



Zdejmij górne siedzenie, podnieś je ręcznie otworami do góry, a następnie możesz wyjąć kubełek.

2





OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem, przed wstaniem należy cofnąć pedał.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOILET

MODEL: FBL76063 7

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODEL: FBL760637



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om letsel, productschade of het vervallen van de garantie te voorkomen. Raadpleeg een professional als u ongemak, pijn of verergering van de symptomen ervaart. Zorg indien nodig voor toezicht om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken. Overschrijd de

gewichtslimiet niet.

Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Het product moet worden gebruikt op vlakke, stabiele oppervlakken. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.
WAARSCHUWING: Voordat u opstaat, moet u het pedaal intrekken om letsel door vallen te voorkomen.

Fysiotherapeut

1. Stel voor het eerste gebruik de hoogte en de breedte van de rail op uw toilet in.
2. Ga met uw hulpmiddel (indien beschikbaar) naar het toilet toe totdat de achterkant van uw benen het toilet raakt .
3. Reik naar achteren naar de leuning, houd deze stevig vast en laat uzelf langzaam zakken tot u op het toilet zit.
4. Om weer rechtop te gaan staan, plaatst u uw handen stevig op de rails en duwt u uzelf omhoog tot u weer rechtop staat.
5. Zodra u staat, laat u de leuningen geleidelijk los en pakt u pas daarna de handgreep van uw hulpmiddel vast (indien beschikbaar).


BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Reinig regelmatig met een mild reinigingsmiddel en warm water en spoel eventuele zeepresten af. Droog na het reinigen grondig af.
5. Controleer vóór gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en controleer ze zorgvuldig op eventuele transportschade. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL	NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
①		Leuningbuis	2	⑧		Emmer	1
②		Rugleuning	1	⑨		Zitbuis	1
③		Voetsteun	1	⑩		6x5 8 Schroevenset	12
④		Voorzijde U-vormige verbindingsbuis	1	⑪		6x4 2 Schroevenset	2
⑤		Achterste U-vormige verbindingsbuis	1	⑫		6x3 2 Schroevenset	2
⑥		Wiel	4	⑬		Zeskant schroevendraaie	1

						r	
⑦		Stoel	1	⑭		Inbussle utel	1


PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760637
Belangrijkste materialen	Aluminium
Zithoogte	49,0 mm / 19,3 "
Stoel Nominale belasting	159 kg/350 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

7. Installatieprocedures

1

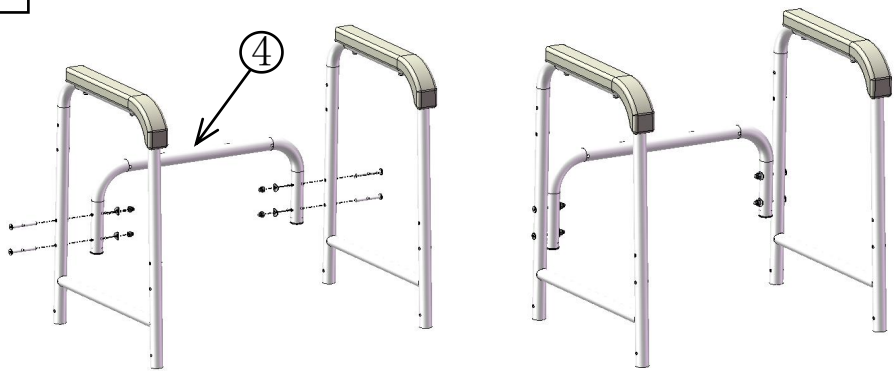


Gebruik 4 stuks 6x58 schroefsets ⑩ om de achterste U-vormige verbindingsbuis ⑤ aan de leuningbuizen ① te bevestigen .

2




Steek de zitbuis ⑨ in het achterste U-vormige verbindingsbuisgat.


3

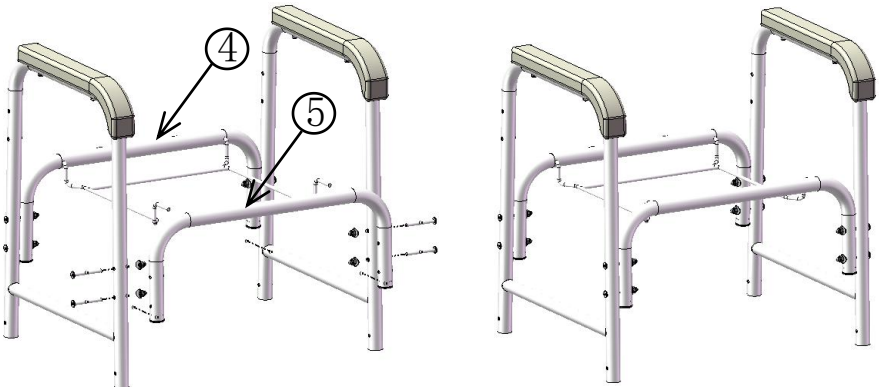

Plaats de voorste U-vormige verbindingsbuis ④ in de zitbuis en zet deze vervolgens vast aan de leuning met behulp van 4 schroeven van 6x58 ⑩ .


4

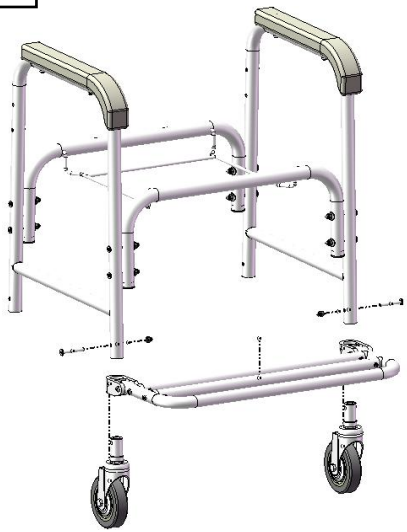


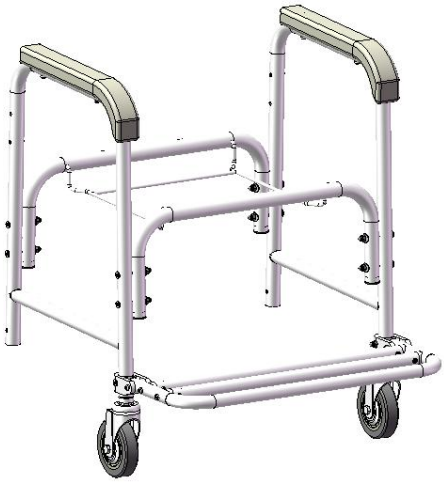

Bevestig de wielen ⑥ en de voetensteun aan de leuningbuizen met 2 schroevensets van 6x42 ⑪ .


5

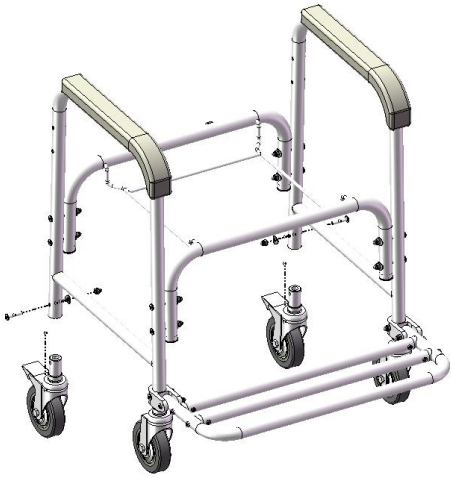

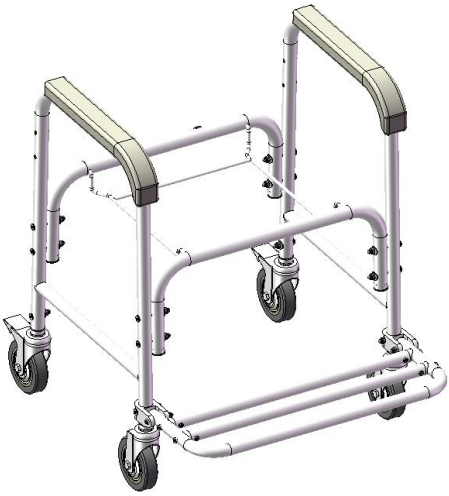

Bevestig de wielen ⑥ aan de leuningbuizen met 2 stuks 6x32 schroefsets ⑫ .

6

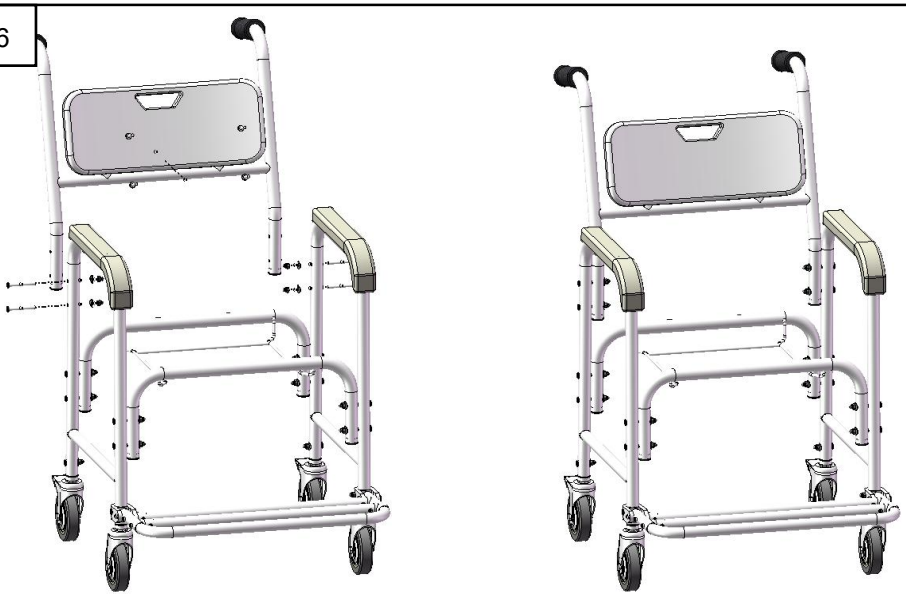

Gebruik 4 schroevensets van 6x58 ⑩ om de rugleuning ② aan de leuningbuis te bevestigen.

7



Plaats de emmer ⑧ in de zitbuis.

8



Plaats de stoel ⑦ op het stoelframe.


9



Zoals in de afbeelding te zien is, is de installatie voltooid .

2. Instructie

1

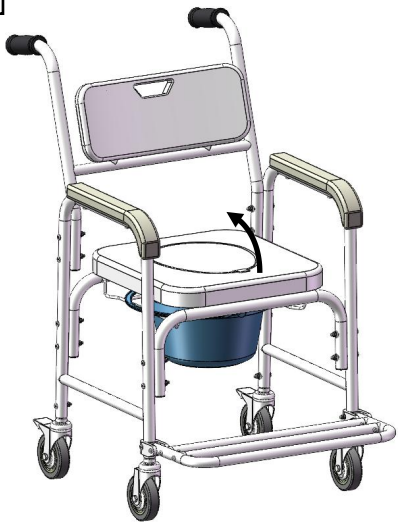



Haal de bovenste stoel eraf, til de stoel met de gaten met de hand omhoog en dan kun je de emmer eruit halen.

2





WAARSCHUWING: Voordat u opstaat, moet u het pedaal intrekken om letsel door een val te voorkomen.

Zhongshan Bliss Medisch Instrument Co., Ltd.
Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMOD

MODELL: FBL76063 7

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMODE

MODELL: FBL760637



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs hela manualen för att undvika skada, produktskador eller att garantin inte gäller. Sök professionell hjälp om du upplever obehag, smärta eller förvärrade symtom. Om det behövs, använd övervakning för att montera och använda produkten korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.

Kontrollera regelbundet att produkten är säkert monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.
VARNING: Pedalen måste dras in innan du ställer dig upp för att undvika risk för fallskador.

Fysioterapeut

1. Justera skenans höjd och bredd efter din toalett före första användningen.
2. Backa upp till toaletten med ditt hjälpmedel (om tillgängligt) tills baksidan av dina ben nuddar toaletten.
3. Sträck dig bakåt efter toalettstången, håll fast den och sänk dig långsamt ner i sittande position på toaletten.
4. För att återgå till stående position, placera händerna ordentligt på skenorna och tryck dig upp till stående position.
5. När du står upp, släpp gradvis taget om skenorna och först då tar du tag i handtaget på ditt hjälpmedel (om det finns ett).



VIKTIG

1. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten och skölj bort eventuella tvålrester. Torka noggrant efter rengöring.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PART LIST

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera dem noggrant för att se om det finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

INGA	BILD	NAMN	ANTAL	INGA	BILD	NAMN	ANTAL
①		Ledstångsrör	2	⑧		Hink	1
②		Ryggstöd	1	⑨		Sadelrör	1
③		Fotstöd	1	⑩		6x5 8 Skruvsats	12
④		Främre U-format anslutningsrör	1	⑪		6x4 2 Skruvsats	2
⑤		Bakre U-formade anslutningsrör	1	⑫		6x3 2 Skruvsats	2
⑥		Hjul	4	⑬		Sexkant skruvmejsel	1
⑦		Plats	1	⑭		Sexkant snyckel	1


PRODUCT PAREMETERS

Modell	**FBL760637**
Huvudmaterial	Aluminium
Sitthöjd	49,0 mm / 19,3 tum
Plats Nominell belastning	159 kg/350 lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

8. Installationsprocedurer

1

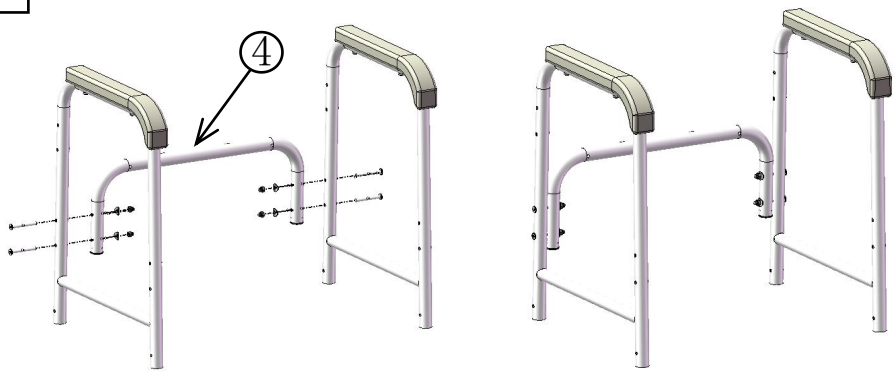


Använd 4 st 6x58 skruvsatser ⑩ för att låsa det bakre U-formade anslutningsröret ⑤ till ledstångsrören ① .

2




Sätt in sadelröret ⑨ i det bakre U-formade anslutningsrörshålet.


3

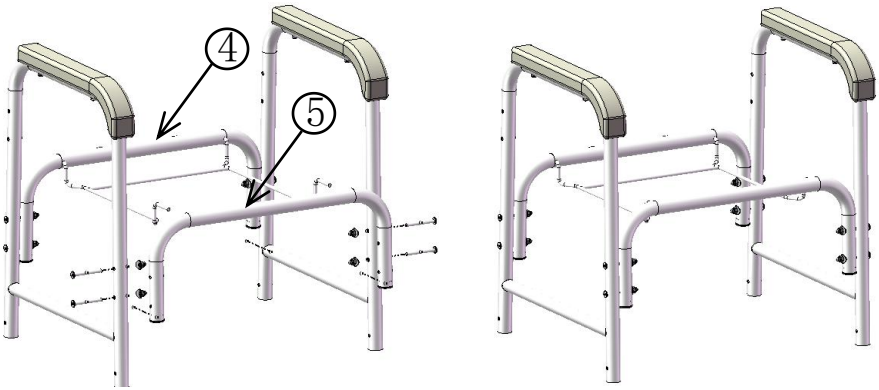

Sätt i det främre U-formade anslutningsröret ④ i sadelröret och lås det sedan med ledstången med 4 st 6x58 skruvar ⑩ .


4

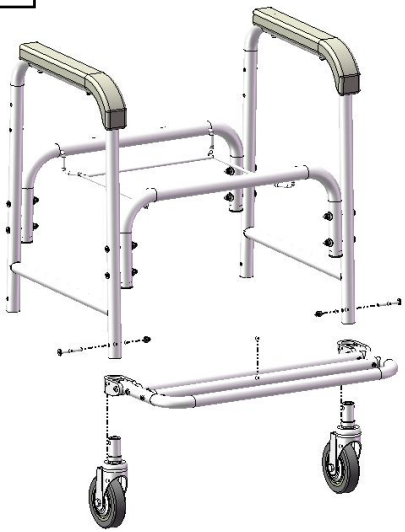


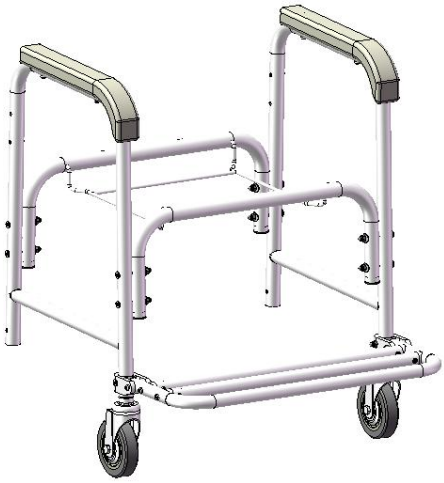

Lås hjulen ⑥ och fotstödet till ledstångsrören med 2 st 6x42 skruvsatser ⑪ .


5

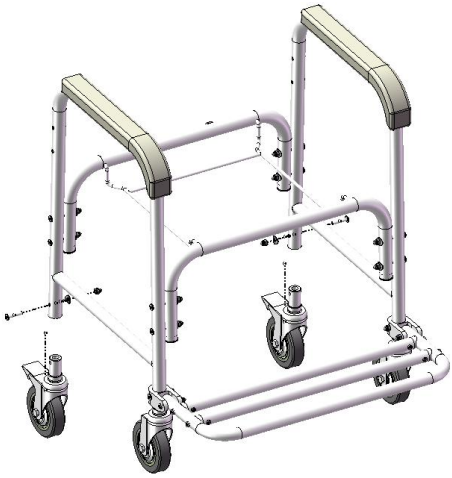

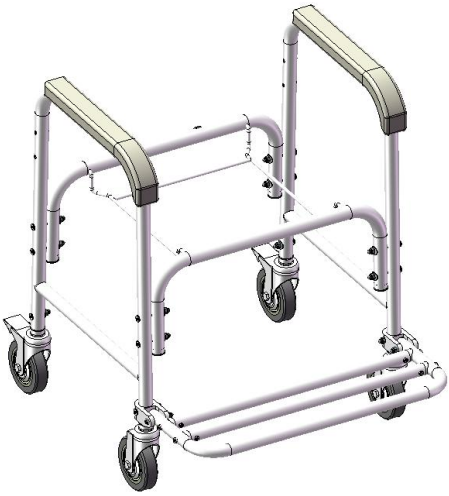

Lås hjulen ⑥ till ledstångsrören med 2 st 6x32 skruvsatser ⑫ .

6

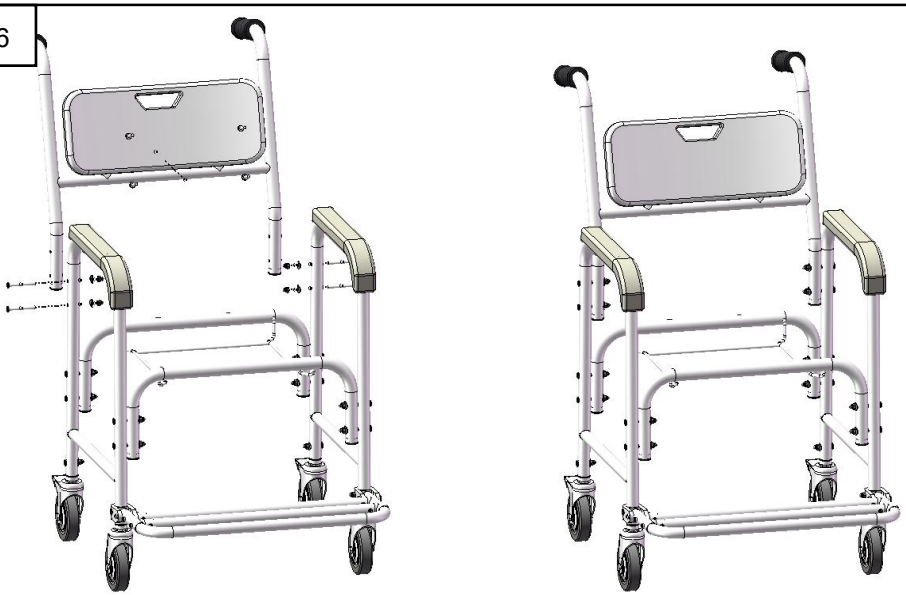

Använd 4 st 6x58 skruvsatser ⑩ för att låsa ryggstödet ② till ledstödsröret.

7



Placera hinken ⑧ i sadelröret.

8



Montera sätet ⑦ på sätesramen.

9



Som visas på bilden är installationen klar .

2. Instruktion

1





Ta bort det övre sätet, lyft sätet med hål uppåt för hand, och sedan kan du ta ut hinken.

2





VARNING: Pedalen måste dras in innan du ställer dig upp för att undvika risk för fallskador.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Adress: 3-6F och 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

