VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINER

MODEL: D577-J

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINER

MODEL: D577-J



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

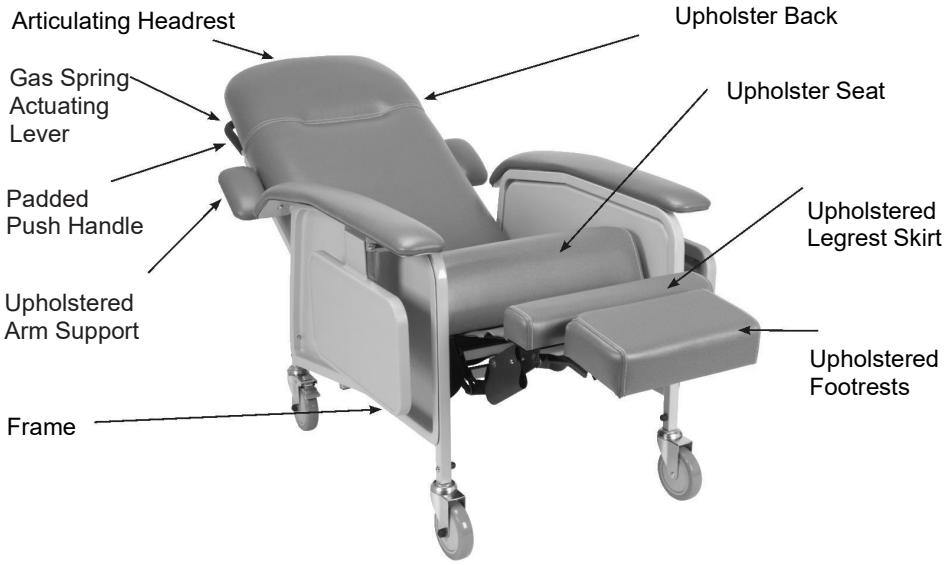


Figure 1

NOTE: Excessive force or effort is never necessary to change the seating position of the chair. Do not operate recliner by applying force or pressure to legrest.

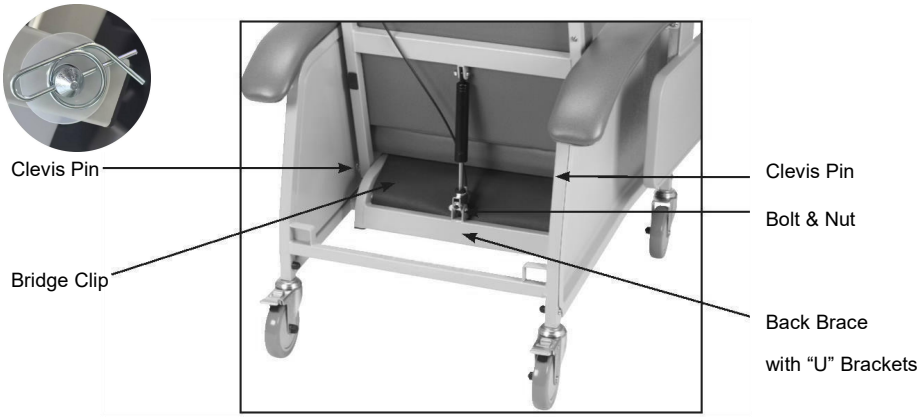


Figure 2

NOTE: After removing all components from the carton, engage the two casterlocks before beginning assembly.

Figure 2 shows location of two clevis pins, two ring cotter clips, one bolt, and one nut. Remove all above hardware from the back brace.

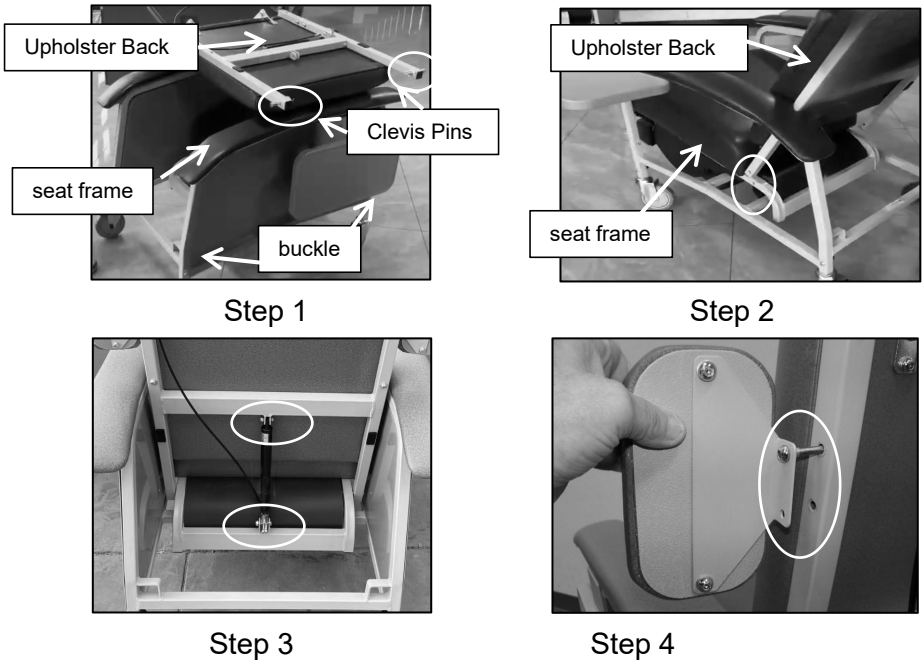


Figure 3

Step1: Undo the Clevis Pins on Upholster Back, both sides so mounting holes are exposed. Press the buckles to remove the side plates(both side).

Step2: Align the holes on the upright back tubes of the upholstered back with the holes on the seat frame. Replace the clevis pins through the mounting holes. Secure the two clevis pins by replacing the bridge clips.

Step3: Remove cardboard shipping retainers from around Gas Spring Cylinder. The holes at both ends of the gas spring are aligned with the holes in the seat fame cross brace and the holes in the upholster back.

Step4: Align holes in arm support mount to mounting holes in seat frame. Secure screw with nut.Repeat for other side.

Slide Tables

To place either table in raised position:

Raise table all the way up and slide in until tabs engage slots in mount bracket. Press down lightly on table to ensure lock tabs are engaged.

To return table to self-storing position:

Lift table up until tabs disengage slots. Slide out and allow table to lower. See Figure 4.

Articulating Headrest

Articulating headrest may be adjusted to a comfortable position by pulling forward or pushing back.

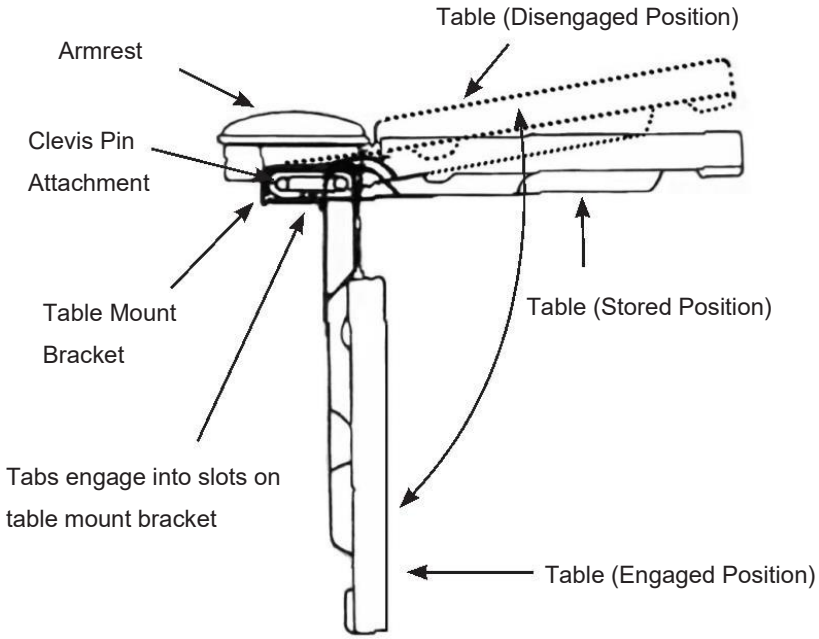


Figure 4

Seat Positioning

Upright:Initial position.From any position,grasp the gas spring actuating lever, slowly guide the back up fully and release the lever. Return patient to desired position by pushing upward on padded push handle.

Deep recline:From Initial position, grasp the gas spring actuating lever with one hand, push back on padded push handle.

Elevated leg rest:From Initial position,do not grasp the gas spring actuating lever, push back on padded push handle.

Ttrendelenburg position:From any position,grasp the gas spring actuating lever with one hand while actuating the lever with the other, slowly guide the back down fully and release the lever.

Other:Articulating headrest may be adjusted to desired position by pulling forward or pushing back.



upright




deep recline



elevated leg rest



trendelenburg position

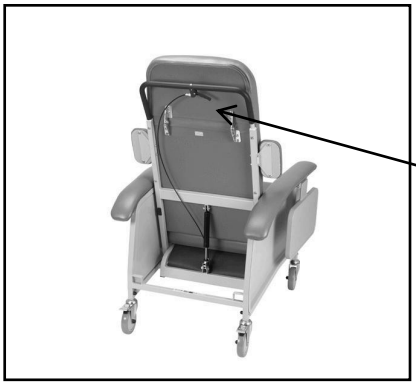

Upright(back)

Figure 5

CASTER OPERATION

To lock casters:

To prevent the rear casters from turning, step on the rear pedal of the caster until the pedal engages. (Front of pedal will protrude from wheel cover).

To unlock casters:

Step on the protruding front part of the pedal to disengage lock to unlatch.

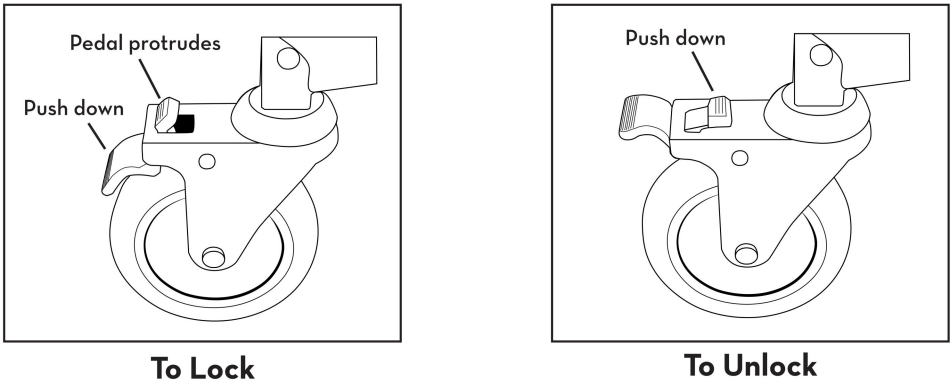


Figure 6

CAUTION:

Do not operate recliner by applying force or pressure to the legrest. Avoid placing hands or legs in creases near recliner mechanism.

Casters must be locked except during transport.

MAINTENANCE&CLEANING

EVERY THREE MONTHS

Check and clean casters/Tighten nuts/Check brakes on casters/Check and clean lock recline mechanism

For upholstery maintenance and stain removal, the following hints will be helpful:

Ordinary dirt: Wash with warm awater and a mild soap or detergent.

Stubbon dirt: Using a soff bristle brush, follow directions above.

Ground-in dirt: Scrub with powdered cleanser or similar detergent.

Chewing gum: Scrape carefully.

Nail polish and remover: Blot immediately to prevent damage.

Ball point pen: Blot immediately with a white cloth dampened in watch or mineral oil.

Waxing and reffnishing: Improver wearability. Use any quality paste wax.

A diluted solution of 10% (or less) of bleach or clorox may be used when cleaning this chair.

Manufacturer: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd
Address: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province,214400,China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL INCLINABLE

MODÈLE : D577-J

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODÈLE : D577-J



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Figure 1

REMARQUE : Il n'est jamais nécessaire d'exercer une force ou un effort excessif pour modifier la position d'assise du fauteuil. N'exercez pas de force ou de pression sur le repose-jambes pour actionner le fauteuil inclinable.


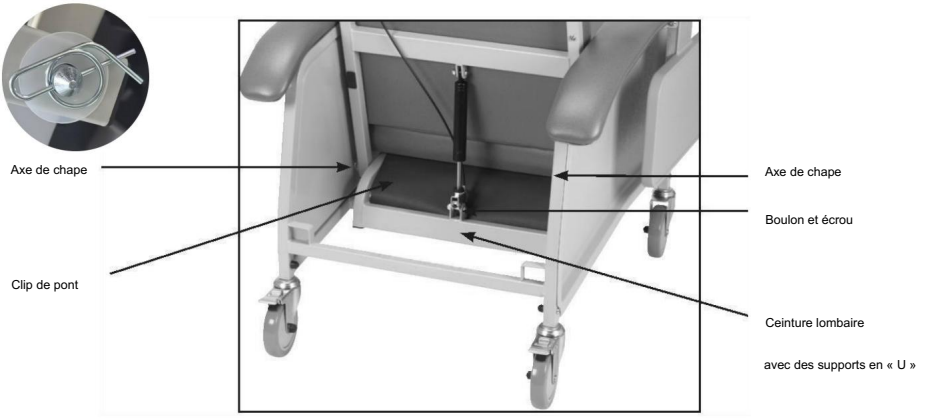


Figure 2


REMARQUE : Après avoir retiré tous les composants du carton, engagez les deux verrous de roulettes avant de commencer l'assemblage.

Machine Translated by Google


La figure 2 montre l'emplacement de deux axes de chape, de deux clavettes, d'un boulon et d'un écrou. Retirez toute la visserie ci-dessus du renfort arrière.

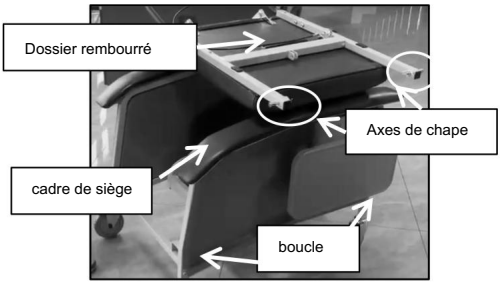

Étape 1

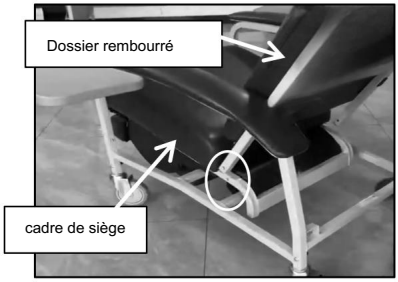

Étape 2

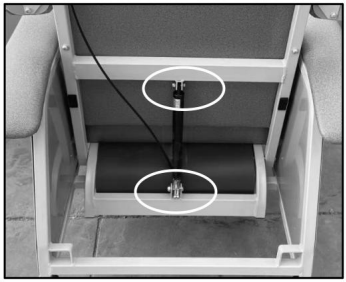

Étape 3



Étape 4

Figure 3

Étape 1 : Défaites les goupilles de chape sur le dossier rembourré, des deux côtés afin que les trous de montage soient exposé. Appuyez sur les boucles pour retirer les plaques latérales (des deux côtés).

Étape 2 : Alignez les trous sur les tubes verticaux du dossier rembourré avec les
Percez les trous sur le cadre du siège. Replacez les axes de chape dans les trous de montage.
Fixez les deux axes de chape en remplaçant les clips de pont.

Étape 3 : Retirez les supports d'expédition en carton autour du cylindre à ressort à gaz.
Les trous aux deux extrémités du ressort à gaz sont alignés avec les trous du siège
traverse de renommée et les trous dans le dossier rembourré.

Étape 4 : Alignez les trous du support de l'accoudoir avec les trous de montage du cadre du siège. Fixez.
vis avec écrou. Répétez l'opération pour l'autre côté.

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

Tables coulissantes

Pour placer l'une ou l'autre table en position surélevée :

Soulevez la table complètement et faites-la glisser jusqu'à ce que les languettes s'engagent dans les fentes du support de montage.

Appuyez légèrement sur la table pour vous assurer que les languettes de verrouillage sont engagées.

Pour remettre la table en position de rangement automatique :

Soulevez la table jusqu'à ce que les languettes se dégagent des fentes. Faites-la glisser et laissez la table s'abaisser. Voir Figure 4.

Appuie-tête articulé

L'appui-tête articulé peut être réglé dans une position confortable en tirant vers l'avant ou repousser.

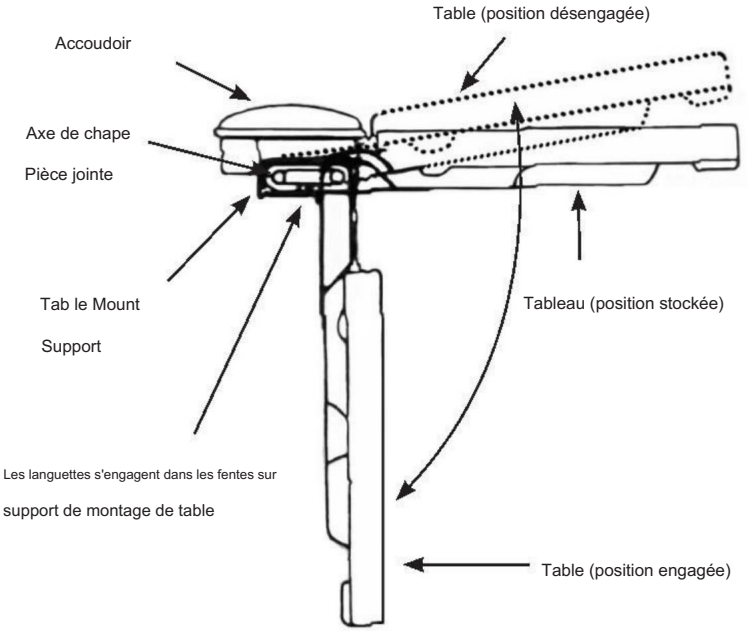


Figure 4

Machine Translated by Google

Positionnement du siège

Vertical : Position initiale. Quelle que soit la position, saisissez le levier d'actionnement du ressort à gaz, guidez lentement le dossier vers le haut et relâchez le levier. Remettez le patient dans la position souhaitée. position en poussant vers le haut sur la poignée de poussée rembourrée.

Inclinaison profonde : à partir de la position initiale, saisissez le levier d'actionnement du ressort à gaz avec une main, poussez vers l'arrière sur la poignée de poussée rembourrée.

Repose-jambes surélevé : à partir de la position initiale, ne saisissez pas le levier d'actionnement du ressort à gaz, poussez vers l'arrière sur la poignée de poussée rembourrée.

Position de Trendelenburg : Depuis n'importe quelle position, saisissez le levier d'actionnement du ressort à gaz d'une main tout en actionnant le levier de l'autre, guidez lentement le dossier vers le bas complètement et relâchez le levier.

Autre : L'appui-tête articulé peut être réglé à la position souhaitée en tirant vers l'avant ou repousser.

Machine Translated by Google



droit




inclinaison profonde



repose-jambes surélevé



position de Trendelenburg

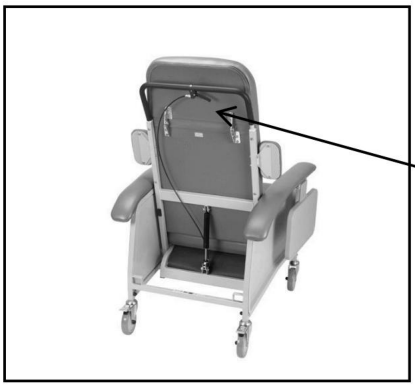

Debout (arrière)

Figure 5

Machine Translated by Google

FONCTIONNEMENT DE LA LANCE

Pour verrouiller les roulettes :

Pour empêcher les roulettes arrière de tourner, appuyez sur la pédale arrière de la roulette jusqu'à ce que la pédale s'enclenche. (L'avant de la pédale dépassera du couvre-roue).

Pour déverrouiller les roulettes :

Appuyez sur la partie avant saillante de la pédale pour déverrouiller le verrou.

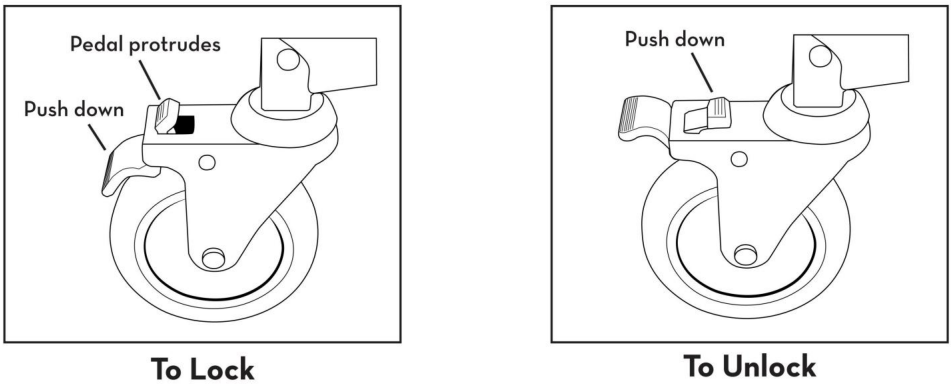


Figure 6

ATTENTION :

Ne pas utiliser le fauteuil inclinable en exerçant une force ou une pression sur le repose-jambes. Évitez de placer les mains ou les jambes dans les plis près du mécanisme du fauteuil.

Les roulettes doivent être verrouillées sauf pendant le transport.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

TOUS LES TROIS MOIS

Vérifier et nettoyer les roulettes/Serrer les écrous/Vérifier les freins des roulettes/Vérifier et nettoyer le mécanisme d'inclinaison de verrouillage

Pour l'entretien des tissus d'ameublement et l'élimination des taches, les conseils suivants vous seront utiles :

Saleté ordinaire : laver avec de l'eau tiède et un savon ou un détergent doux.

Machine Translated by Google

Saleté tenace : à l'aide d'une brosse à poils doux, suivez les instructions ci-dessus.

Saleté incrustée : frotter avec un nettoyant en poudre ou un détergent similaire.

Chewing-gum : grattez soigneusement.

Vernis à ongles et dissolvant : Tamponnez immédiatement pour éviter tout dommage.

Stylo à bille : Tamponnez immédiatement avec un chiffon blanc imbibé d'huile de montre ou de minéraux huile.

Cirage et finition : Améliore la résistance à l'usure. Utiliser une cire en pâte de qualité.

Une solution diluée à 10 % (ou moins) d'eau de Javel ou de Clorox peut être utilisée lors du nettoyage. cette chaise.

Fabricant : Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adresse : No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Liegesessel

MODELL: D577-J

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Liegesessel

MODELL: D577-J



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

MONTAGEANLEITUNG



Abbildung 1

HINWEIS: Zum Ändern der Sitzposition ist kein übermäßiger Kraftaufwand erforderlich. Bedienen Sie den Ruhesessel nicht durch Krafteinwirkung oder Druck auf die Beinstütze.


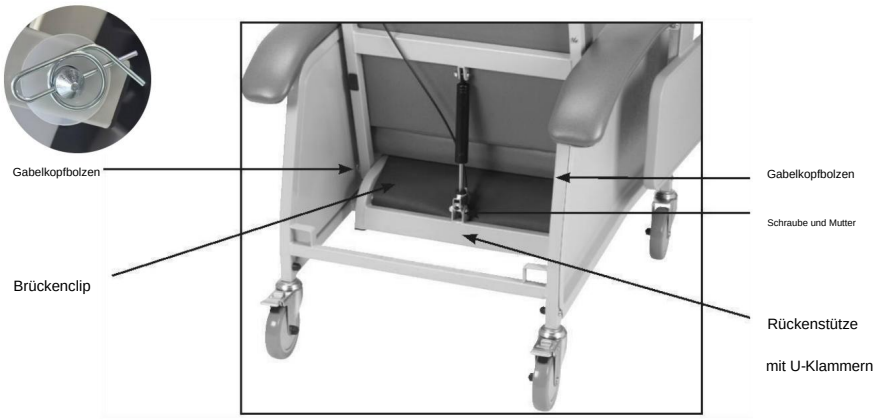


Abbildung 2

HINWEIS: Nachdem Sie alle Komponenten aus dem Karton genommen haben, aktivieren Sie die beiden Lenkradsperren, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Machine Translated by Google

Abbildung 2 zeigt die Position von zwei Gabelkopfbolzen, zwei Ringsplinten, einer Schraube und einer Mutter. Entfernen Sie alle oben genannten Teile von der hinteren Strebe.

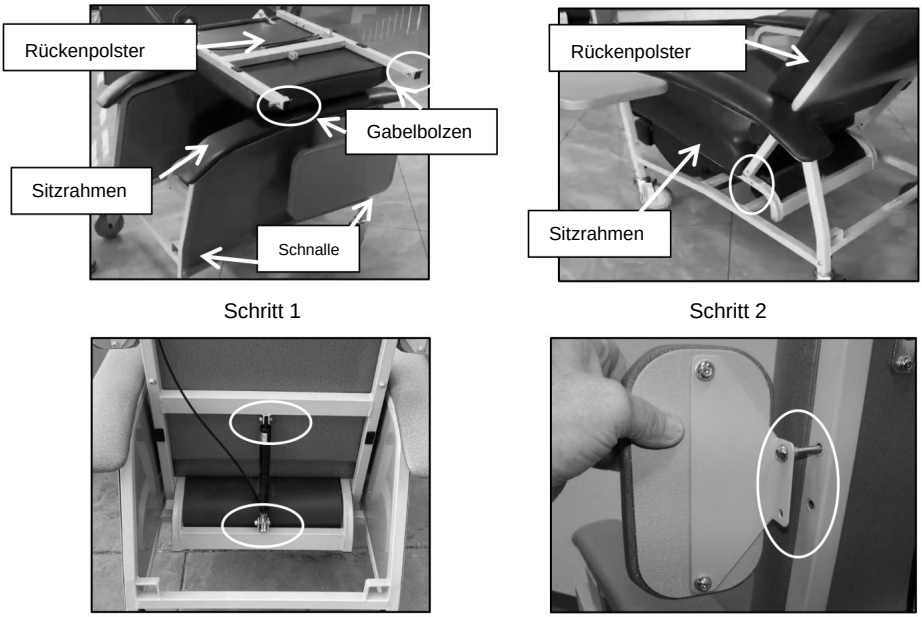

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3 Schritt 4

Abbildung 3

Schritt 1: Lösen Sie die Gabelbolzen auf der Polsterrückseite, auf beiden Seiten, so dass die Befestigungslöcher freigelegt. Drücken Sie die Schnallen, um die Seitenplatten (beide Seiten) zu entfernen.

Schritt 2: Richten Sie die Löcher an den aufrechten Rückenrohren der gepolsterten Rückenlehne mit den Löcher am Sitzrahmen. Setzen Sie die Gabelkopfbolzen wieder durch die Befestigungslöcher. Sichern Sie die beiden Gabelkopfbolzen durch Ersetzen der Brückenclips.

Schritt 3: Entfernen Sie die Versandhalterungen aus Karton vom Gasfederzylinder. Die Löcher an beiden Enden der Gasfeder sind mit den Löchern im Sitz ausgerichtet die Querstrebe des Rahmens und die Löcher in der Polsterung der Rückenlehne.

Schritt 4: Richten Sie die Löcher in der Armlehnenhalterung an den Befestigungslöchern im Sitzrahmen aus. Sichern Schraube mit Mutter. Für die andere Seite wiederholen.

Machine Translated by Google

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schiebetische

So bringen Sie einen der Tische in die angehobene Position:

Heben Sie den Tisch ganz nach oben und schieben Sie ihn hinein, bis die Laschen in die Schlitze in der Montagehalterung eingreifen. Drücken Sie leicht auf den Tisch, um sicherzustellen, dass die Verriegelungslaschen eingerastet sind.

So bringen Sie den Tisch zurück in die Selbstverstauposition:

Heben Sie den Tisch an, bis die Laschen aus den Schlitzen ausrasten. Schieben Sie ihn heraus und lassen Sie den Tisch absenken. Siehe Abbildung 4.

Gelenkige Kopfstütze

Die bewegliche Kopfstütze kann durch Ziehen nach vorne in eine bequeme Position gebracht werden oder zurückdrängen.

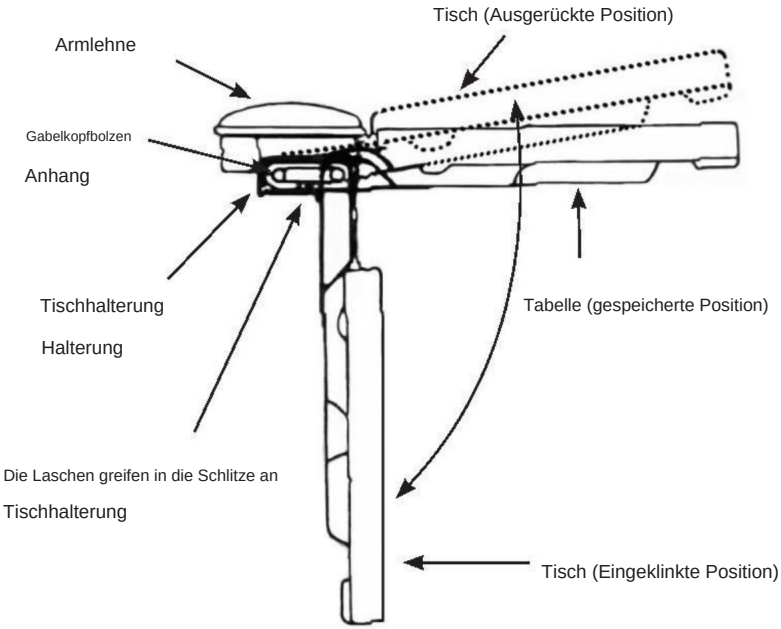


Abbildung 4

Machine Translated by Google

Sitzpositionierung

Aufrecht: Ausgangsposition. Greifen Sie aus jeder Position den Gasdruckfeder-Betätigungshebel, führen Sie die Rückenlehne langsam ganz nach oben und lassen Sie den Hebel los. Bringen Sie den Patienten in die gewünschte Position zurück. Position durch Hochdrücken des gepolsterten Schiebegriffs.

Tiefes Zurücklehnen: Aus der Ausgangsposition den Betätigungshebel der Gasfeder mit einem Hand, am gepolsterten Schiebegriff nach hinten drücken.

Erhöhte Beinstütze: Aus der Ausgangsposition den Betätigungshebel der Gasfeder nicht greifen, sondern am gepolsterten Schiebegriff nach hinten drücken.

Trendelenburg-Position: Greifen Sie aus jeder Position den Gasfeder-Betätigungshebel mit einer Hand, während Sie mit der anderen den Hebel betätigen, führen Sie den Rücken langsam nach unten vollständig und lassen Sie den Hebel los.

Sonstiges: Die bewegliche Kopfstütze kann durch Ziehen nach vorne in die gewünschte Position gebracht werden oder zurückdrängen.

Machine Translated by Google



aufrecht




tiefe Liegeposition



erhöhte Beinstütze



Trendelenburg-Position

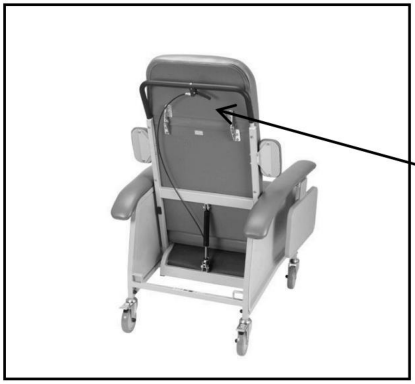

Aufrecht (zurück)

Abbildung 5

Machine Translated by Google

Rollenbetrieb

So arretieren Sie die Rollen:

Um zu verhindern, dass sich die hinteren Lenkrollen drehen, treten Sie auf das hintere Pedal der Lenkrolle, bis das Pedal einrastet. (Die Vorderseite des Pedals ragt aus der Radabdeckung heraus.)

So entsperren Sie Rollen:

Um die Sperre zu lösen und zu entriegeln, treten Sie auf den hervorstehenden vorderen Teil des Pedals.

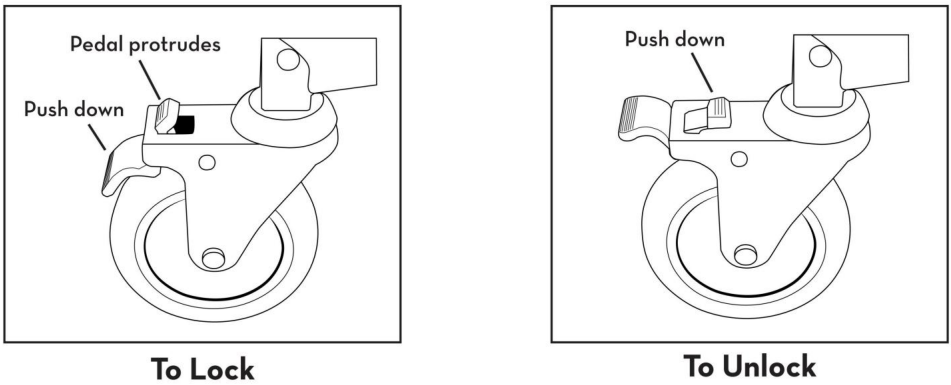


Abbildung 6

VORSICHT:

Bedienen Sie den Ruhesessel nicht durch Krafteinwirkung oder Druck auf die Beinstütze. Vermeiden Sie es, Hände oder Beine in die Nähe des Ruhesesselmechanismus zu bringen.

Außer während des Transports müssen die Rollen festgestellt werden.

WARTUNG & REINIGUNG

ALLE DREI MONATE

Rollen prüfen und reinigen/Muttern festziehen/Bremsen an den Rollen prüfen/Verriegelungsmechanismus für die Neigung prüfen und reinigen

Zur Polsterpflege und Fleckenentfernung sind folgende Hinweise hilfreich:

Normaler Schmutz: Mit warmem Wasser und einer milden Seife oder einem milden Reinigungsmittel waschen.

Machine Translated by Google

Hartnäckiger Schmutz: Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten und befolgen Sie die obigen Anweisungen.

Festsitzender Schmutz: Mit Pulverreiniger oder einem ähnlichen Reinigungsmittel schrubben.

Kaugummi: Vorsichtig abkratzen.

Nagellack und Nagellackentferner: Sofort abtupfen, um Schäden zu vermeiden.

Kugelschreiber: Sofort mit einem in Uhren- oder Mineralwasser getränkten weißen Tuch abtupfen
Öl.

Wachsen und Nachbearbeiten: Verbessert die Tragbarkeit. Verwenden Sie ein hochwertiges Pastenwachs.

Eine verdünnte Lösung von 10 % (oder weniger) Bleichmittel oder Clorox kann zum Reinigen verwendet werden
dieser Stuhl.

Hersteller: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd.

Adresse: Nr. 589 Hualu Road, Stadt Jiangyin, Stadt Wuxi, Jiangsu
Provinz, 214400, China

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLTRONA RECLINABILE

MODELLO: D577-J

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELLO: D577-J



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Figura 1

NOTA: non è mai necessario esercitare una forza o uno sforzo eccessivi per cambiare la posizione di seduta della sedia. Non azionare la poltrona reclinabile applicando forza o pressione al poggiagambe.

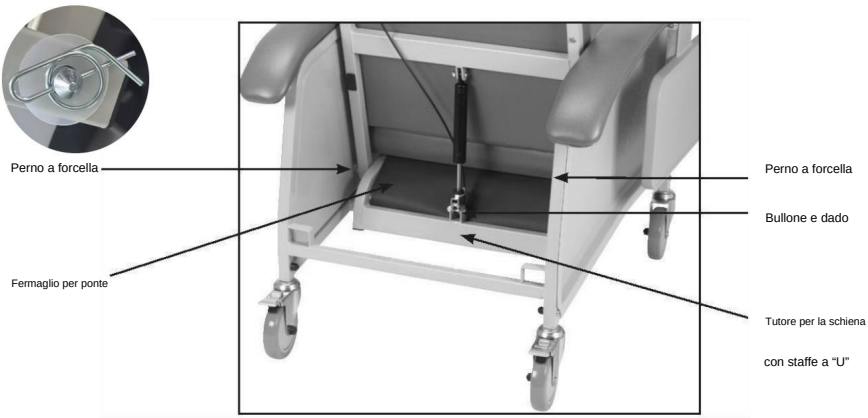


Figura 2

NOTA: dopo aver rimosso tutti i componenti dalla scatola, inserire i due bloccaggi prima di iniziare il montaggio.

Machine Translated by Google

La figura 2 mostra la posizione di due perni a forcella, due clip a coppiglia ad anello, un bullone e un dado. Rimuovere tutta la ferramenta di cui sopra dal rinforzo posteriore.

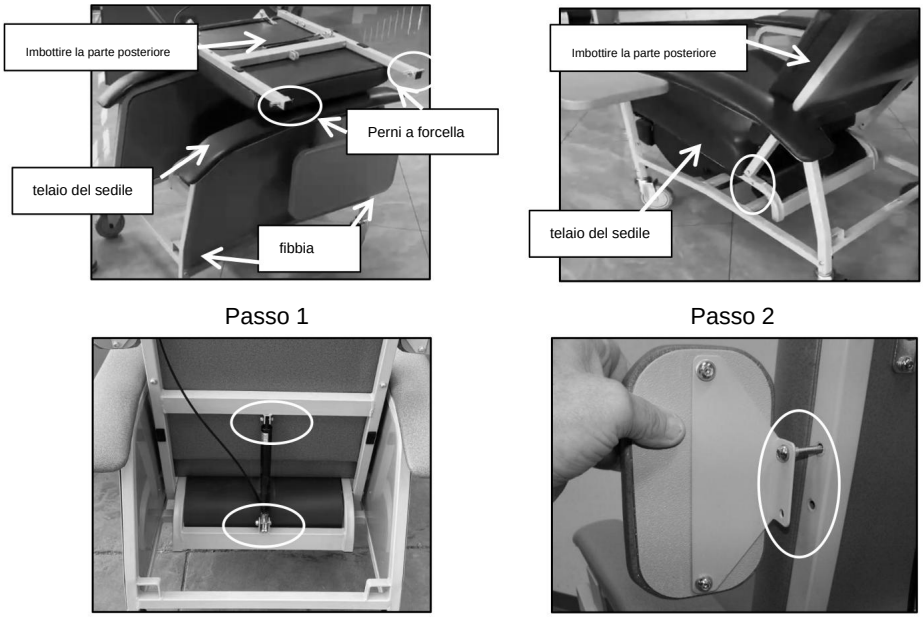


Figura 3

Fase 1: Svitare i perni a forcella sullo schienale imbottito, su entrambi i lati, in modo che i fori di montaggio siano esposti. Premere le fibbie per rimuovere le piastre laterali (entrambi i lati).

Fase 2: Allineare i fori sui tubi posteriori verticali dello schienale imbottito con i fori sul telaio del sedile. Riposizionare i perni a forcella attraverso i fori di montaggio. Fissare i due perni a forcella sostituendo le clip del ponte.

Fase 3: rimuovere i fermi di spedizione in cartone attorno al cilindro della molla a gas. I fori su entrambe le estremità della molla a gas sono allineati con i fori nel sedile rinforzo trasversale e i fori nello schienale imbottito.

Fase 4: Allineare i fori nel supporto del bracciolo ai fori di montaggio nel telaio del sedile. Fissare avvitare con il dado. Ripetere per l'altro lato.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'USO

Tabelle di scorrimento

Per posizionare uno dei tavoli in posizione sollevata:

Sollevare completamente il tavolo e farlo scorrere finché le linguette non si innestano nelle fessure della staffa di montaggio.

Premere leggermente sul tavolo per assicurarsi che le linguette di bloccaggio siano inserite.

Per riportare il tavolo in posizione di auto-archiviazione:

Sollevare il tavolo fino a quando le linguette non si disinnestano dalle fessure. Far scorrere fuori e lasciare che il tavolo si abbassi. Vedere Figura 4.

Poggiatesta articolato

Il poggiatesta articolato può essere regolato in una posizione comoda tirandolo in avanti o respingendo.

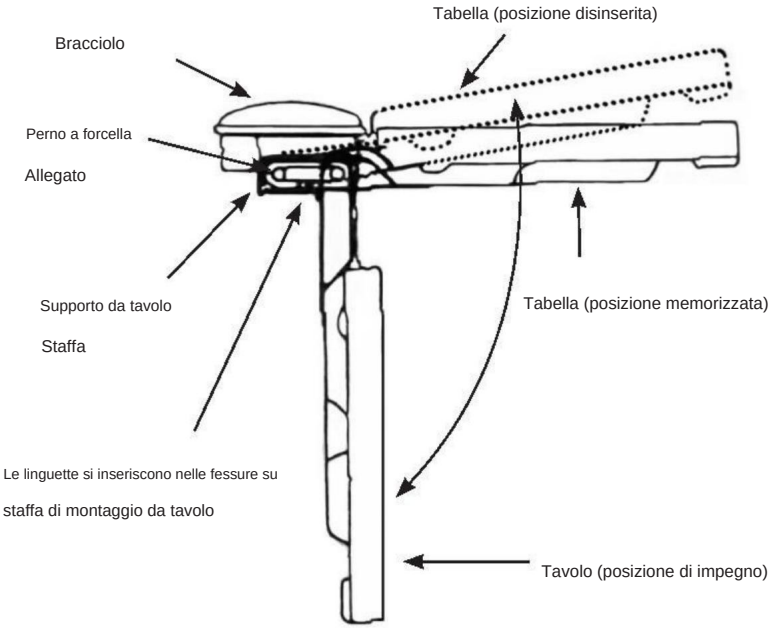


Figura 4

Machine Translated by Google

Posizionamento del sedile

Verticale: posizione iniziale. Da qualsiasi posizione, afferrare la leva di azionamento della molla a gas, guidare lentamente lo schienale completamente verso l'alto e rilasciare la leva. Riportare il paziente nella posizione desiderata. posizione spingendo verso l'alto la maniglia di spinta imbottita.

Reclinazione profonda: dalla posizione iniziale, afferrare la leva di azionamento della molla a gas con una mano, spingere indietro sulla maniglia di spinta imbottita.

Poggiagambe elevato: dalla posizione iniziale, non afferrare la leva di azionamento della molla a gas, ma spingere indietro la maniglia di spinta imbottita.

Posizione Ttrendelenburg: da qualsiasi posizione, afferrare la leva di azionamento della molla a gas con una mano azionando la leva con l'altra, guidare lentamente la schiena verso il basso completamente e rilasciare la leva.

Altro: il poggiatesta articolato può essere regolato nella posizione desiderata tirandolo in avanti o respingendo.

Machine Translated by Google



verticale




reclinazione profonda



poggiagambe elevato



posizione di trendelenburg

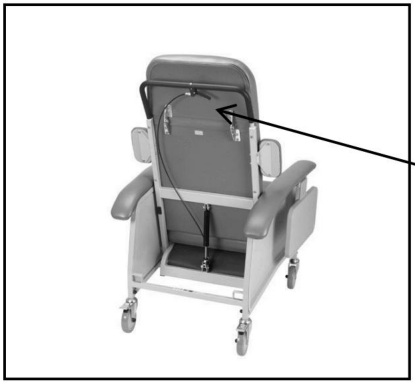

Verticale (posteriore)

Figura 5

Machine Translated by Google

FUNZIONAMENTO DEL CASTER

Per bloccare le rotelle:

Per evitare che le rotelle posteriori girino, premere il pedale posteriore della rotella finché il pedale non si innesta. (La parte anteriore del pedale sporgerà dal copriruota).

Per sbloccare le rotelle:

Premere sulla parte anteriore sporgente del pedale per sbloccare il bloccaggio.

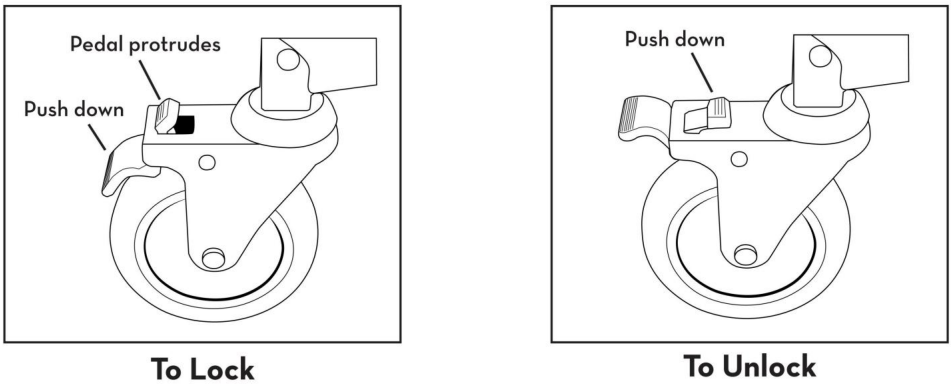


Figura 6

ATTENZIONE:

non azionare la poltrona reclinabile applicando forza o pressione al poggiagambe. Evitare di mettere mani o gambe nelle pieghe vicino al meccanismo della poltrona reclinabile.
Le rotelle devono essere bloccate, tranne durante il trasporto.

MANUTENZIONE E PULIZIA

OGNI TRE MESI

Controllare e pulire le rotelle/Serrare i dadi/Controllare i freni sulle rotelle/Controllare e pulire il meccanismo di bloccaggio dell'inclinazione

Per la manutenzione dei rivestimenti e la rimozione delle macchie, i seguenti suggerimenti saranno utili:

Sporco ordinario: lavare con acqua tiepida e un sapone o un detergente delicato.

Machine Translated by Google

Sporco ostinato: utilizzando una spazzola a setole morbide, seguire le istruzioni riportate sopra.

Sporcizia incrostata: strofinare con detergente in polvere o un detergente simile.

Gomma da masticare: raschiare con cura.

Smalto e solvente per unghie: tamponare immediatamente per evitare danni.

Penna a sfera: Tamponare immediatamente con un panno bianco inumidito con acqua per orologi o minerali olio.

Ceratura e rifinitura: Miglioramento della vestibilità. Utilizzare qualsiasi cera in pasta di qualità.

Per la pulizia è possibile utilizzare una soluzione diluita al 10% (o meno) di candeggina o clorox questa sedia.

Produttore: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Indirizzo: n. 589 Hualu Road, città di Jiangyin, città di Wuxi, Jiangsu Provincia,214400,Cina

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINABLE

MODELO: D577-J

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RECLINABLE

MODELO: D577-J



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Figura 1

NOTA: Nunca es necesario aplicar fuerza ni esfuerzo excesivo para cambiar la posición del asiento. No utilice el sillón reclinable aplicando fuerza o presión sobre el reposapiernas.

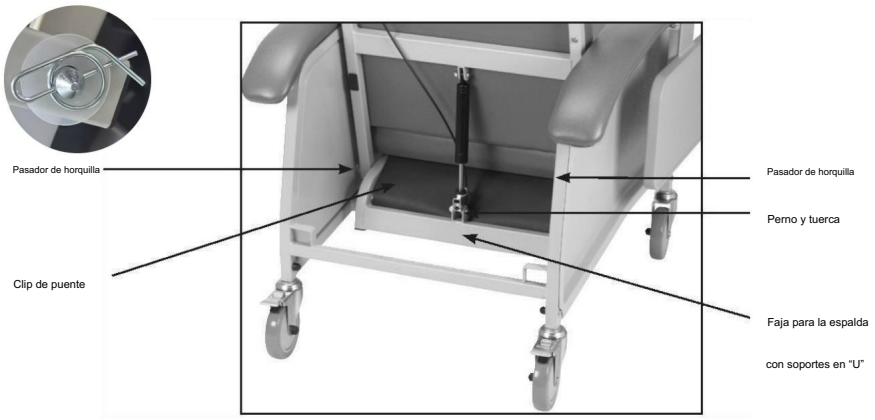


Figura 2

NOTA: Después de retirar todos los componentes de la caja, active los dos seguros de las ruedas antes de comenzar el montaje.

Machine Translated by Google

La Figura 2 muestra la ubicación de dos pasadores de horquilla, dos pasadores de chaveta, un perno y una tuerca. Retire todos los herrajes mencionados del soporte trasero.

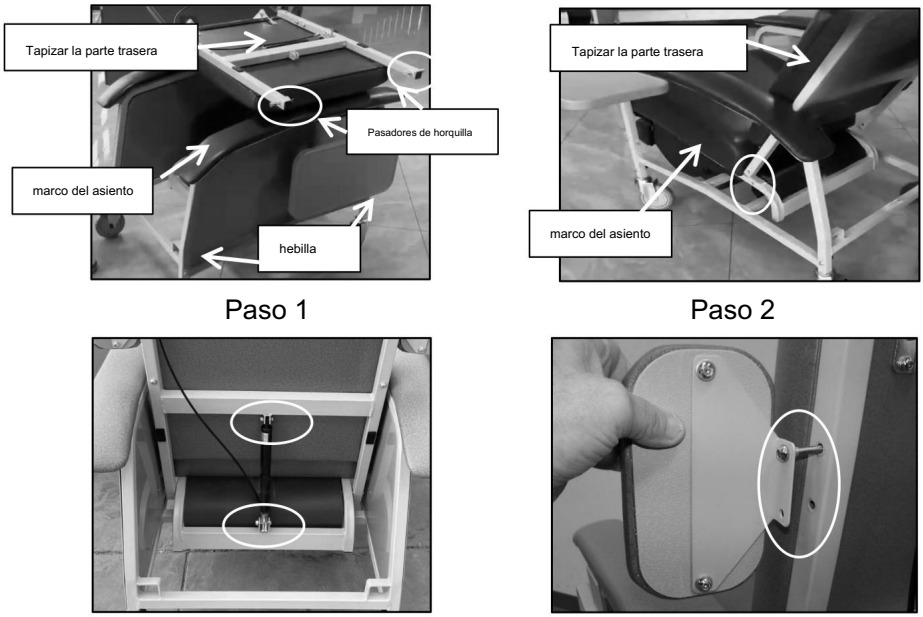


Figura 3

Paso 1: Afloje los pasadores de horquilla en la parte posterior del tapizado, en ambos lados, de modo que los orificios de montaje queden bien fijados.

Expuesto. Presione las hebillas para quitar las placas laterales (ambos lados).

Paso 2: Alinee los orificios de los tubos verticales del respaldo tapizado con los

Agujeros en el marco del asiento. Vuelva a colocar los pasadores de horquilla a través de los agujeros de montaje.

Asegure los dos pasadores de horquilla reemplazando los clips del puente.

Paso 3: Retire los retenedores de envío de cartón de alrededor del cilindro del resorte de gas.

Los orificios en ambos extremos del resorte de gas están alineados con los orificios del asiento.

la famosa cruceta y los agujeros en el tapizado de la parte posterior.

Paso 4: Alinee los orificios del soporte del brazo con los orificios de montaje del marco del asiento. Asegure.

Atornillar con tuerca. Repetir para el otro lado.

Machine Translated by Google

Tablas deslizantes

Para colocar cualquiera de las mesas en posición elevada:

Levante la mesa completamente y deslícela hasta que las pestañas enganchen en las ranuras del soporte de montaje.

Presione ligeramente la mesa para asegurarse de que las pestañas de bloqueo estén enganchadas.

Para devolver la mesa a la posición de almacenamiento automático:

Levante la mesa hasta que las pestañas se desenganchen de las ranuras. Deslícela hacia afuera y deje que la mesa baje. Ver Figura 4.

Reposacabezas articulado

El reposacabezas articulado se puede ajustar a una posición cómoda tirando hacia adelante.

o empujando hacia atrás.

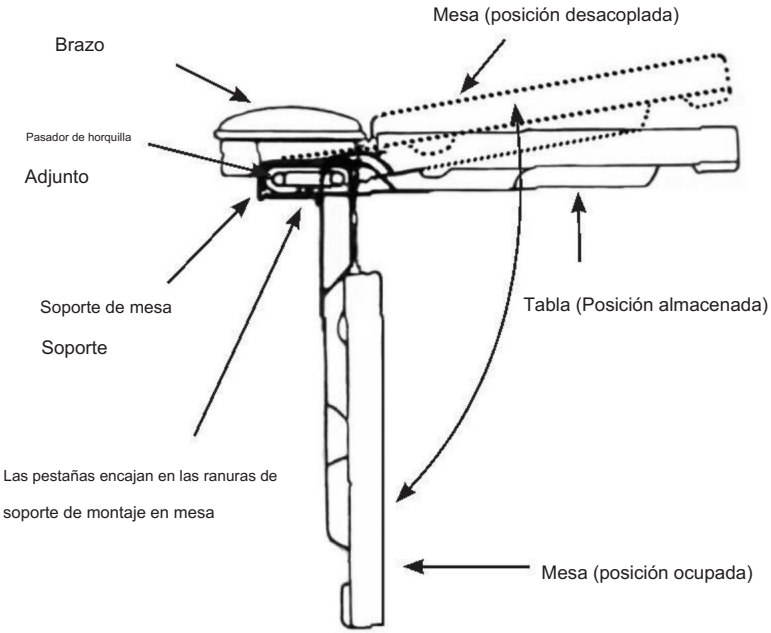


Figura 4

Machine Translated by Google

Posicionamiento del asiento

Vertical: Posición inicial. Desde cualquier posición, sujete la palanca de accionamiento del resorte de gas, levante lentamente el respaldo por completo y suelte la palanca. Regrese al paciente a la posición deseada. posición empujando hacia arriba el mango de empuje acolchado.

Reclinación profunda: desde la posición inicial, sujete la palanca de accionamiento del resorte de gas con una Con la mano, empuje hacia atrás el mango de empuje acolchado.

Reposapiernas elevado: desde la posición inicial, no agarre la palanca de accionamiento del resorte de gas, empuje hacia atrás el mango de empuje acolchado.

Posición de Ttrendelenburg: Desde cualquier posición, sujete la palanca de accionamiento del resorte de gas. Con una mano mientras acciona la palanca con la otra, guíe lentamente la espalda hacia abajo. completamente y suelte la palanca.

Otro: El reposacabezas articulado se puede ajustar a la posición deseada tirando hacia adelante. o empujando hacia atrás.

Machine Translated by Google



vertical




reclinación profunda



reposapiernas elevado



posición de trendelenburg

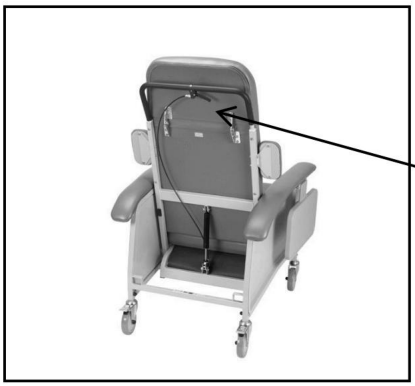

Vertical (espalda)

Figura 5

Machine Translated by Google

FUNCIONAMIENTO DE LA RUEDA

Para bloquear las ruedas:

Para evitar que las ruedas traseras giren, pise el pedal trasero de la rueda hasta que se enganche. (La parte delantera del pedal sobresaldrá de la cubierta de la rueda).

Para desbloquear las ruedas:

Pise la parte delantera que sobresale del pedal para desenganchar el bloqueo y desbloquearlo.

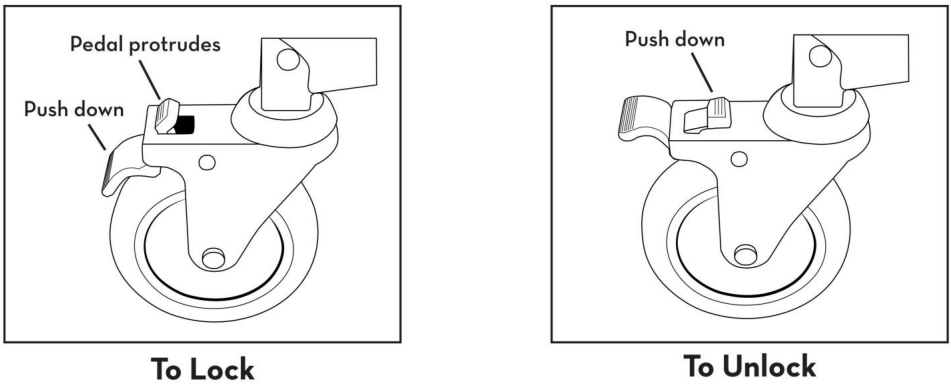


Figura 6

PRECAUCIÓN:

No presione el reposapiernas al operar el sillón reclinable. Evite colocar las manos o las piernas en los pliegues cerca del mecanismo.

Las ruedas deben bloquearse excepto durante el transporte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CADA TRES MESES

Revise y limpie las ruedas/Apriete las tuercas/Revise los frenos de las ruedas/Revise y limpie el mecanismo de reclinación con bloqueo

Para el mantenimiento de la tapicería y la eliminación de manchas, los siguientes consejos serán útiles:

Suciedad común: Lavar con agua tibia y un jabón o detergente suave.

Machine Translated by Google

Suciedad difícil de eliminar: utilice un cepillo de cerdas suaves y siga las instrucciones anteriores.

Suciedad incrustada: frote con un limpiador en polvo o un detergente similar.

Chicle: Raspar con cuidado.

Esmalte y quitaesmalte: Seque inmediatamente para evitar daños.

Bolígrafo: Seque inmediatamente con un paño blanco humedecido en solución para relojes o minerales.
aceite.

Encerado y reacabado: Mejora la durabilidad. Use cera en pasta de cualquier calidad.

Se puede utilizar una solución diluida de 10% (o menos) de blanqueador o clorox para limpiar
Esta silla.

Fabricante: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd.
Dirección: No. 589 Hualu Road, ciudad de Jiangyin, ciudad de Wuxi, Jiangsu
Provincia,214400,China
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122
Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL REGULOWANY

MODEL: D577-J

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL REGULOWANY

MODEL: D577-J



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU



Rysunek 1

UWAGA: Nadmierna siła lub wysiłek nigdy nie są konieczne do zmiany pozycji siedzącej krzesła. Nie należy obsługiwać fotela odchylanego, stosując siłę lub nacisk na podnóżek.

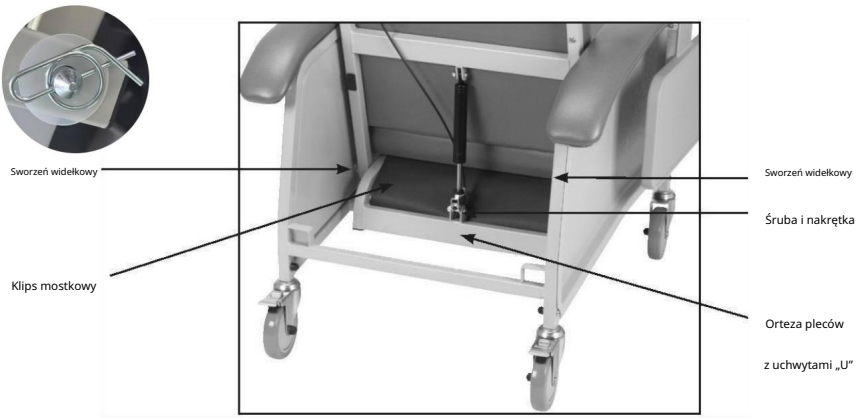


Rysunek 2


UWAGA: Po wyjęciu wszystkich elementów z kartonu, przed rozpoczęciem montażu należy zablokować dwie blokady kółek.

Machine Translated by Google


Rysunek 2 przedstawia lokalizację dwóch sworzni widełkowych, dwóch pierścieniowych zacisków zawleczek, jednej śruby i jednej nakrętki. Zdejmij wszystkie powyższe elementy z tylnego wspornika.

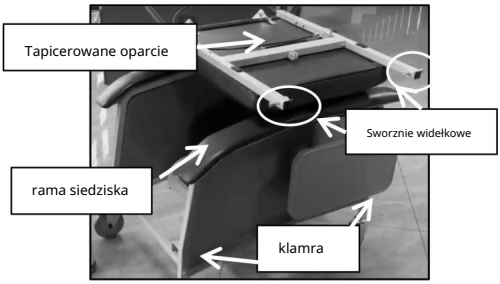

Krok 1

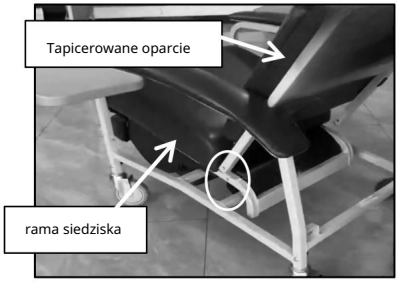

Krok 2

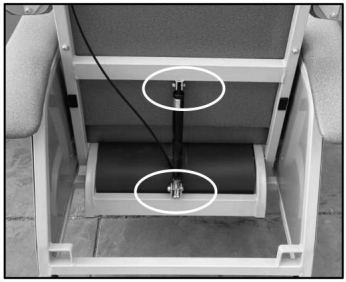

Krok 3



Krok 4

Rysunek 3

Krok 1: Odkręć kołki rozporowe na tylnej stronie tapicerki, po obu stronach, tak aby otwory montażowe były odsłonięte. Naciśnij klamry, aby usunąć płyty boczne (obie strony).

Krok 2: Wyrównaj otwory na pionowych rurach oparcia tapicerowanego z otwory w ramie siedziska. Wymień sworznie widełkowe przez otwory montażowe. Zabezpiecz dwa sworznie widełkowe, wymieniając zaciski mostka.

Krok 3: Usuń tekturowe zabezpieczenia transportowe wokół cylindra sprężyny gazowej. Otwory na obu końcach sprężyny gazowej są wyrównane z otworami w siedzisku sławna poprzeczka i otwory w tapicerce z tyłu.

Krok 4: Dopasuj otwory w uchwycie podłokietnika do otworów montażowych w ramie siedziska. Zabezpiecz Przykręć nakrętkę. Powtórz czynność po drugiej stronie.

Machine Translated by Google

Tabele ślizgowe

Aby umieścić dowolny ze stołów w pozycji podwyższonej:

Podnieś stół do góry i wsuń, aż zaczepy zablokują się w szczelinach uchwytu montażowego.


Naciśnij lekko stół, aby sprawdzić, czy zatrzaski blokujące są zatrzaśnięte.

Aby przywrócić tabelę do pozycji samozachowawczej:

Podnieś stół, aż wypustki rozłączą się z gniazdami. Wysuń i pozwól, aby stół się opuścił. Zobacz Rysunek 4.

Zagłówek przegubowy

Przegubowy zagłówek można ustawić w wygodnej pozycji poprzez pociągnięcie do przodu lub odpychanie.

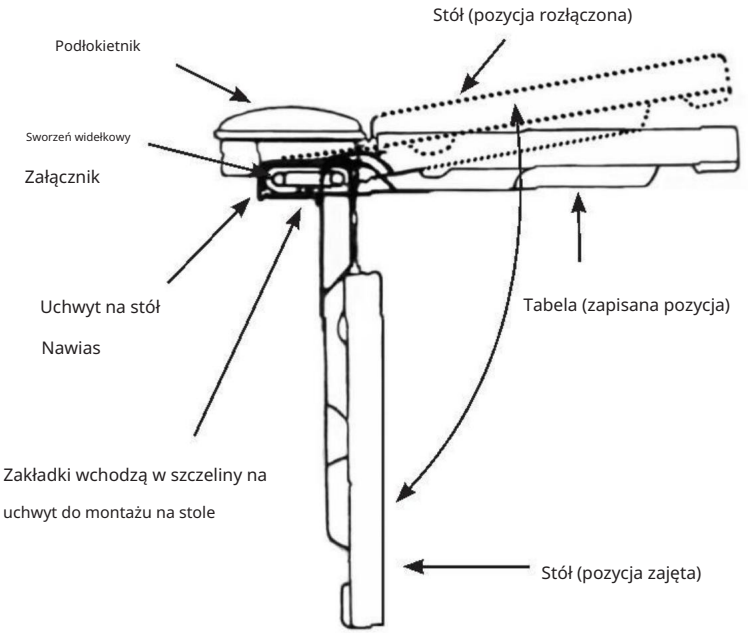

Rysunek 4

Machine Translated by Google

Pozycjonowanie siedzeń

Pionowo: Pozycja początkowa. Z dowolnej pozycji chwyć dźwignię uruchamiającą sprężynę gazową, powoli unieś oparcie do góry i zwolnij dźwignię. Przywróć pacjentowi pożądaną pozycję. pozycję poprzez popchnięcie w górę wyścielanego uchwytu do pchania.

Głębokie odchylenie: Z pozycji początkowej chwyć dźwignię uruchamiającą sprężynę gazową jedną ręką. dłoń, pchnij do tyłu wyścielany uchwyt do pchania.

Podniesiony podnóżek: Z pozycji początkowej nie chwytaj dźwigni uruchamiającej sprężynę gazową, odepchnij wyścielany uchwyt do pchania.

Pozycja Trendelenburga: Z dowolnej pozycji chwyć dźwignię uruchamiającą sprężynę gazową jedną ręką, a drugą naciskając dźwignię, powoli kieruj oparcie w dół całkowicie i zwolnij dźwignię.

Inne: Przegubowy zagłówek można ustawić w żądanej pozycji poprzez pociągnięcie do przodu lub odpychanie.

Machine Translated by Google



pionowo




głębokie odchylenie



podniesiony podnóżek



pozycja Trendelenburga

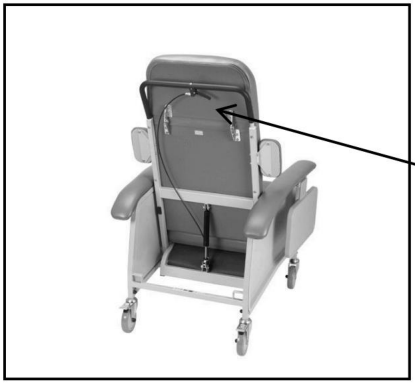

Pionowo (z tyłu)

Rysunek 5

Machine Translated by Google


OPERACJA KÓŁKA

Aby zablokować kółka:

Aby zapobiec obracaniu się tylnych kółek, naciśnij tylny pedał kółka, aż pedał się zablokuje. (Przód pedału będzie wystawał poza osłonę koła).

Aby odblokować kółka:

Naciśnij wystającą przednią część pedału, aby zwolnić blokadę i odblokować.

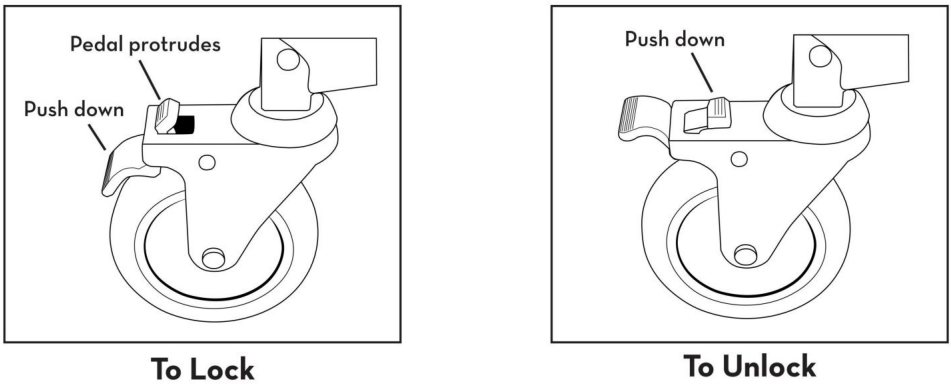

Rysunek 6

UWAGA: Nie

należy obsługiwać fotela, stosując siłę lub nacisk na podnóżek. Unikać umieszczania rąk lub nóg w zagłębieniach w pobliżu mechanizmu fotela.

Kółka muszą być zablokowane, z wyjątkiem czasu transportu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CO TRZY MIESIĄCE

Sprawdź i wyczyść kółka/Dokręć nakrętki/Sprawdź hamulce kółek/Sprawdź i wyczyść mechanizm blokady odchylania

Przy konserwacji tapicerki i usuwaniu plam pomocne będą poniższe wskazówki:

Zwykłe zabrudzenia: Myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego mydła lub detergentu.

Machine Translated by Google

Trudne zabrudzenia: Używając miękkiej szczotki, postępuj zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Wnikliwy brud: Szorować proszkiem czyszczącym lub podobnym detergentem.

Guma do żucia: ostrożnie zeskrobuj.

Lakier do paznokci i zmywacz: Natychmiast osusz, aby zapobiec uszkodzeniom.

Długopis: Natychmiast osusz białą szmatką zwilżoną płynem do zegarków lub minerałów.
olej.

Woskowanie i odnawianie: Poprawa noszenia. Użyj dowolnego wosku w paście.

Do czyszczenia można stosować rozcieńczony roztwór wybielacza lub chlorku sodu w stężeniu 10% (lub niższym)
to krzesło.

Producent: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd
Adres: nr 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu
Prowincja,214400,Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VILSTOL

MODELL: D577-J

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

VILSTOL


MODELL: D577-J



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


Machine Translated by Google

MONTERINGSINSTRUKTIONER

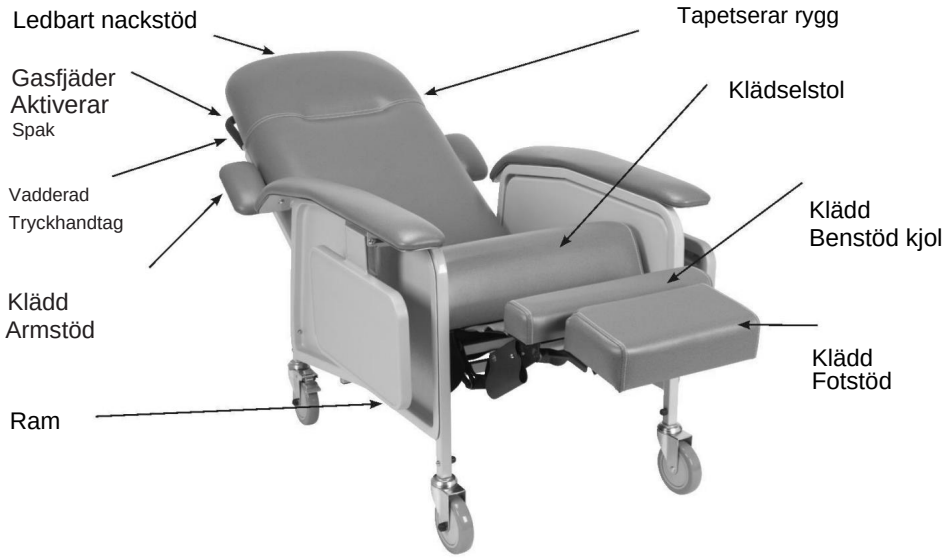

Figur 1

OBS: Överdriven kraft eller ansträngning är aldrig nödvändig för att ändra stolens sittposition. Använd inte vilstolen genom att utöva kraft eller tryck på benstödet.

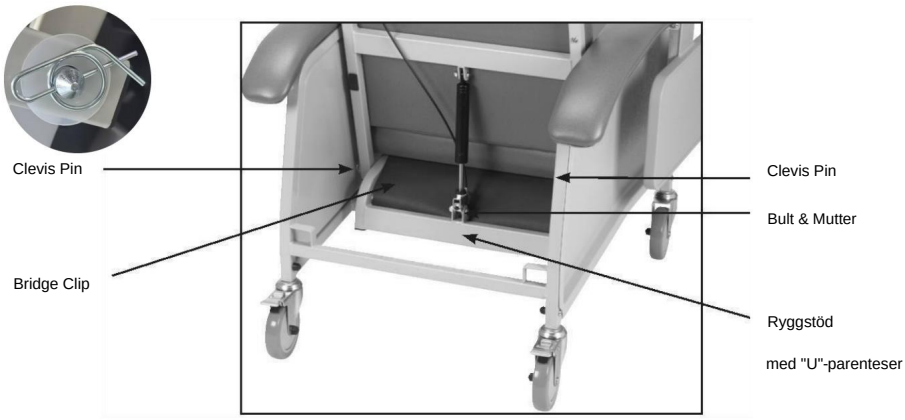


Figur 2

OBS: När du har tagit bort alla komponenter från kartongen, koppla in de två hjullåsen innan du påbörjar monteringen.

Machine Translated by Google

Figur 2 visar placeringen av två gaffelsprintar, två ringsprintar, en bult och en mutter. Ta bort all ovanstående hårdvara från det bakre stödet.

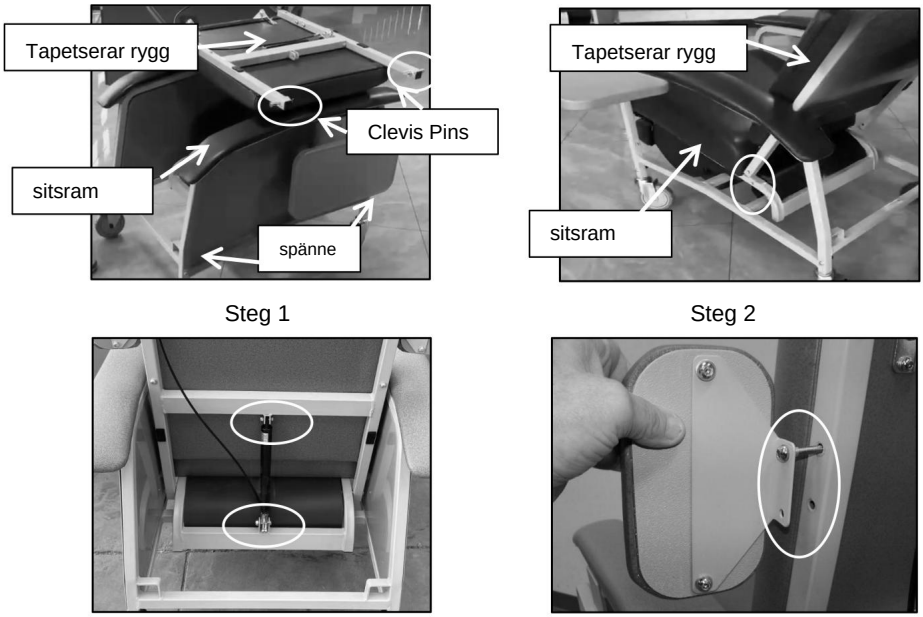

Figur 3

Steg 1: Lossa sprintstiften på tapetserarryggen, båda sidorna så att monteringshålen är utsatt. Tryck på spännena för att ta bort sidoplåtarna (båda sidorna).

Steg 2: Rikta in hålen på de upprättstående ryggrören på den stoppade ryggen med hål på sitsramen. Sätt tillbaka gaffelstiften genom monteringshålen.
Säkra de två gaffelstiften genom att byta ut broklämmorna.

Steg 3: Ta bort frakthållare av kartong runt gasfjädercylindern.
Hålen i båda ändarna av gasfjädern är i linje med hålen i sätet
fame korsstag och hålen i klädselns baksida.

Steg 4: Rikta in hålen i armstödsfästet mot monteringshålen i sitsramen. Säkra skruva med mutter. Upprepa för andra sidan.

Machine Translated by Google

Glidbord

För att placera ettdera bordet i upphöjd position:


Lyft bordet hela vägen upp och skjut in tills flikarna griper in i spåren i monteringsfästet. Tryck ner lätt på bordet för att säkerställa att låsflikarna är i ingrepp.

För att återställa bordet till självlagringsläge:

Lyft upp bordet tills flikarna lossar spåren. Skjut ut och låt bordet sänkas. Se Figur 4.

Ledbart nackstöd

Det ledade nackstödet kan justeras till en bekväm position genom att dra framåt eller trycka tillbaka.

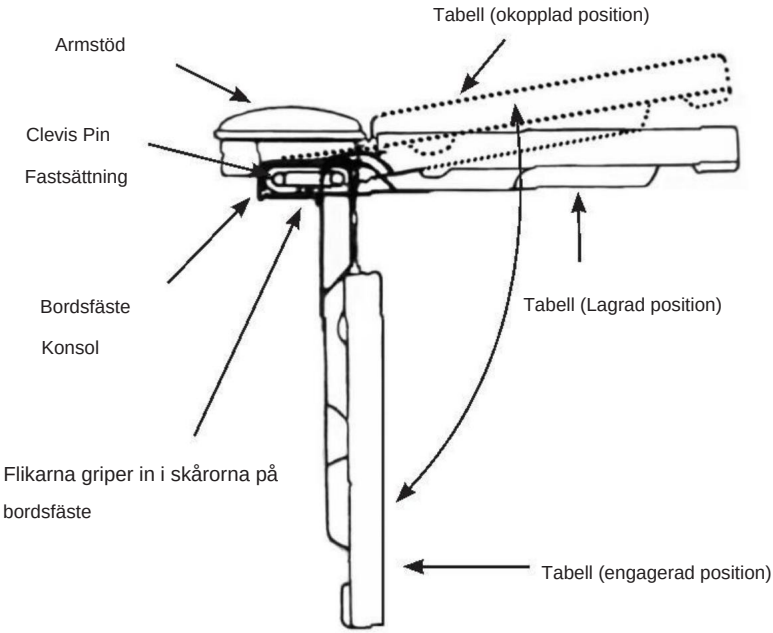

Figur 4

Machine Translated by Google

Sätesplacering

Upprätt: Ursprungligt läge. Ta tag i gasfjäderns manöverspak från vilken position som helst, för långsamt ryggen uppåt helt och släpp spaken. Återför patienten till önskat läge placera genom att trycka uppåt på vadderade körhandtag.

Djup lutning: Ta tag i gasfjäderns manöverspak från utgångsläget hand, tryck tillbaka på vadderat körhandtag.

Förhöjt benstöd: Ta inte tag i gasfjäderns manöverspak från utgångsläget, tryck tillbaka det vadderade körhandtaget.

Ttrendelenburg-läge: Ta tag i gasfjäderns manöverspak från vilken position som helst med ena handen medan du aktiverar spaken med den andra, för långsamt baksidan nedåt helt och släpp spaken.

Övrigt: Det ledade nackstödet kan justeras till önskat läge genom att dra framåt eller trycka tillbaka.

Machine Translated by Google



upprätt




djup lutning



förhöjt benstöd



trendelenburg position

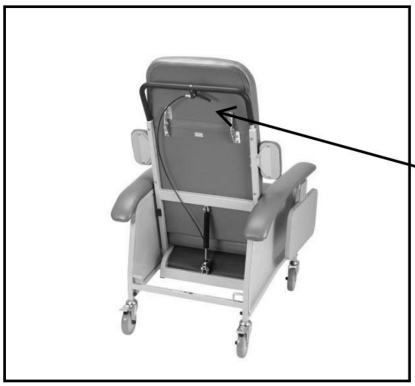

Upprätt (bakåt)

Figur 5

Machine Translated by Google

HJÄLPFUNKTION

Så här låser du hjul:

För att förhindra att de bakre hjulen svänger, trampa på den bakre pedalen på hjulet tills pedalen låser sig.

(Framsidan av pedalen kommer att sticka ut från hjulkåpan).

Så här låser du upp hjul:

Trampa på den utskjutande främre delen av pedalen för att frigöra låset för att låsa upp.

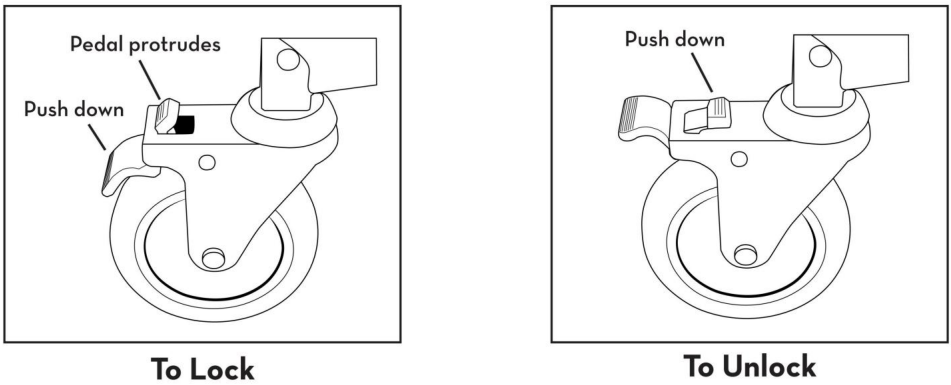


Bild 6

VARNING:

Använd inte vilstolen genom att utöva kraft eller tryck på benstödet. Undvik att placera händer eller ben i veck nära vilstolsmekanismen.

Hjulen måste vara låsta förutom under transport.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

VAR TREDJE MÅNAD

Kontrollera och rengör hjul/Dra åt muttrar/Kontrollera bromsar på hjul/Kontrollera och rengör låsmekanismen

För underhåll av klädsel och fläckborttagning kommer följande tips att vara till hjälp:

Vanlig smuts: Tvätta med varmt vatten och en mild tvål eller rengöringsmedel.

Machine Translated by Google

Envis smuts: Använd en mjuk borste och följ anvisningarna ovan.

Nedslipad smuts: Skrubba med pulveriserat rengöringsmedel eller liknande rengöringsmedel.

Tuggummi: Skrapa försiktigt.

Nagellack och remover: Blotta omedelbart för att förhindra skador.

Kulspetspenna: Blotta omedelbart med en vit trasa fuktad i klocka eller mineral olja.

Vaxning och refnishing: Förbättra bärbarheten. Använd valfritt kvalitetspastavax.

En utspädd lösning med 10 % (eller mindre) blekmedel eller clorox kan användas vid rengöring denna stol.

Tillverkare: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adress: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Provins, 214400, Kina

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIGSTOEL

MODEL: D577-J

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIGSTOEL


MODEL: D577-J



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


Machine Translated by Google

MONTAGE-INSTRUCTIES

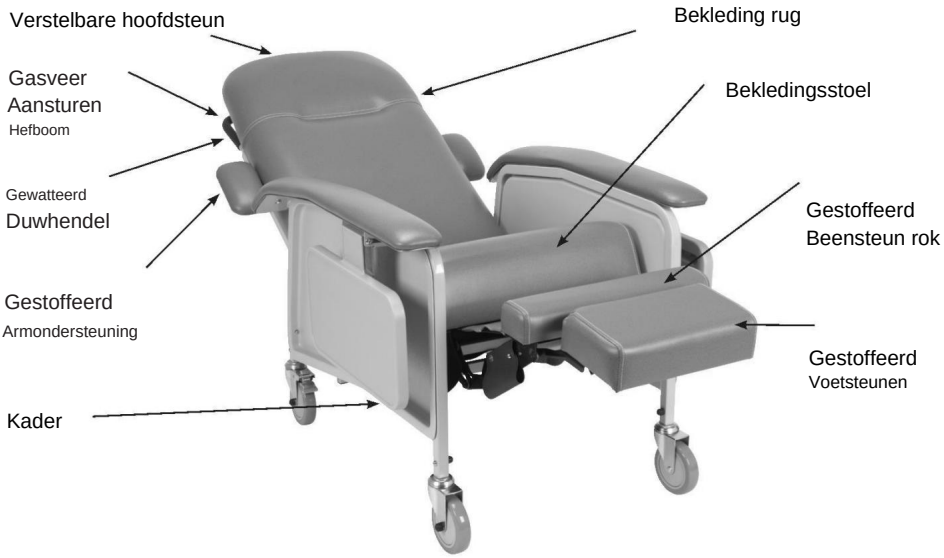

Figuur 1

OPMERKING: Overmatige kracht of inspanning is nooit nodig om de zitpositie van de stoel te veranderen. Bedien de relaxfauteuil niet door kracht of druk uit te oefenen op de beensteun.

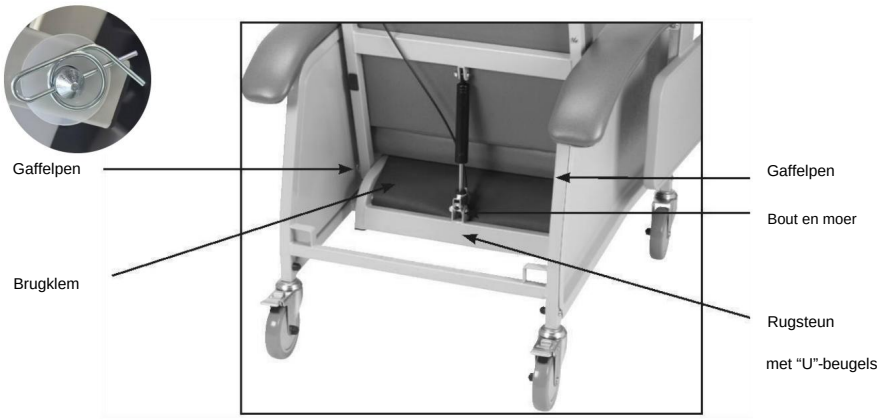


Figuur 2

OPMERKING: Nadat u alle onderdelen uit de doos hebt gehaald, moet u de twee wielvergrendelingen vastzetten voordat u met de montage begint.

Machine Translated by Google

Figuur 2 toont de locatie van twee clevis-pennen, twee ringcotterclips, één bout en één moer. Verwijder alle bovenstaande hardware van de achterbeugel.

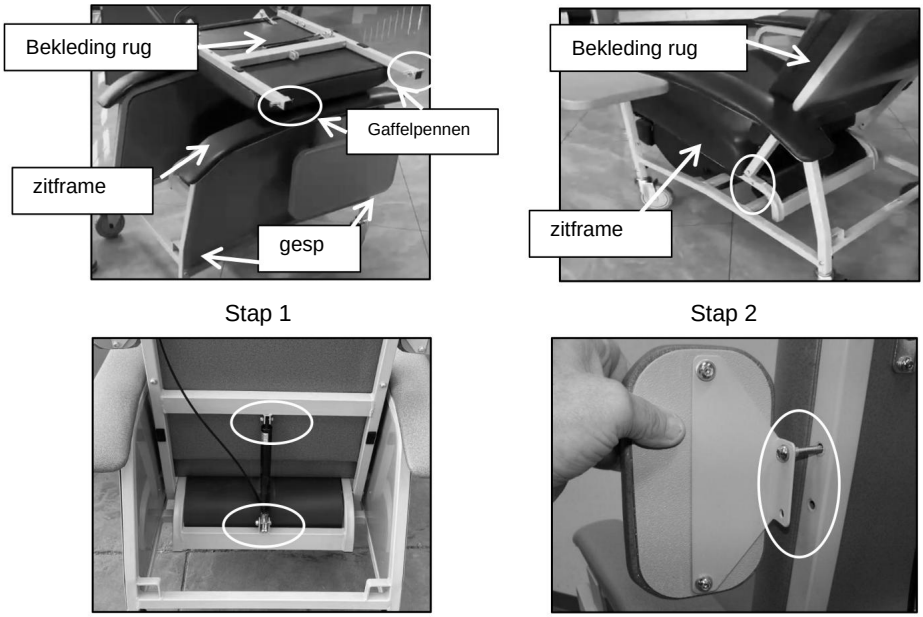

Figuur 3

Stap 1: Maak de gaffelpennen aan beide kanten los op de bekleding aan de achterkant, zodat de montagegaten goed zichtbaar zijn. blootgesteld. Druk op de gespen om de zijplaten (beide kanten) te verwijderen.

Stap 2: Lijn de gaten op de rechtopstaande rugbuizen van de gestoffeerde rugleuning uit met de gaten op het stoelframe. Plaats de borgpennen terug door de montagegaten. Bevestig de twee gaffelpennen door de brugklemmen terug te plaatsen.

Stap 3: Verwijder de kartonnen verzendbevestigingen rondom de gasveercilinder. De gaten aan beide uiteinden van de gasveer zijn uitgelijnd met de gaten in de zitting roem kruisbeugel en de gaten in de bekleding van de achterkant.

Stap 4: Lijn de gaten in de armsteunbevestiging uit met de bevestigingsgaten in het zitframe. Bevestig Schroef met moer. Herhaal dit aan de andere kant.

Machine Translated by Google

Schuiftabellen

Om een van beide tafels in een verhoogde positie te plaatsen:

Til de tafel helemaal omhoog en schuif hem naar binnen totdat de lipjes in de sleuven in de montagebeugel vallen.


Druk lichtjes op de tafel om ervoor te zorgen dat de vergrendelingslipjes vastklikken.

Om de tafel weer in de zelfopbergende positie te zetten:

Til de tafel omhoog totdat de lipjes de sleuven losmaken. Schuif de tafel naar buiten en laat hem zakken. Zie Figuur 4.

Verstelbare hoofdsteun

De scharnierende hoofdsteun kan in een comfortabele positie worden versteld door hem naar voren te trekken of terugduwen.

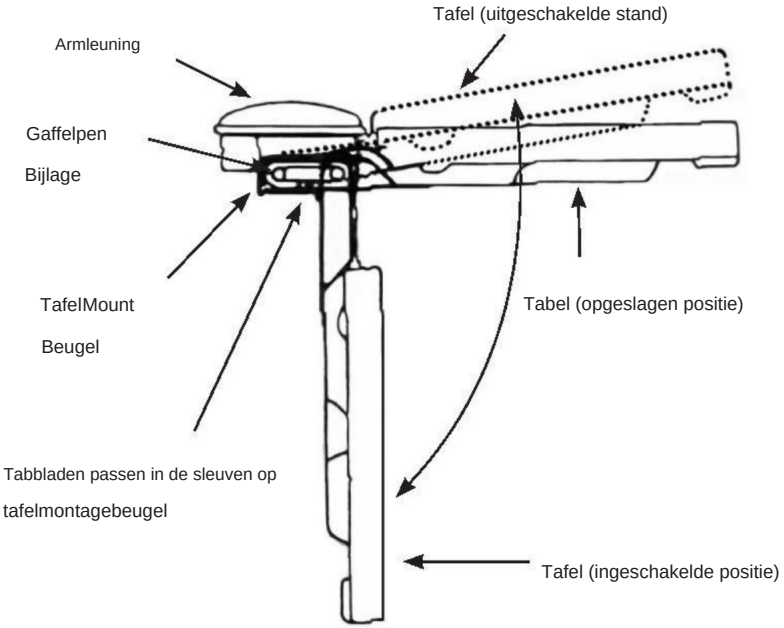

Figuur 4

Machine Translated by Google

Zitpositie

Rechtop: Beginpositie. Pak vanuit elke positie de gasveerbedieningshendel vast, leid de rug langzaam helemaal omhoog en laat de hendel los. Breng de patiënt terug naar de gewenste positie. positie door de gevoerde duwbeugel omhoog te duwen.

Diepe achteroverhelling: Pak vanuit de beginpositie de gasveerbedieningshendel met één hand vast. duw met uw hand terug op de gevoerde duwbeugel.

Verhoogde beensteun: Pak vanuit de beginpositie de gasveerbedieningshendel niet vast, maar duw de gevoerde duwhandgreep naar achteren.

Ttrendelenburg-positie: Pak vanuit elke positie de gasveerbedieningshendel vast met één hand terwijl u met de andere hand de hendel bedient, langzaam de rug naar beneden leiden volledig indrukken en de hendel loslaten.

Overig: De scharnierende hoofdsteun kan in de gewenste positie worden versteld door naar voren te trekken of terugduwen.

Machine Translated by Google



rechtop




diep achterover leunen



verhoogde beenrust



Trendelenburg-positie

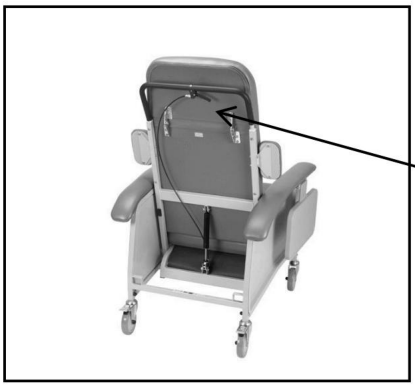

Rechtop (rug)

Figuur 5

Machine Translated by Google


CASTERBEDIENING

Om de wielen te vergrendelen:

Om te voorkomen dat de achterste zwenkwielen draaien, trapt u op het achterste pedaal van het zwenkwiel totdat het pedaal vastklikt. (De voorkant van het pedaal steekt uit de wielafdekking).

Om de wielen te ontgrendelen:

Trap op het uitstekende voorste deel van het pedaal om de vergrendeling los te maken en te ontgrendelen.

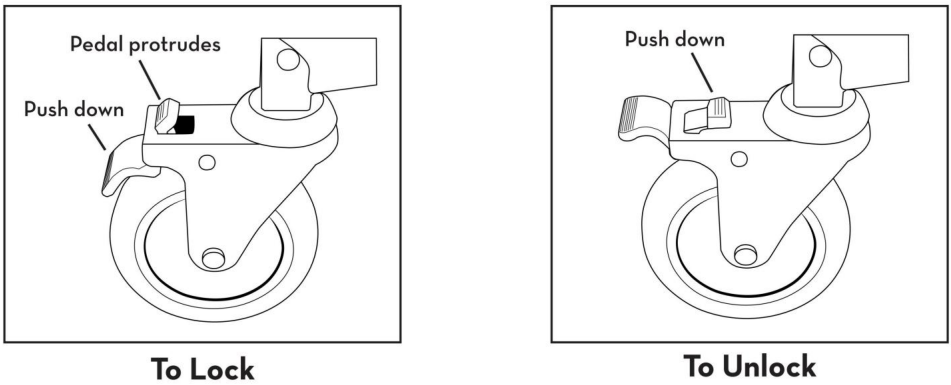

Figuur 6

LET OP:

Bedien de relaxfauteuil niet door kracht of druk uit te oefenen op de beensteun. Plaats uw handen of benen niet in vouwen in de buurt van het relaxfauteuilmechanisme.

De wielen moeten vergrendeld zijn, behalve tijdens transport.

ONDERHOUD&REINIGING

ELKE DRIE MAANDEN

Controleer en reinig de wielen/Draai de moeren aan/Controleer de remmen op de wielen/Controleer en reinig het vergrendelingsmechanisme voor het kantelen

Voor het onderhouden van stoffering en het verwijderen van vlekken zijn de volgende tips nuttig:

Normaal vuil: Wassen met warm water en een milde zeep of wasmiddel.

Machine Translated by Google

Hardnekkig vuil: Gebruik een zachte borstel en volg de bovenstaande instructies.

Ingetrokken vuil: schrob met een reinigingspoeder of een soortgelijk reinigingsmiddel.

Kauwgom: Voorzichtig schrapen.

Nagellak en nagellakremover: Dep de vlek onmiddellijk om schade te voorkomen.

Balpen: Dep onmiddellijk met een witte doek die is bevochtigd met horloge- of mineraalwater.
olie.

Waxen en opnieuw afwerken: Verbetert de draagbaarheid. Gebruik elke kwaliteit pasta wax.

Bij het schoonmaken kan een verdunde oplossing van 10% (of minder) bleekmiddel of chloor worden gebruikt deze stoel.

Fabrikant: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Adres: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu
Provincie,214400,China

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support