VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

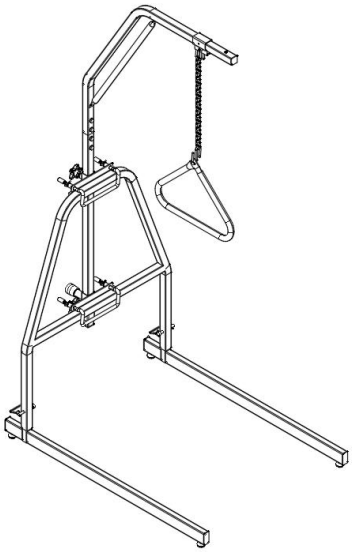
MODEL: FBL900978

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900978



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Patient Transfer Chair

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger

Warning

Weight Capacity: 250 lbs. Never use the stand assist for patients exceeding this weight.

- Only operate where permitted according to all applicable local laws and ordinances.
- Only qualified caregivers trained in the proper use of stent AIDS should use them.
- The Bed Trapeze Bar should only be used to assist the patient to sit on the bed. Stent assistance should not be used to transfer patients from one location to another.
- Before using the equipment, check all parts for shipping damage. If any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
- Before operating the stand assist, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.
- The rear caster must be locked before lowering the patient into the stand assist for transport.
- Avoid over tightening mounting hardware as this may cause damage to mounting brackets
- The stand assist may tip over if used incorrectly. Read and adhere to the operating instructions before transferring anyone.
- Exercise caution if leaving the stand assist under direct sunlight for an extended period as its surface may become hot.










Do not use for the purpose of transportation over long distances

Do no use for the purpose of seating over long extended periods Do not use this product if it is damaged, and do not use attachments or substitute parts Regular

maintenance of stand assist and accessories is necessary to ensure proper operation.


If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04.  1PCS
05.  1PCS	06.  1PCS	07.  4PCS	08.  4PCS
09.  2PCS	10.  2PCS	11.  1PCS	12.  1PCS
13 Eva Pad  1PCS			

NOTE: Some fasteners will have an emergency spare part

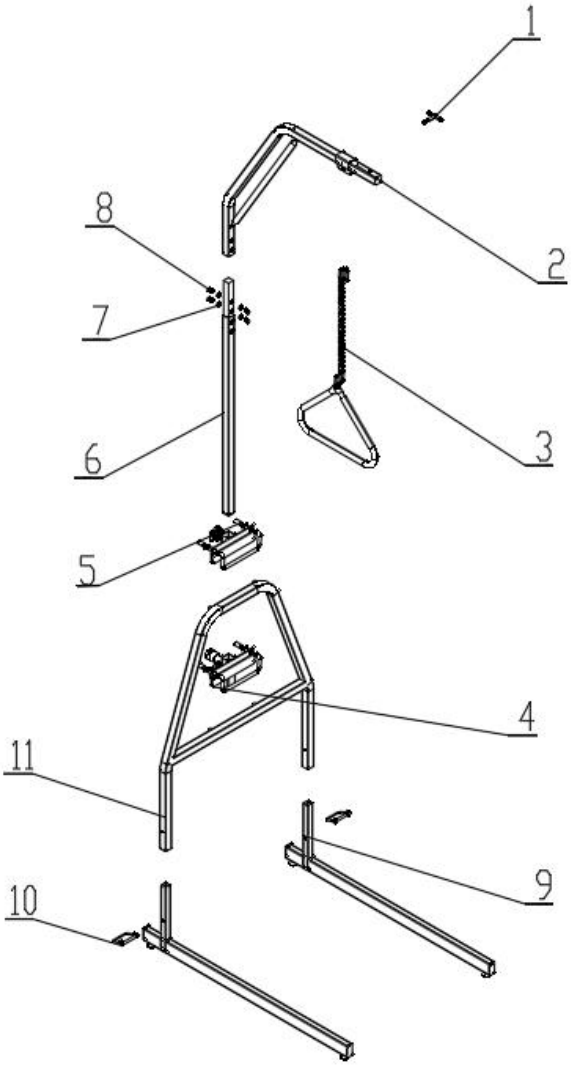
Explosion diagram



Assembly Steps


Step1

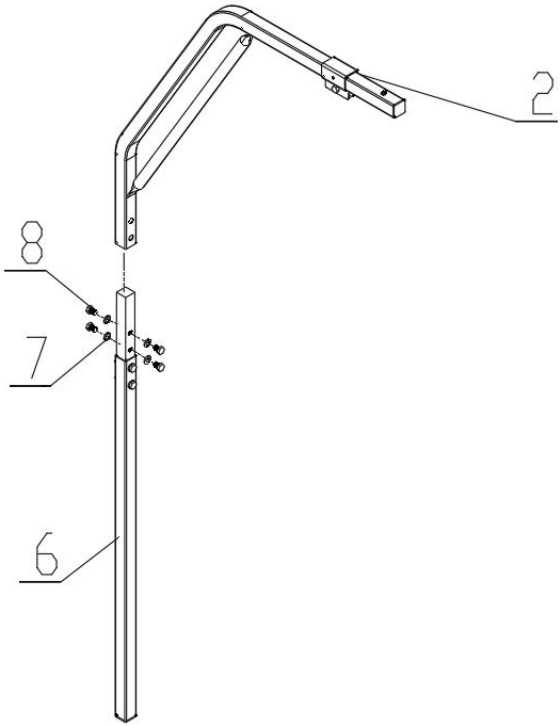Twist the four outer hex screws M10x16 (08) from the hanger standpipe assembly (06) and remove the four spring washers (07) with the outer hex wrench (with M10 screws) (12); Then insert the upper tube assembly (02) into the hanger standpipe assembly (06). After positioning the holes, screw the four outer hexagonal screws M10x16 (08) into the hanger standpipe assembly (06) through the spring washer (07); Finally, use an external hex wrench (with M10 screws) (12) to tighten.



Step2

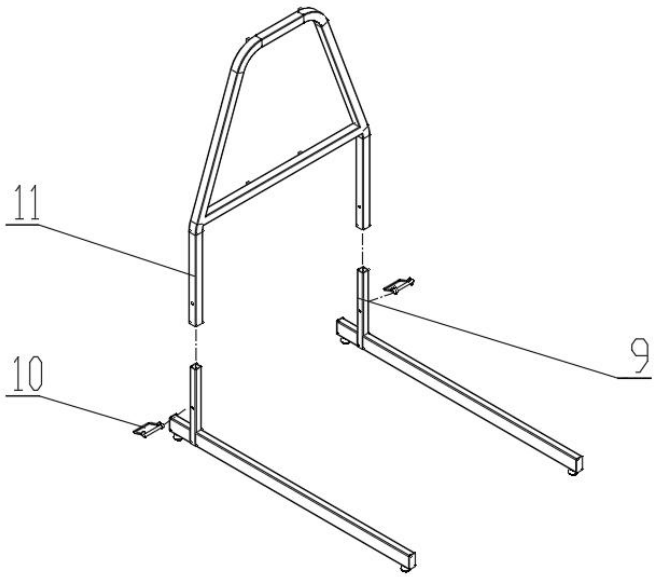Place the two tripod assemblies (09) in parallel at a distance of 68.5cm, and then align the two feet of the trapezoidal fixture assembly (11) with the standpipe of the two tripod assemblies (09) as shown in the figure; Finally, after the hole position is aligned, lock it with the card cable latch (10).




Step3

① Place the clamping assembly A (05) and the clamping assembly B (04) on the transverse tube of the trapezoidal fixing assembly (11) as shown in the figure;

② Insert the hanger standpipe assembly (06) into the short pipe of


clamping assembly A (05) and clamping assembly B (04) successively as shown in the following figure, and then tighten the knobs of clamping assembly A (05) and clamping assembly B (04) to fix them on the hanger standpipe assembly (06);

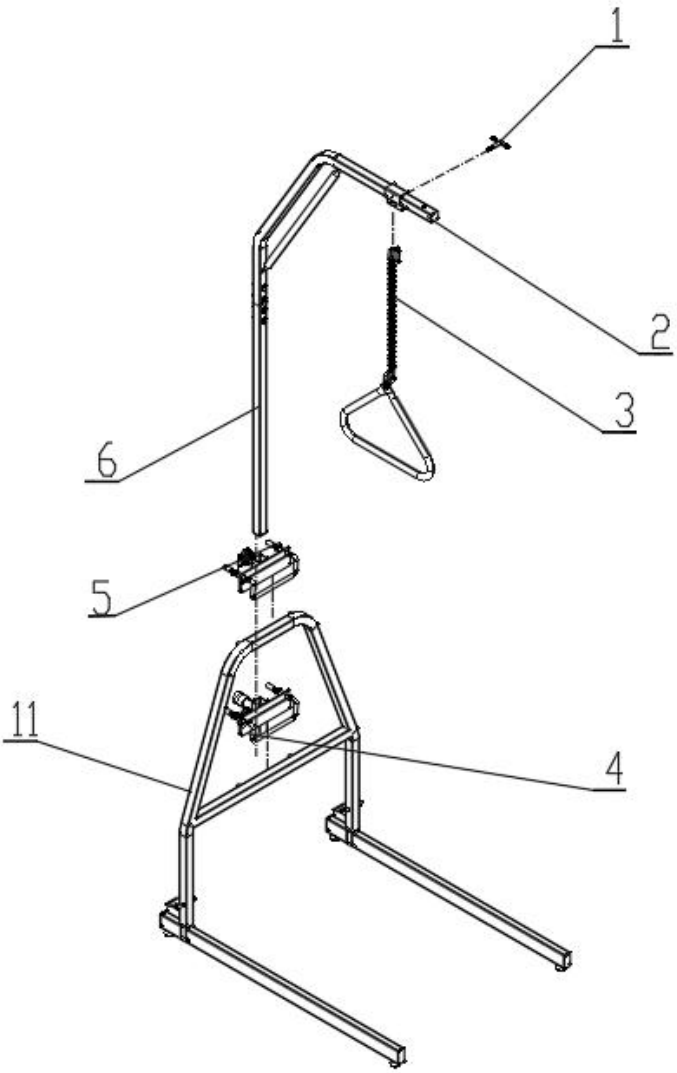③ Place the lifting ring assembly (03) into the clamp of the upper tube assembly (02) as shown in the figure below, and then tighten the locking assembly (01) through the clamp of the upper tube assembly (02) and the lifting ring assembly (03) in turn.



Step4

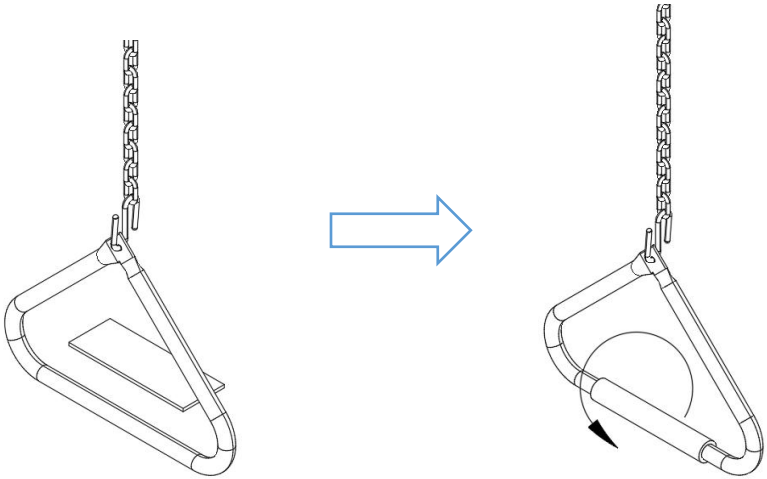After the assembly is completed, the EVA pad (13) can be ripped off the sticker and pasted on the grip of the ring as needed.



Tips：

Place the tripod assembly (09) under the bed and move the whole hanger into the bed. The knobs of the clamping assembly A (05) and the clamping assembly B (04) can be loosened to adjust the height of the hanger by moving the standpipe assembly (06) up and down (note: the clamping assembly A (05) needs to move between the (MIN) and (MAX) limit lines).

The clamp of the upper tube assembly (02) can be loosened by loosening the locking assembly (01) so that the clamp of the upper tube assembly (02) is no longer clamping the tube of the upper tube assembly (02), and then the clamp of the upper tube assembly (02) can be moved back and forth,

and the locking assembly (01) can be tightened again after being in a suitable position so that the clamp of the upper tube assembly (02) is clamping the upper tube assembly (02)

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation Precautions

- Do not exceed the recommended weight limit of 250 lbs
- Before use, make sure all assemblies are securely tightened and thoroughly read the operating instructions

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

- Wipe down the frame with a soft dry cloth at least once a week. If the stand assist comes into contact with moisture, dry it immediately.

Notice:

- Do not use solvents, abrasive waxes, caustic chemicals or spray silicone to clean the equipment.
- Do not use abrasive cleansers to clean the equipment, they could scratch the finish.
- Do not use steam or high-pressure cleaners to clean the equipment.

Maintenance:

To ensure safety and proper use, perform the following steps monthly: Check all fasteners for tightness and wear. Replace any worn or loose fasteners before use. Check the seat assemblies for damage or wear, and ensure bolts are tight. Replace any worn or damaged components.

Check the casters are functioning correctly and securely attached. Replace any worn or damaged casters

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trapez do łóżka

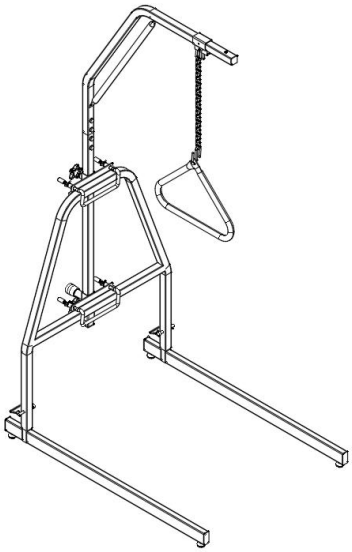
MODEL: FBL900978

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900978



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego Przeniesienie pacjenta C włosy
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

Operation safety

Proszę umieścić tę instrukcję w miejscu łatwym do sprawdzenia i przechowywać ją prawidłowo. Niniejsza instrukcja obsługi jasno wskazuje, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać ze sprzętu, aby zapobiec wszelkim szkodom lub stratom materialnym spowodowanym przez Ciebie i innych.

Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Nośność: 250 funtów. Nigdy nie używaj pomocy w staniu dla pacjentów przekraczających tę wagę.

- Należy korzystać wyłącznie z urządzeń dozwolonych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Tylko wykwalifikowani opiekunowie, przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania stentu AIDS, powinni go używać.
- Belka trapezowa do łóżka powinna być używana wyłącznie w celu pomocy pacjentowi w siadaniu na łóżku. Wspomaganie stentem nie powinno być używane do przenoszenia pacjentów z jednego miejsca do drugiego .
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy jej używać. użyj go i skontaktuj się z VEVOR w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Przed użyciem wspomagania stania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo i bezpiecznie zmontowane. i że wszystkie zapięcia są bezpieczne.
- Przed opuszczeniem pacjenta na podnośnik ułatwiający transport, należy zablokować tylne kółko.
- Unikaj ponad dokręcanie elementów montażowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uchwytów montażowych
- Wspomaganie stania może się przewrócić, jeśli zostanie użyte nieprawidłowo. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi. przed przeniesieniem kogokolwiek.









- Należy zachować ostrożność, jeśli stojak będzie wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzać.


Nie używać do transportu na duże odległości.

Nie należy używać produktu w celu siedzenia przez dłuższy czas. Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony, ani stosować żadnych dodatków lub części zamiennych. Regularna konserwacja układu wspomagającego stanie i akcesoriów jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, koniecznie dołącz do niego instrukcję obsługi.


Part List

01.  1 SZT.	02.  1 SZT.	03.  1 SZT.	04.  1 SZT.
05.  1 SZT.	06.  1 SZT.	07.  4 SZT.	08.  4 SZT.
09.  2 SZT.	10.  2 SZT.	11.  1 SZT.	12.  1 SZT.

13 Eva Pad  1 SZT.			

NOTATKA: Niektóre elementy złączne będą miały awaryjną część zamienną

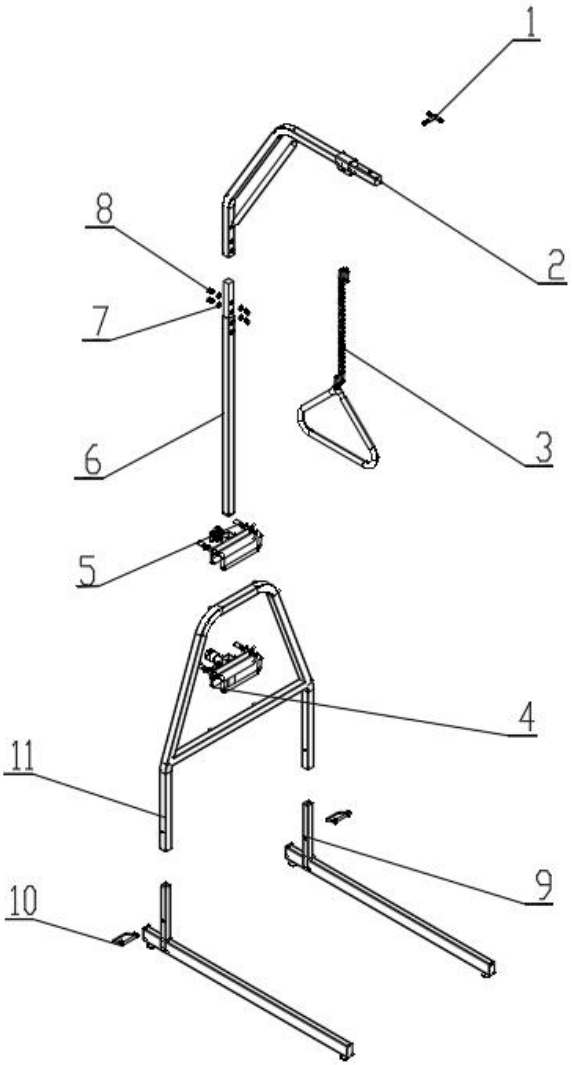
Explosion diagram



Assembly Steps

Krok 1

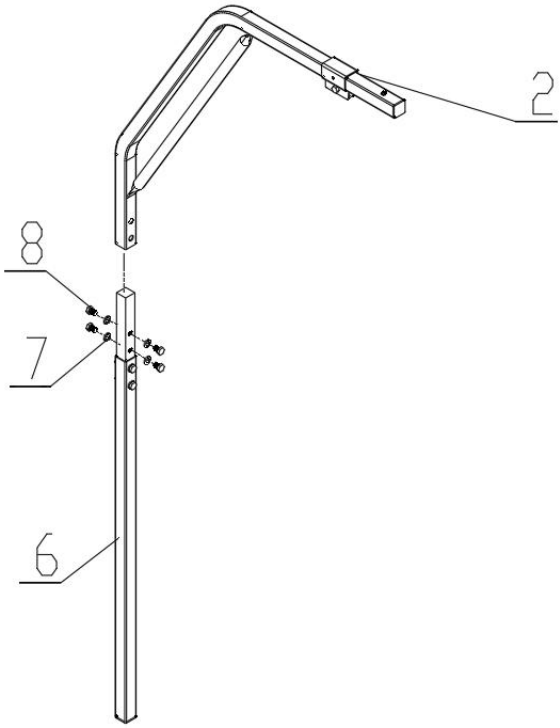
Odkręć cztery zewnętrzne śruby imbusowe M10x16 (08) z zespołu rury stojaka wieszaka (06) i usuń cztery podkładki sprężyste (07) za pomocą zewnętrznego klucza imbusowego (ze śrubami M10) (12); Następnie włóż górny zespół rury (02) do zespołu rury stojaka wieszaka (06). Po ustawieniu otworów wkręć cztery zewnętrzne śruby imbusowe M10x16 (08) do zespołu rury stojaka wieszaka (06) przez podkładkę sprężystą (07); Na koniec użyj zewnętrznego klucza imbusowego (ze śrubami M10) (12), aby dokręcić.



Krok 2

Umieść dwa zespoły statywów (09) równolegle w odległości 68,5 cm, a

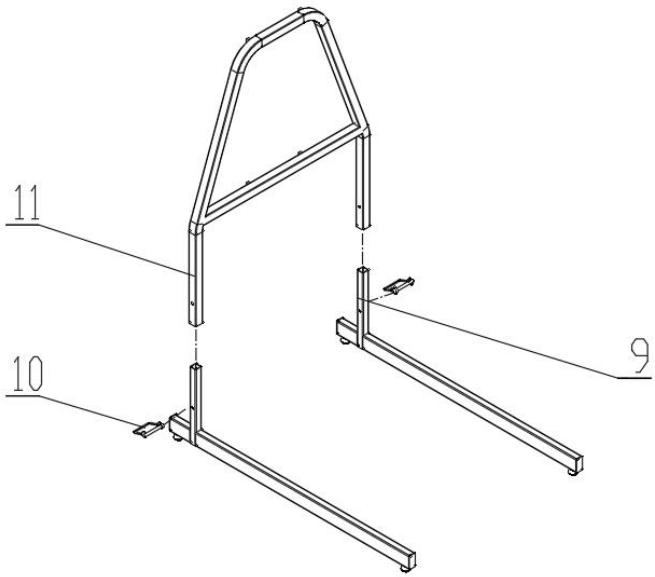następnie wyrównaj dwie nóżki zespołu oprawy trapezowej (11) z rurą stojącą dwóch zespołów statywów (09), jak pokazano na rysunku. Na koniec, po wyrównaniu położenia otworu, zablokuj go za pomocą zatrzasku kablowego (10).




Krok 3

① Na rurę poprzeczną trapezowego zespołu mocującego (11) nałożyć zespół zaciskowy A (05) i zespół zaciskowy B (04), jak pokazano na rysunku;

② Włóż zespół rury stojącej wieszaka (06) kolejno do krótkiej rury zespołu zaciskowego A (05) i zespołu zaciskowego B (04), jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie dokręć pokrętła zespołu zaciskowego A (05) i zespołu zaciskowego B (04), aby zamocować je na zespole rury stojącej wieszaka (06);


③ Umieść zespół pierścienia podnoszącego (03) w zacisku zespołu

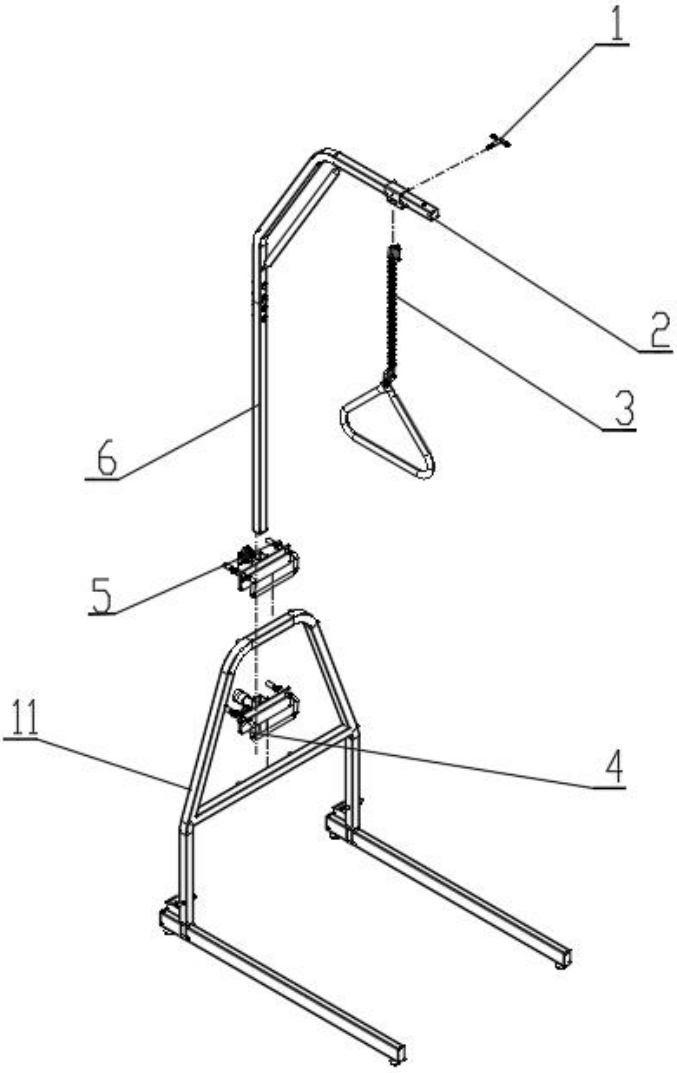
górnej rury (02), jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie dokręć zespół blokujący (01) kolejno przez zacisk zespołu górnej rury (02) i zespół pierścienia podnoszącego (03).



Krok 4

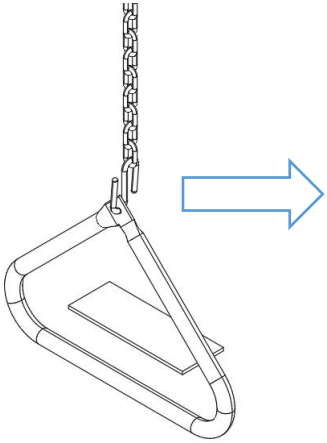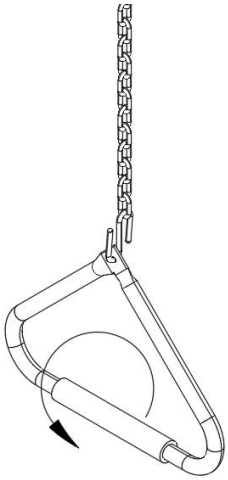Po zakończeniu montażu podkładkę EVA (13) można oderwać od naklejki i przykleić na uchwycie pierścionka, jeśli zajdzie taka potrzeba.





Porady:

Umieść zespół statywu (09) pod łóżkiem i przesuń cały wieszak do łóżka.

Pokrętła zespołu zaciskowego A (05) i zespołu zaciskowego B (04) można poluzować, aby dostosować wysokość wieszaka, przesuwając zespół rury pionowej (06) w górę i w dół (uwaga: zespół zaciskowy A (05) musi poruszać się między liniami granicznymi (MIN) i (MAX)).

Zacisk zespołu rur górnych (02) można poluzować poprzez poluzowanie zespołu blokującego (01), tak aby zacisk zespołu rur górnych (02) nie zaciskał już rury zespołu rur górnych (02), a następnie zacisk zespołu rur górnych (02) można przesuwać tam i z powrotem, a zespół blokujący (01) można ponownie dokręcić po ustawieniu w odpowiedniej pozycji, tak aby zacisk zespołu rur górnych (02) zaciskał zespół rur górnych (02).

OPERATING INSTRUCTIONS

Środki ostrożności podczas operacji

- Nie przekraczać zalecanego limitu wagi 250 funtów
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy montażowe są solidnie dokręcone i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

CARE AND MAINTENANCE

Czyszczenie:

- Przetrzyj ramę miękką, suchą ściereczką przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli dojdzie do kontaktu wspornika ze stojakiem, z wilgocią, natychmiast wysuszyć.

Ogłoszenie :

- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać rozpuszczalników, ściernych wosków, żrących środków chemicznych ani silikonu w sprayu.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą zarysować powierzchnię.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać myjek parowych ani

wysokociśnieniowych.

Konserwacja:

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, należy co miesiąc wykonywać następujące czynności: Sprawdź wszystkie zapięcia pod kątem szczelności i zużycia. Wymień wszelkie zużyte lub luźne zapięcia przed użyciem.

Sprawdź zespoły siedzeń pod kątem uszkodzeń lub zużycia i upewnij się, że śruby są dokręcone. Wymień zużyte lub uszkodzone elementy.

Sprawdź, czy kółka działają prawidłowo i są bezpiecznie zamocowane. Wymień zużyte lub uszkodzone kółka

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betttrapez

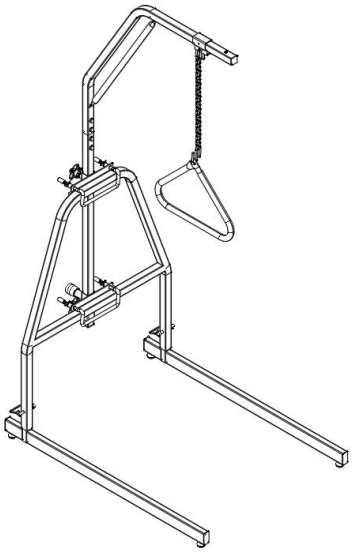
MODELL: FBL900978

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900978



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz. Die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Patiententransferstuhl

Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Operation safety

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die sichere und korrekte Verwendung des Geräts, um Schäden oder Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden.

Gefahr

Warnung

Gewichtskapazität: 250 lbs. Verwenden Sie die Aufstehhilfe niemals für Patienten, die dieses Gewicht überschreiten.

- Betreiben Sie das Gerät nur dort, wo es gemäß allen geltenden örtlichen Gesetzen und Verordnungen zulässig ist.
- Die Verwendung von Stent-AIDS sollte ausschließlich von qualifiziertem Pflegepersonal erfolgen, das in der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Geräte geschult ist.
- Die Betttrapezstange sollte nur verwendet werden, um dem Patienten beim Sitzen auf dem Bett zu helfen. Die Stentunterstützung sollte nicht zum Transfer von Patienten von einem Ort zum anderen verwendet werden .
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an VEVOR .
- Bevor Sie die Aufstehhilfe in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher montiert sind und dass alle Befestigungselemente sicher sind.
- Bevor der Patient zum Transport in die Aufstehhilfe abgesenkt wird, muss die hintere Laufrolle festgestellt werden.
- Vermeiden Sie über Festziehen der Montageteile, da dies zu Schäden an den Montagehalterungen führen kann
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Aufstehhilfe umkippen. Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie jemanden überweisen.









- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Standhilfe längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da die Oberfläche kann heiß werden.


Nicht für den Transport über längere Strecken verwenden

Nicht zum Sitzen über längere Zeiträume verwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist, und keine Anbauteile oder Ersatzteile verwenden. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung der Aufstehhilfe und des Zubehörs erforderlich.

Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.


Part List

01.  1 STÜCK	02.  1 STÜCK	03.  1 STÜCK	04.  1 STÜCK
05.  1 STÜCK	06.  1 STÜCK	07.  4 STK	08.  4 STK
09.  2 STÜCKE	10.  2 STÜCKE	11.  1 STÜCK	12.  1 STÜCK

13 Eva Pad  1 STÜCK			

NOTIZ: Für einige Befestigungselemente gibt es ein Notfall-Ersatzteil

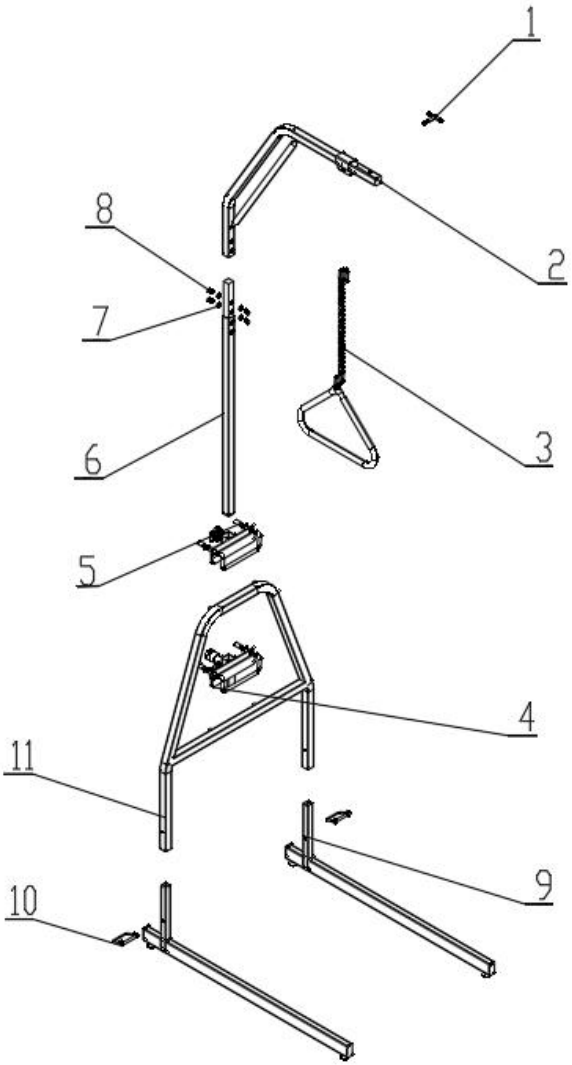
Explosion diagram



Assembly Steps

Schritt1

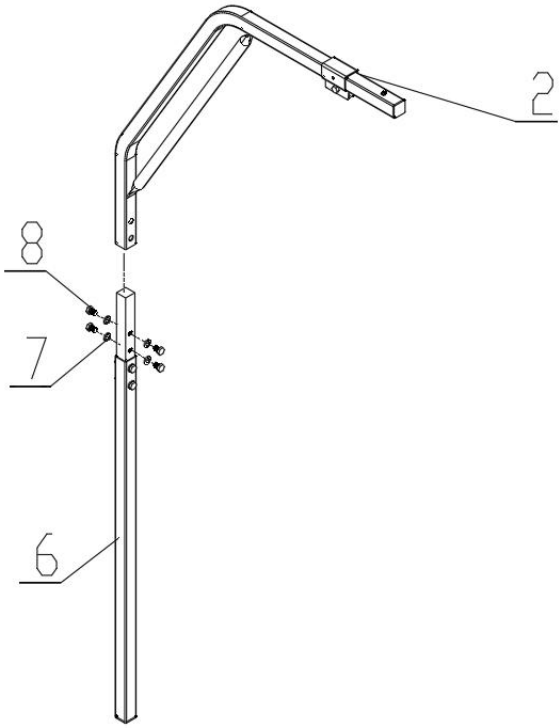
Die vier äußeren Sechskantschrauben M10x16 (08) aus der Baugruppe Aufhängungsstandrohr (06) herausdrehen und die vier Federscheiben (07) mit dem äußeren Sechskantschlüssel (mit M10 Schrauben) (12) entfernen; Anschließend die obere Rohrbaugruppe (02) in die Baugruppe Aufhängungsstandrohr (06) einsetzen. Nach dem Positionieren der Löcher die vier äußeren Sechskantschrauben M10x16 (08) durch die Federscheiben (07) in die Baugruppe Aufhängungsstandrohr (06) einschrauben; Abschließend mit einem äußeren Sechskantschlüssel (mit M10 Schrauben) (12) festziehen.



Schritt 2

Platzieren Sie die beiden Stativbaugruppen (09) parallel in einem Abstand

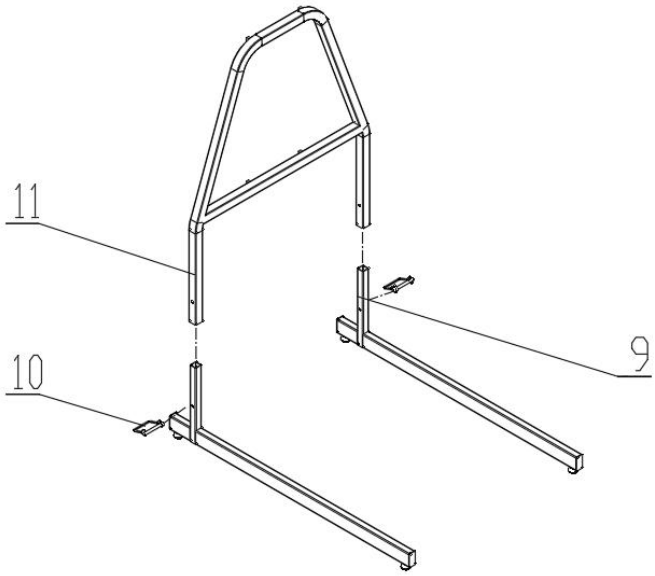von 68,5 cm und richten Sie dann die beiden Füße der trapezförmigen Vorrichtungsbaugruppe (11) mit dem Standrohr der beiden Stativbaugruppen (09) aus, wie in der Abbildung gezeigt. Nachdem die Lochposition ausgerichtet ist, verriegeln Sie sie schließlich mit der Kartenkabelverriegelung (10).




Schritt3

① Setzen Sie die Klemmbaugruppe A (05) und die Klemmbaugruppe B (04) wie in der Abbildung gezeigt auf das Querrohr der Trapezbefestigung (11).

2. Setzen Sie die Aufhänger-Standrohrbaugruppe (06) nacheinander in das kurze Rohr der Klemmbaugruppe A (05) und der Klemmbaugruppe B (04) ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, und ziehen Sie dann die Knöpfe der Klemmbaugruppe A (05) und der Klemmbaugruppe B (04) fest, um sie an der Aufhänger-Standrohrbaugruppe (06) zu befestigen.


③ Setzen Sie die Heberingbaugruppe (03) in die Klemme der oberen

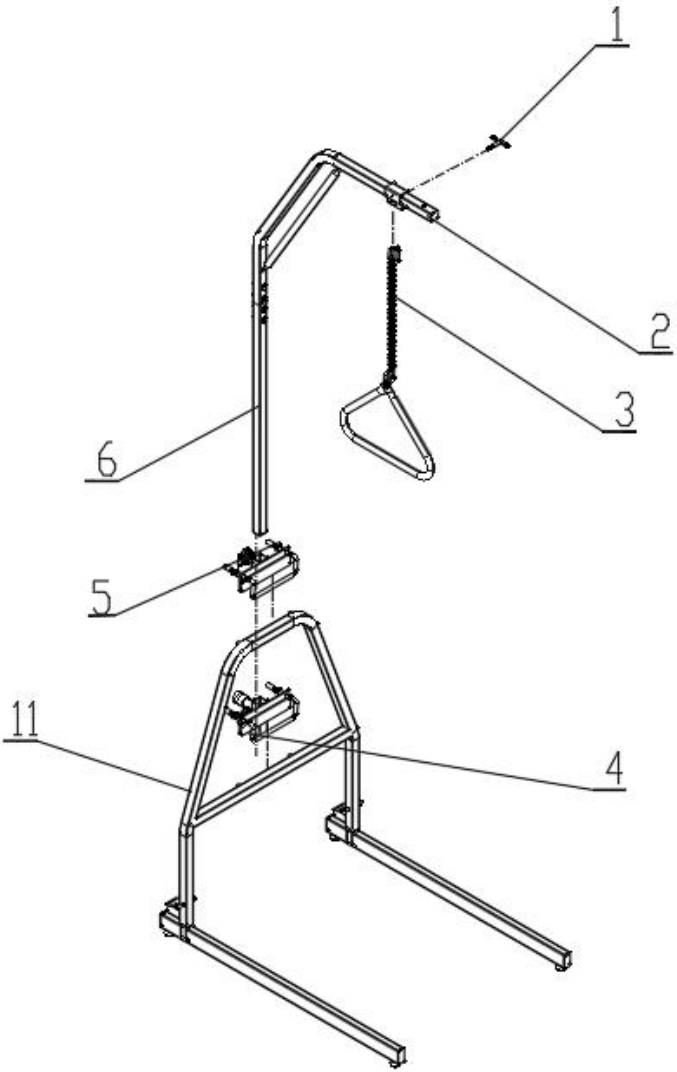Rohrbaugruppe (02) ein, wie in der Abbildung unten gezeigt, und ziehen Sie dann die Verriegelungsbaugruppe (01) nacheinander durch die Klemme der oberen Rohrbaugruppe (02) und die Heberingbaugruppe (03) fest.



Schritt4

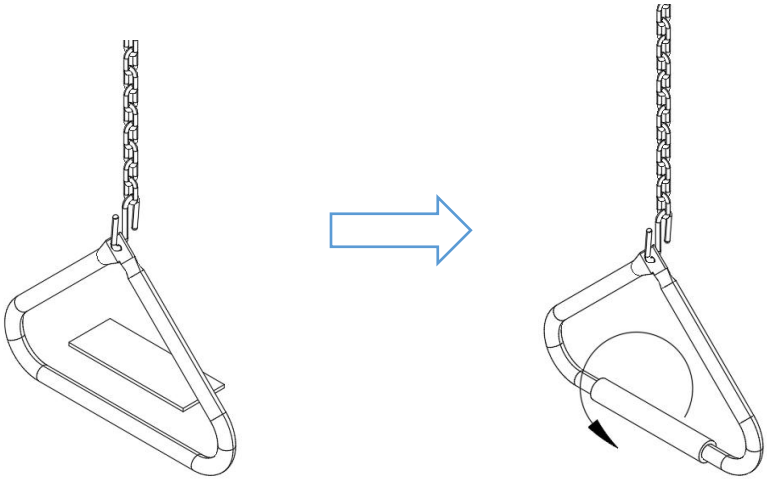Nach Abschluss der Montage kann das EVA-Pad (13) vom Aufkleber abgerissen und bei Bedarf auf den Griff des Rings geklebt werden.



Tipps:

Platzieren Sie die Stativeinheit (09) unter dem Bett und schieben Sie den gesamten Aufhänger in das Bett hinein. Die Knöpfe der Klemmeinheit A (05) und der Klemmeinheit B (04) können gelöst werden, um die Höhe des Aufhängers durch Auf- und Abbewegen der Standrohreinheit (06) einzustellen (Hinweis: Die Klemmeinheit A (05) muss sich zwischen den Grenzlinien (MIN) und (MAX) bewegen).

Die Klemme der oberen Rohrbaugruppe (02) kann durch Lösen der Verriegelungsbaugruppe (01) gelöst werden, sodass die Klemme der oberen Rohrbaugruppe (02) das Rohr der oberen Rohrbaugruppe (02)

nicht mehr festklemmt. Anschließend kann die Klemme der oberen Rohrbaugruppe (02) hin und her bewegt werden. Die Verriegelungsbaugruppe (01) kann in einer geeigneten Position wieder festgezogen werden, sodass die Klemme der oberen Rohrbaugruppe (02) die obere Rohrbaugruppe (02) festklemmt.

OPERATING INSTRUCTIONS

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

- Überschreiten Sie nicht das empfohlene Gewichtslimit von 250 lbs
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Baugruppen fest angezogen sind und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch

CARE AND MAINTENANCE

Reinigung:

- Wischen Sie den Rahmen mindestens einmal pro Woche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Aufstehhilfe in Kontakt kommt mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, trocknen Sie es sofort ab.

Beachten :

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuerwachse, ätzenden Chemikalien oder Silikonsprays.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keine Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Wartung:

Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, führen Sie monatlich die folgenden Schritte durch: Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz und Verschleiß. Ersetzen Sie verschlissene oder lose Befestigungselemente vor Gebrauch. Überprüfen Sie die Sitzbaugruppen auf Beschädigungen oder Verschleiß und stellen Sie sicher, dass

die Schrauben fest angezogen sind. Ersetzen Sie alle verschlissenen oder beschädigte Komponenten.
Überprüfen Sie, ob die Rollen ordnungsgemäß funktionieren und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Rollen.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 2F-2, 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barre trapèze de lit

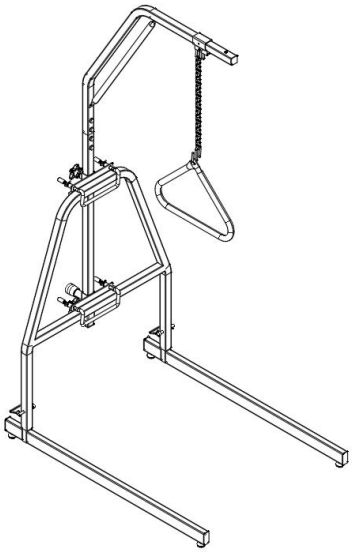
MODÈLE: FBL900978

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODÈLE: FBL900978



Remarque : l'image du produit est à titre de référence, les détails réels prévalent

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Chaise de transfert de patient

Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operation safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facile à consulter et le conserver soigneusement. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout dommage matériel, pour vous et autrui.

Danger

Avertissement

Capacité de poids : 250 lb. N'utilisez jamais l'assistance au support pour les patients dépassant ce poids.

- N'utilisez ce produit que là où cela est autorisé par toutes les lois et ordonnances locales applicables.
- Seuls les soignants qualifiés et formés à l’ utilisation appropriée des stents AIDS doivent les utiliser.
- La barre trapèze du lit ne doit être utilisée que pour aider le patient à s'asseoir sur le lit. L'utilisation d'un stent ne doit pas servir à transférer le patient d'un endroit à un autre .
- Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne utilisez-le et contactez VEVOR pour plus d'instructions.
- Avant d'utiliser l'assistance au support, assurez-vous que tous les composants sont correctement et solidement assemblés et que toutes les fixations sont sécurisées.
- La roulette arrière doit être verrouillée avant d'abaisser le patient dans le support pour le transport.
- Évitez de trop serrer le matériel de montage car cela pourrait endommager les supports de montage
- Le support de béquille peut basculer s'il est mal utilisé. Veuillez lire et respecter les instructions d'utilisation. avant de transférer qui que ce soit.









- Soyez prudent si vous laissez le support sous la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, car sa surface peut devenir chaud.


Ne pas utiliser pour le transport sur de longues distances

Ne pas utiliser pour s'asseoir pendant de longues périodes. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé et n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange. Un entretien régulier du support et des accessoires est nécessaire pour garantir un bon fonctionnement.

Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez inclure ce manuel du propriétaire.


Part List

01.  1 pièce	02.  1 pièce	03.  1 pièce	04.  1 pièce
05.  1 pièce	06.  1 pièce	07.  4 pièces	08.  4 pièces
09.  2 pièces	10.  2 pièces	11.  1 pièce	12.  1 pièce

13 Eva Pad  1 pièce			

NOTE: Certaines fixations auront une pièce de rechange d'urgence

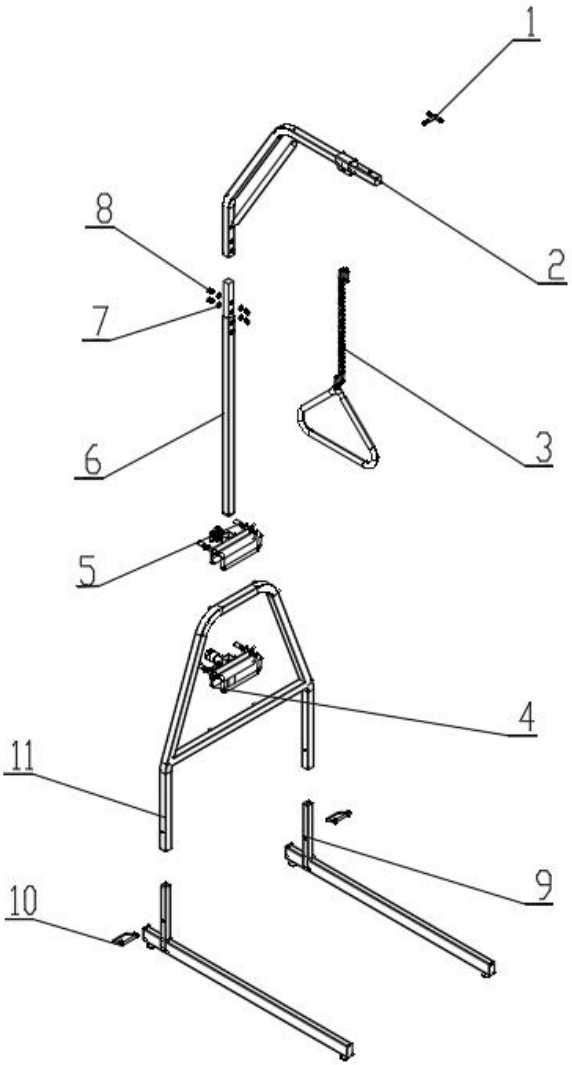
Explosion diagram



Assembly Steps

Étape 1

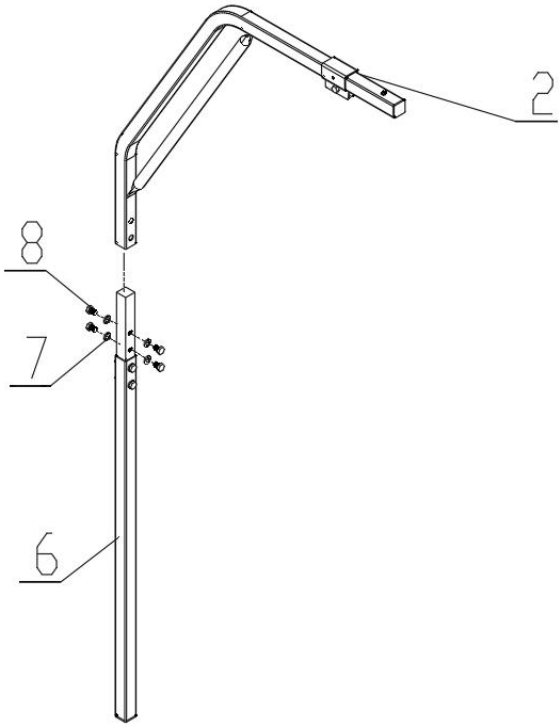
Dévissez les quatre vis hexagonales extérieures M10x16 (08) du tube vertical de suspension (06) et retirez les quatre rondelles élastiques (07) à l'aide de la clé hexagonale extérieure (avec vis M10) (12). Insérez ensuite le tube supérieur (02) dans le tube vertical de suspension (06). Après avoir positionné les trous, vissez les quatre vis hexagonales extérieures M10x16 (08) dans le tube vertical de suspension (06) à travers la rondelle élastique (07). Enfin, utilisez une clé hexagonale extérieure (avec vis M10) (12) pour serrer.



Étape 2

Placez les deux ensembles de trépieds (09) en parallèle à une distance de 68,5 cm, puis alignez les deux pieds de l'ensemble de fixation trapézoïdale

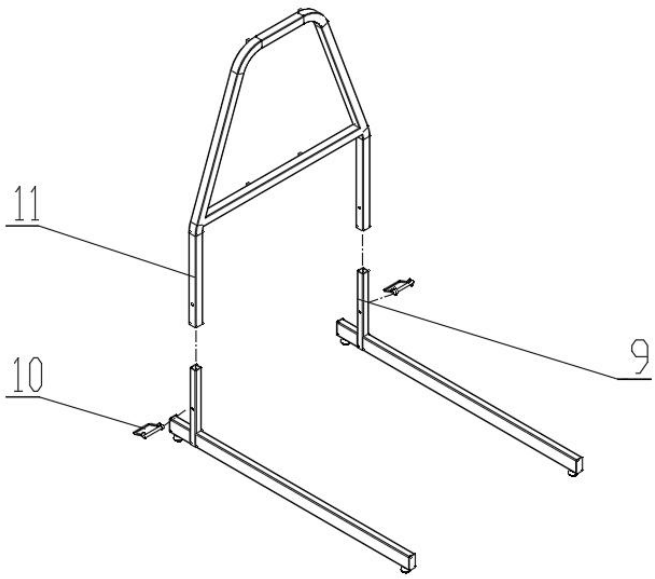(11) avec le tube vertical des deux ensembles de trépieds (09) comme indiqué sur la figure ; Enfin, une fois la position du trou alignée, verrouillez-la avec le loquet du câble de la carte (10).




Étape 3

1. Placer l'ensemble de serrage A (05) et l'ensemble de serrage B (04) sur le tube transversal de l'ensemble de fixation trapézoïdal (11) comme indiqué sur la figure ;
2. Insérez l'ensemble de tube vertical de suspension (06) dans le tube court de l'ensemble de serrage A (05) et de l'ensemble de serrage B (04) successivement comme indiqué dans la figure suivante, puis serrez les boutons de l'ensemble de serrage A (05) et de l'ensemble de serrage B (04) pour les fixer sur l'ensemble de tube vertical de suspension (06) ;

③ Placez l'ensemble de l'anneau de levage (03) dans la pince de

l'ensemble du tube supérieur (02) comme indiqué sur la figure ci-dessous, puis serrez l'ensemble de verrouillage (01) à travers la pince de l'ensemble

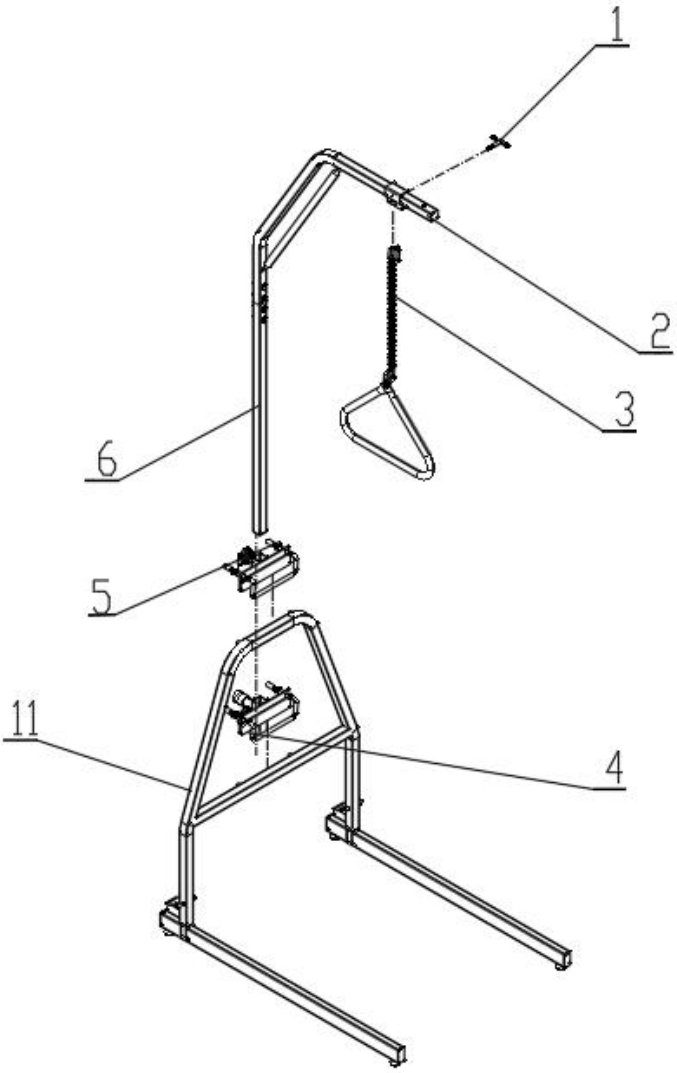
du tube supérieur (02) et l'ensemble de l'anneau de levage (03) à tour de rôle.




Étape 4

Une fois l'assemblage terminé, le tampon EVA (13) peut être arraché

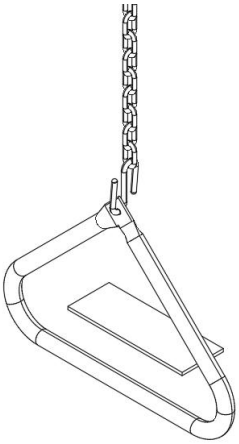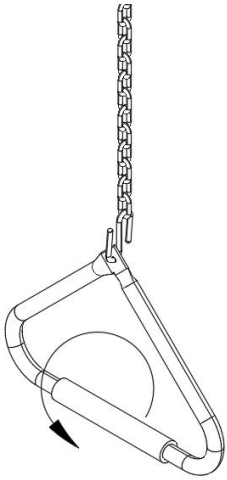de l'autocollant et collé sur la poignée de l'anneau selon les besoins.





Conseils:

Placez le trépied (09) sous le plateau et insérez le cintre dans le plateau. Les molettes des ensembles de serrage A (05) et B (04) peuvent être desserrées pour régler la hauteur du cintre en déplaçant le tube vertical (06) vers le haut et vers le bas (remarque : l'ensemble de serrage A (05) doit se déplacer entre les limites (MIN) et (MAX).

La pince de l'ensemble tube supérieur (02) peut être desserrée en desserrant l'ensemble de verrouillage (01) de sorte que la pince de l'ensemble tube supérieur (02) ne serre plus le tube de l'ensemble tube supérieur (02), puis la pince de l'ensemble tube supérieur (02) peut être déplacée d'avant en arrière, et l'ensemble de verrouillage (01) peut être resserré après avoir été dans une position appropriée de sorte que la pince de l'ensemble tube supérieur (02) serre l'ensemble tube supérieur (02)

OPERATING INSTRUCTIONS

Précautions d'utilisation

- Ne pas dépasser la limite de poids recommandée de 250 lb
- Avant utilisation, assurez-vous que tous les assemblages sont bien serrés et lisez attentivement le mode d'emploi.

CARE AND MAINTENANCE

Nettoyage:

- Essuyez le cadre avec un chiffon doux et sec au moins une fois par semaine.

Si le support entre en contact avec de l'humidité, séchez-le immédiatement.

Avis :

- N'utilisez pas de solvants, de cires abrasives, de produits chimiques caustiques ou de silicone en spray pour nettoyer l'équipement.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'équipement, ils pourraient rayer la finition.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'équipement.

Entretien:

Pour garantir la sécurité et une utilisation correcte, effectuez les étapes suivantes tous les mois : Vérifiez le serrage et l'usure de toutes les fixations. Remplacez toute fixation usée ou desserrée avant utilisation. Vérifiez que les sièges ne sont ni endommagés ni usés et assurez-vous que les boulons sont bien serrés.
Remplacez tout élément usé ou composants endommagés.
Vérifiez que les roulettes fonctionnent correctement et sont solidement fixées.
Remplacez les roulettes usées ou endommagées.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 2F-2, 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté de Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

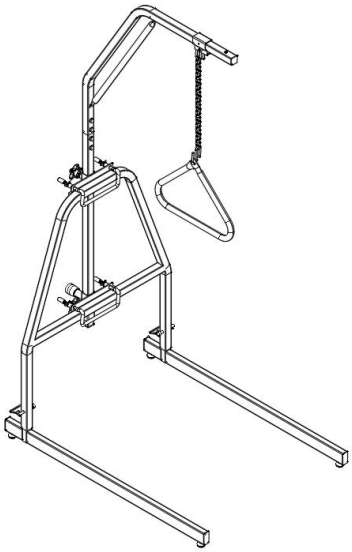
MODEL: FBL900978

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900978



Let op: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn doorslaggevend.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen Patiëntenoverdrachtsstoel
Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Operation safety

Leg deze handleiding op een plek waar u hem gemakkelijk kunt controleren en bewaar hem op de juiste manier. Deze instructiehandleiding geeft duidelijk aan hoe u de apparatuur veilig en correct kunt gebruiken, om schade of verlies van eigendommen voor u en anderen te voorkomen.

Gevaar

Waarschuwing

Draagvermogen: 250 lbs. Gebruik de stahulp nooit voor patiënten die dit gewicht overschrijden.

- Gebruik het apparaat alleen als dit is toegestaan volgens de plaatselijke wetten en verordeningen.
- Alleen gekwalificeerde verzorgers die getraind zijn in het juiste gebruik van stenthulpmiddelen, mogen deze gebruiken.
- De Bed Trapeze Bar mag alleen worden gebruikt om de patiënt te helpen op het bed te zitten. Stent-assistentie mag niet worden gebruikt om patiënten van de ene naar de andere locatie te verplaatsen .
- Controleer alle onderdelen op transportschade voordat u het apparaat gebruikt. Als een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken. gebruik het en neem contact op met VEVOR voor verdere instructies.
- Voordat u de stand assist gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen goed en stevig zijn gemonteerd. en dat alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Voordat u de patiënt in de sta-op-hulp laat zakken voor transport, moet het achterste zwenkwiel worden vergrendeld.
- Vermijd over het aandraaien van de bevestigingsmaterialen, omdat dit schade aan de montagebeugels kan veroorzaken
- De stand assist kan omvallen als deze verkeerd wordt gebruikt. Lees en volg de gebruiksaanwijzing voordat u iemand overplaatst.

- Wees voorzichtig als u de standaard gedurende langere tijd in direct zonlicht laat staan, omdat het oppervlak kan heet worden.










Niet gebruiken voor transport over lange afstanden


Gebruik dit product niet om er langdurig op te zitten. Gebruik dit product niet als het beschadigd is en gebruik geen hulpstukken of vervangende onderdelen.

Regelmatig onderhoud van de standhulp en accessoires is noodzakelijk om een goede werking te garanderen.

Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u ook de handleiding van deze eigenaar meesturen.


Part List

01.  1 STUKS	02.  1 STUKS	03.  1 STUKS	04.  1 STUKS
05.  1 STUKS	06.  1 STUKS	07.  4 STUKS	08.  4 STUKS
09.  2 STUKS	10.  2 STUKS	11.  1 STUKS	12.  1 STUKS

13 Eva Pad  1 STUKS			

OPMERKING: Sommige bevestigingsmiddelen hebben een noodreserveonderdeel

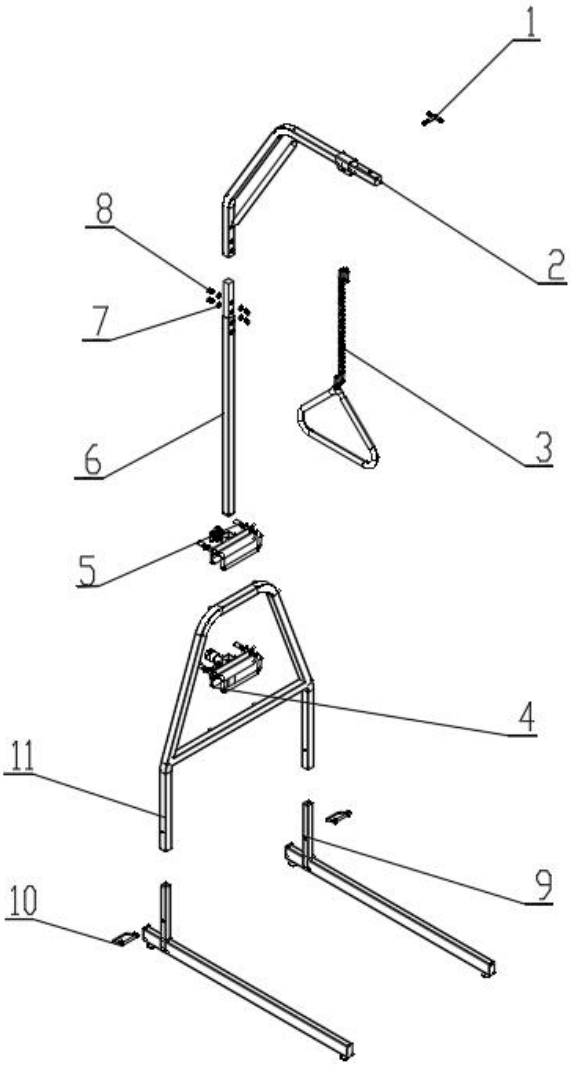
Explosion diagram



Assembly Steps

Stap 1

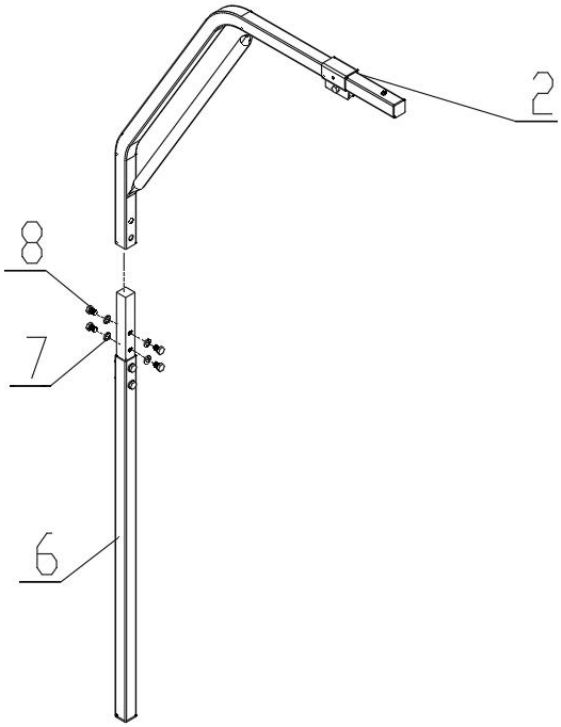
Draai de vier buitenste zeskantschroeven M10x16 (08) uit de hangerstandpijpconstructie (06) en verwijder de vier veerringen (07) met de buitenste zeskantsleutel (met M10-schroeven) (12); Plaats vervolgens de bovenste buisconstructie (02) in de hangerstandpijpconstructie (06). Nadat u de gaten hebt gepositioneerd, schroeft u de vier buitenste zeskantschroeven M10x16 (08) in de hangerstandpijpconstructie (06) door de veerring (07); Gebruik ten slotte een externe zeskantsleutel (met M10-schroeven) (12) om vast te draaien.



Stap 2

Plaats de twee statiefconstructies (09) parallel op een afstand van 68,5 cm en lijn vervolgens de twee voeten van de trapeziumvormige

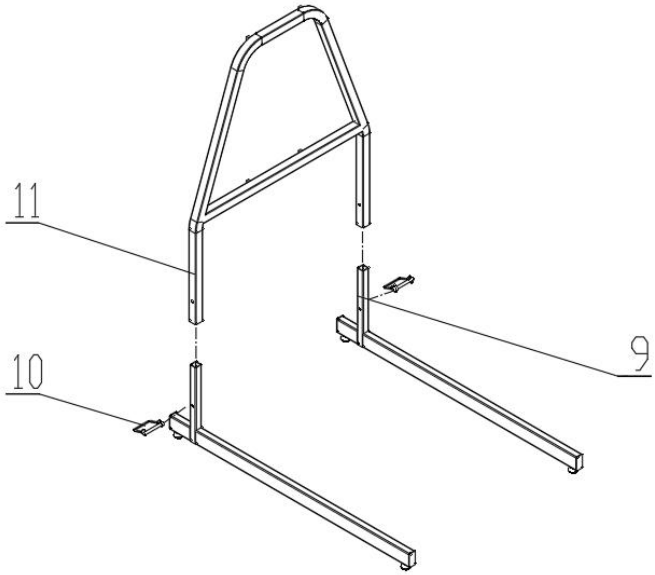bevestigingsconstructie (11) uit met de standpijp van de twee statiefconstructies (09) zoals weergegeven in de afbeelding; Vergrendel ten slotte, nadat de gatpositie is uitgelijnd, deze met de vergrendeling van de kaartkabel (10).



Stap 3

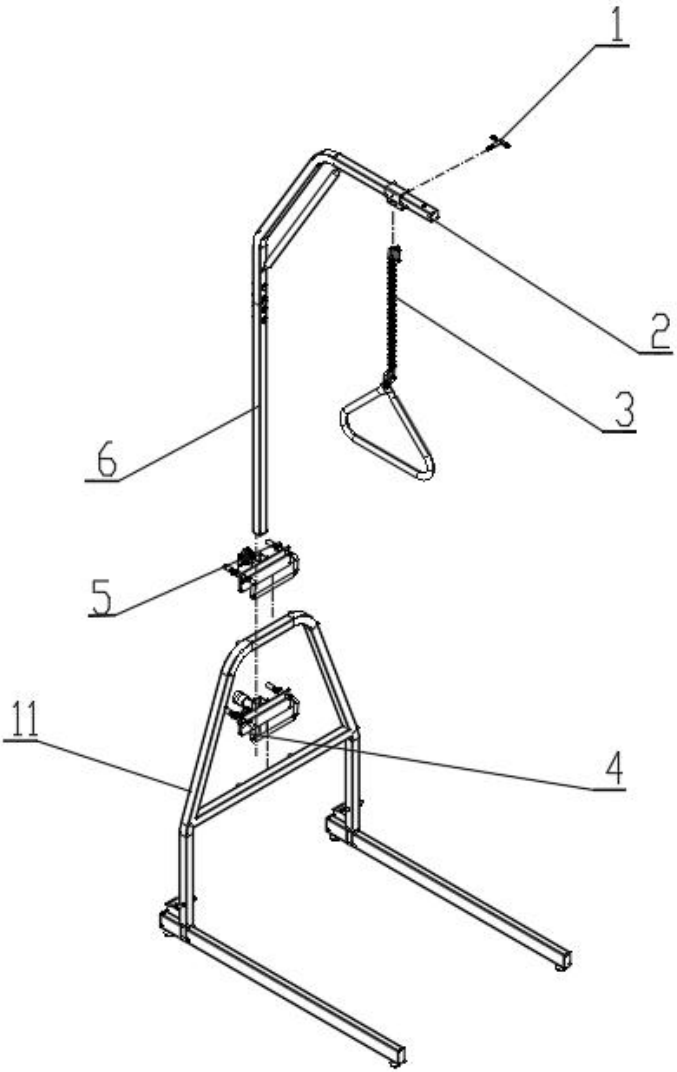
① Plaats de klemconstructie A (05) en de klemconstructie B (04) op de dwarsbuis van de trapeziumvormige bevestigingsconstructie (11) zoals weergegeven in de afbeelding;

② Plaats de ophangstandpijpconstructie (06) achtereenvolgens in de

korte pijp van klemconstructie A (05) en klemconstructie B (04) zoals weergegeven in de volgende afbeelding, en draai vervolgens de knoppen van klemconstructie A (05) en klemconstructie B (04) vast om ze op de ophangstandpijpconstructie (06) te bevestigen;


③ Plaats de hijsringconstructie (03) in de klem van de bovenste

buisconstructie (02) zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding en draai vervolgens de vergrendelingsconstructie (01) vast door de klem van de bovenste buisconstructie (02) en de hijsringconstructie (03) om de beurt.




Stap 4

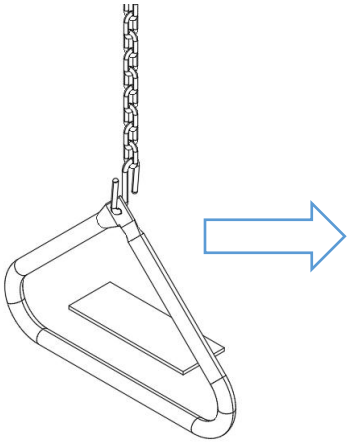Nadat de montage is voltooid, kan het EVA-pad (13) van de sticker worden afgescheurd en indien nodig op de greep van de ring worden



geplakt.

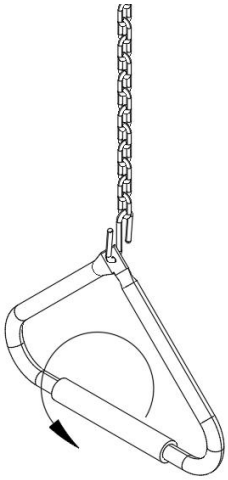

Tips :

Plaats de statiefmontage (09) onder het bed en verplaats de hele hanger in het bed. De knoppen van de klemmontage A (05) en de klemmontage B (04) kunnen worden losgedraaid om de hoogte van de hanger aan te passen door de standpijpmontage (06) omhoog en omlaag te bewegen (let op: de klemmontage A (05) moet tussen de (MIN) en (MAX) grenslijnen bewegen).

De klem van de bovenste buisconstructie (02) kan worden losgemaakt door de vergrendelingsconstructie (01) los te maken, zodat de klem van de bovenste buisconstructie (02) de buis van de bovenste buisconstructie (02) niet meer vastklemt, en vervolgens kan de klem van de bovenste buisconstructie (02) heen en weer worden bewogen, en kan de vergrendelingsconstructie (01) weer worden vastgedraaid nadat deze zich in een geschikte positie bevindt, zodat de klem van de bovenste buisconstructie (02) de bovenste buisconstructie (02) vastklemt.

OPERATING INSTRUCTIONS

Voorzorgsmaatregelen voor de bediening

- Overschrijd de aanbevolen gewichtslimiet van 250 lbs niet
- Controleer voor gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

CARE AND MAINTENANCE

Schoonmaak:

- Veeg het frame minstens één keer per week af met een zachte, droge doek.

Als de standhulp in contact komt met met vocht, droog het dan onmiddellijk.

Kennisgeving :

- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende wassoorten, bijtende chemicaliën of siliconenspray om de apparatuur schoon te maken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de apparatuur schoon te

maken. Deze kunnen krassen op de afwerking veroorzaken.

- Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om de apparatuur schoon te maken.

Onderhoud:

Om de veiligheid en het juiste gebruik te garanderen, dient u maandelijks de volgende stappen uit te voeren: Controleer alle bevestigingsmiddelen op stevigheid en slijtage. Vervang versleten of losse bevestigingsmiddelen voor gebruik. Controleer de stoelconstructies op schade of slijtage en zorg ervoor dat de bouten goed vastzitten. Vervang versleten of beschadigde componenten. Controleer of de wielen goed werken en stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde wielen.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Säng trapetsbar

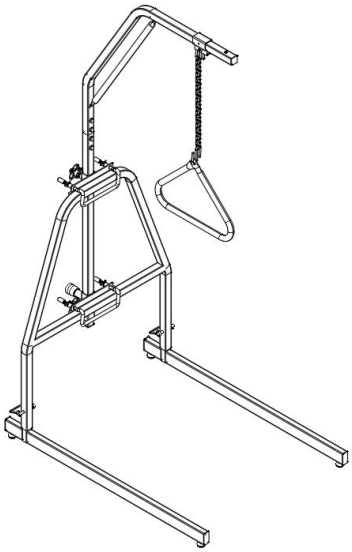
MODELL: FBL900978

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900978



Obs: Produktbilden är för referens, de faktiska detaljerna ska råda

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde detta Patient T ransfer C hår

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operation safety

Vänligen lägg den här bruksanvisningen på en plats som är lätt att kontrollera och förvara den på rätt sätt. Denna bruksanvisning visar tydligt hur man använder utrustningen på ett säkert och korrekt sätt, för att förhindra skada eller förlust av egendom som orsakas av dig och andra.

Fara

Varning

Viktkapacitet: 250 lbs. Använd aldrig stativhjälpen för patienter som överstiger denna vikt.









- Använd endast där det är tillåtet enligt alla tillämpliga lokala lagar och förordningar.
- Endast kvalificerade vårdgivare utbildade i korrekt användning av stent AIDS bör använda dem.
- Bed Trapeze Bar ska endast användas för att hjälpa patienten att sitta på sängen. Stenthjälp ska inte användas för att överföra patienter från en plats till en annan .
- Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för fraktskador. Om någon del är skadad, gör det inte använd den och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.
- Innan du använder stativhjälpen, se till att alla komponenter är korrekt och säkert monterade och att alla fästen är säkra.
- Det bakre hjulet måste låsas innan patienten sänks ner i stativet för transport.
- Undvik över dra åt monteringsbeslag eftersom detta kan orsaka skador på monteringsfästen
- Stativhjälpen kan välta om den används felaktigt. Läs och följ bruksanvisningen innan du överför någon.
- Var försiktig om du lämnar stativet i direkt solljus under en längre tid som dess yta kan bli varm.

Använd inte för transport över långa avstånd

Använd inte i syfte att sitta under långa längre perioder Använd inte denna produkt om den är skadad och använd inte tillbehör eller ersättningsdelar Regelbundet


underhåll av stativhjälp och tillbehör är nödvändigt för att säkerställa korrekt funktion.
Om du ger den här produkten till någon annan måste du inkludera denna bruksanvisning.

Part List

01.  1 st	02.  1 st	03.  1 st	04.  1 st
05.  1 st	06.  1 st	07.  4 st	08.  4 st
09.  2 st	10.  2 st	11.  1 st	12.  1 st
13 Eva Pad  1 st			

NOTERA: Vissa fästelement kommer att ha en reservdel för nödsituationer

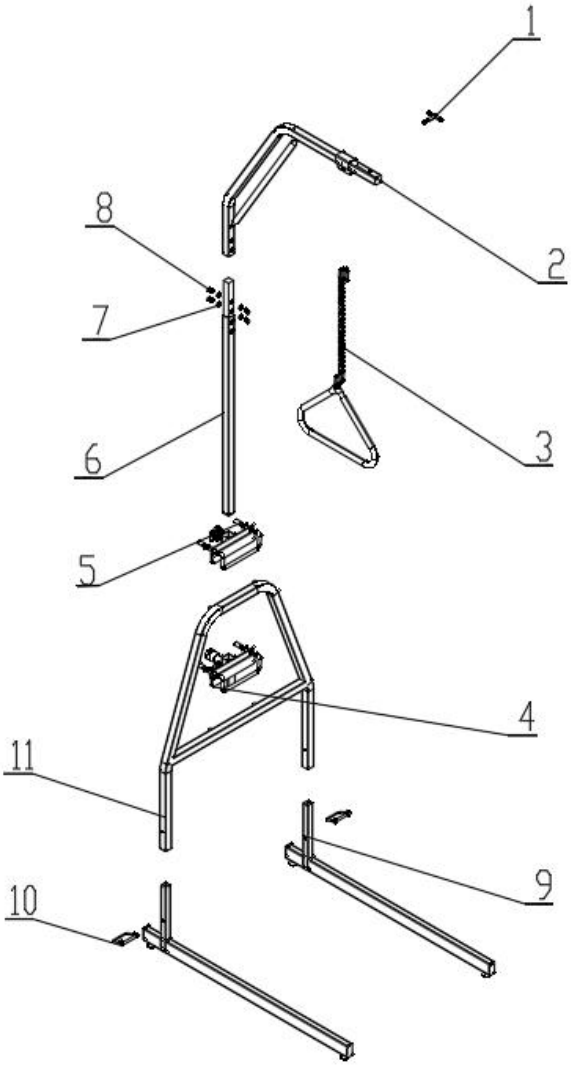
Explosion diagram



Assembly Steps


Steg 1

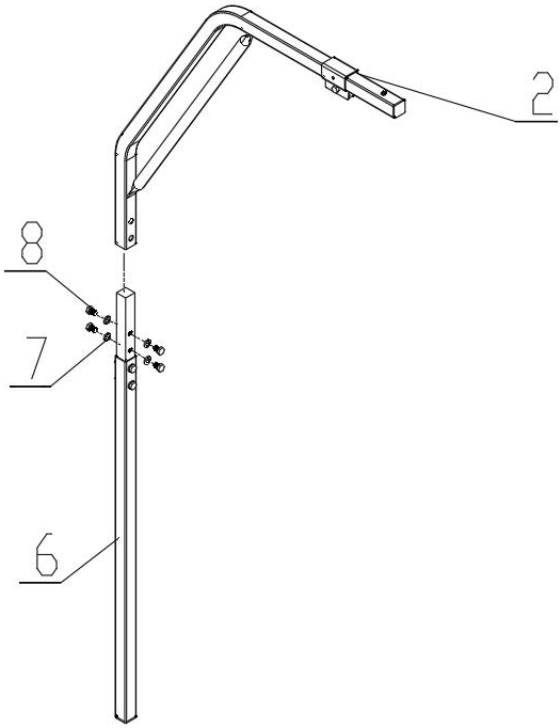Vrid de fyra yttre sexkantsskruvarna M10x16 (08) från hängarens ståndrörsenhet (06) och ta bort de fyra fjäderbrickorna (07) med den yttre sexkantnyckeln (med M10-skruvar) (12); Sätt sedan in den övre rörenheten (02) i hängarens ståndrörsenhet (06). Efter att ha placerat hålen, skruva in de fyra yttre sexkantsskruvarna M10x16 (08) i hängarens ståndrörsenhet (06) genom fjäderbrickan (07); Använd slutligen en extern insexnyckel (med M10-skruvar) (12) för att dra åt.



Steg 2

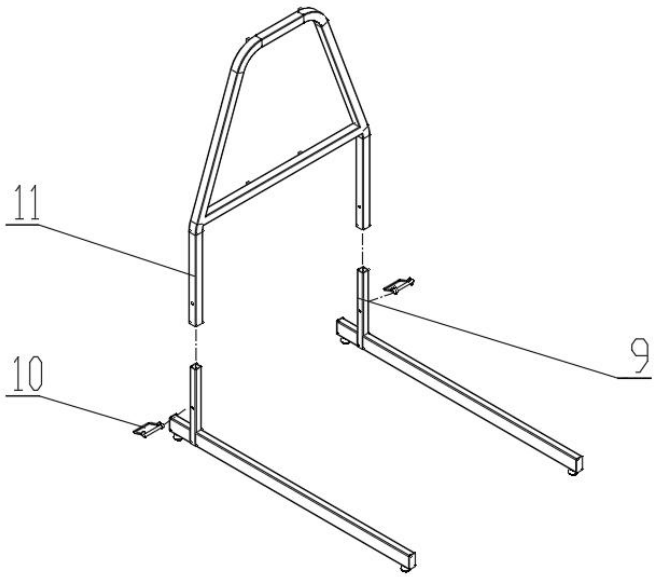Placera de två stativenheterna (09) parallellt på ett avstånd av 68,5 cm, och rikta sedan in de två fötterna på den trapetsformade fixturenheten (11) med ståndröret på de två stativenheterna (09) som visas i figuren; Slutligen, efter att hålpositionen är inriktad, lås den med kortkabelns spärr (10).



Steg 3

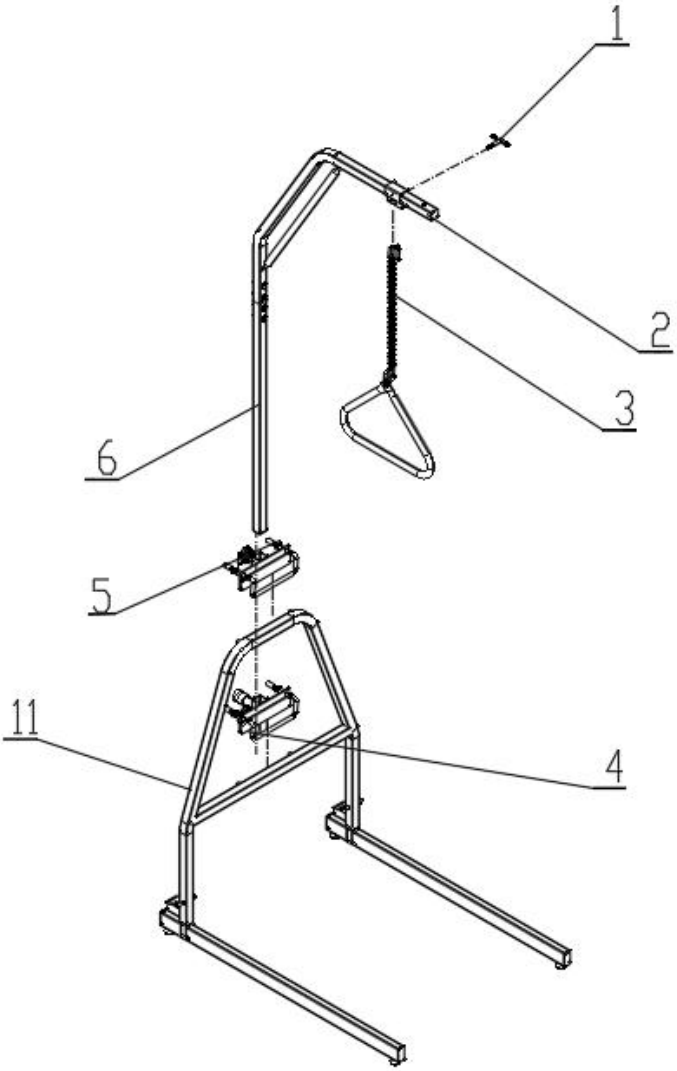
① Placera klämenheten A (05) och klämenheten B (04) på det tvärgående röret på den trapetsformade fixeringsenheten (11) som visas i figuren;

② Sätt in hängarens ställningsrörsenhet (06) i det korta röret på

klämenheten A (05) och klämenheten B (04) i tur och ordning som visas i följande figur, och dra sedan åt knopparna på klämenheten A (05) och klämenheten B (04) för att fixera dem på hängarens ställningsrör (06);


③ Placera lyftringsenheten (03) i klämman på den övre rörenheten (02)

som visas i figuren nedan, och dra sedan åt låsenheten (01) genom klämman på den övre rörenheten (02) och lyftringsenheten (03) i tur och ordning.



Steg 4

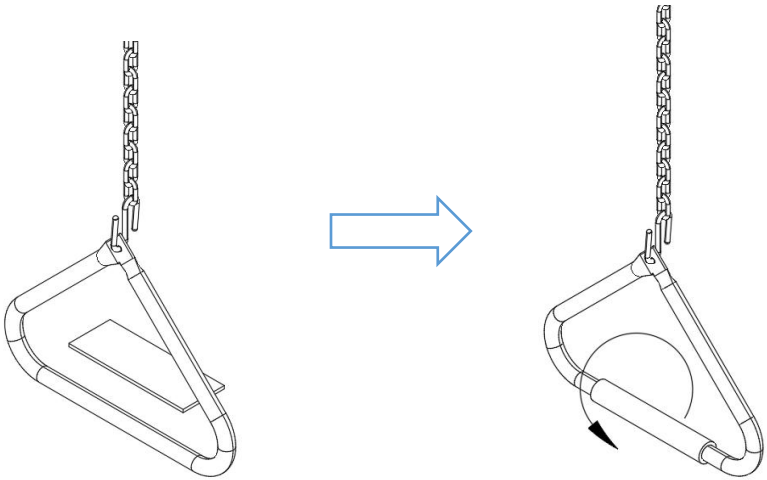Efter att monteringen är klar kan EVA-kudden (13) slitas av klistermärket och klistras på ringens grepp efter behov.



Tips:

Placera stativenheten (09) under sängen och flytta in hela hängaren i sängen. Vreden på klämenheten A (05) och klämenheten B (04) kan lossas för att justera höjden på hängaren genom att flytta ståndrörsenheten (06) upp och ner (obs: klämenheten A (05) måste flyttas mellan (MIN) och (MAX) gränslinjerna).

Klämman på den övre röranordningen (02) kan lossas genom att lossa låsanordningen (01) så att klämman på den övre röranordningen (02) inte längre klämmer fast röret på den övre röranordningen (02), och sedan kan klämman på den övre röranordningen (02) flyttas tillbaka och låsas (02) dras åt igen efter att ha varit i ett lämpligt läge så att klämman på den övre rörenheten (02) klämmer fast den övre rörenheten (02)

OPERATING INSTRUCTIONS

Försiktighetsåtgärder vid drift

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 250 lbs
- Före användning, se till att alla enheter är ordentligt åtdragna och läs noggrant igenom bruksanvisningen

CARE AND MAINTENANCE

Rengöring:

- Torka av ramen med en mjuk torr trasa minst en gång i veckan. Om stativhjälpen kommer i kontakt med fukt, torka den omedelbart.

Observera :

- Använd inte lösningsmedel, slipande vaxer, frätande kemikalier eller spraysilikon för att rengöra utrustningen.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra utrustningen, de kan repa finishen.
- Använd inte ånga eller högtryckstvätt för att rengöra utrustningen.

Underhåll:

För att säkerställa säkerhet och korrekt användning, utför följande steg varje månad: Kontrollera att alla fästelement är täta och slitna. Byt ut slitna eller lösa fästen före användning. Kontrollera sätesenheterna för skador eller slitage och se till att bultarna är åtdragna. Byt ut eventuella slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att hjulen fungerar korrekt och är säkert fastsatta. Byt ut slitna eller skadade hjul

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adress: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra de trapecio para cama

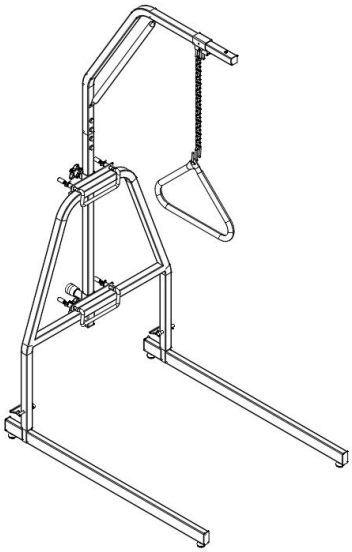
MODELO: FBL900978

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELO: FBL900978



Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esto. Paciente Transferencia C cabello

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Operation safety

Guarde este manual en un lugar fácil de consultar y guárdelo adecuadamente. Este manual de instrucciones indica claramente cómo usar el equipo de forma segura y correcta para evitar daños o pérdidas materiales, tanto para usted como para terceros.

Peligro

Advertencia

Capacidad de peso: 250 lb. Nunca utilice el dispositivo de asistencia para estar de pie con pacientes que superen este peso.

- Operar únicamente donde esté permitido de acuerdo con todas las leyes y ordenanzas locales aplicables.
- Sólo cuidadores calificados y capacitados en el uso adecuado de los stents deben utilizarlos.
- La barra trapezoidal de la cama solo debe usarse para ayudar al paciente a sentarse en la cama. La asistencia con stent no debe utilizarse para trasladar a los pacientes de un lugar a otro .
- Antes de usar el equipo, revise todas las piezas para detectar daños durante el envío. Si alguna pieza está dañada, no la retire. Úselo y comuníquese con VEVOR para obtener más instrucciones.
- Antes de utilizar el soporte de asistencia, asegúrese de que todos los componentes estén montados de forma correcta y segura. y que todos los sujetadores estén seguros.
- La rueda trasera debe bloquearse antes de bajar al paciente a la posición de soporte para su transporte.
- Evite el exceso Apretar los herrajes de montaje ya que esto puede causar daños a los soportes de montaje
- El soporte auxiliar puede volcarse si se utiliza incorrectamente. Lea y siga las instrucciones de uso. Antes de transferir a alguien.









- Tenga cuidado si deja el soporte de asistencia bajo la luz solar directa durante un período prolongado, ya que su superficie Puede calentarse.


No utilizar para fines de transporte a largas distancias.

No lo utilice con el propósito de sentarse durante períodos prolongados. No utilice este producto si está dañado y no utilice accesorios ni piezas de repuesto. El mantenimiento periódico del soporte de asistencia y de los accesorios es necesario para garantizar un funcionamiento correcto.

Si le da este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.


Part List

01.  1 pieza	02.  1 pieza	03.  1 pieza	04.  1 pieza
05.  1 pieza	06.  1 pieza	07.  4 piezas	08.  4 piezas
09.  2 piezas	10.  2 piezas	11.  1 pieza	12.  1 pieza

13 Eva Pad  1 pieza			

NOTA: Algunos sujetadores tendrán una pieza de repuesto de emergencia.

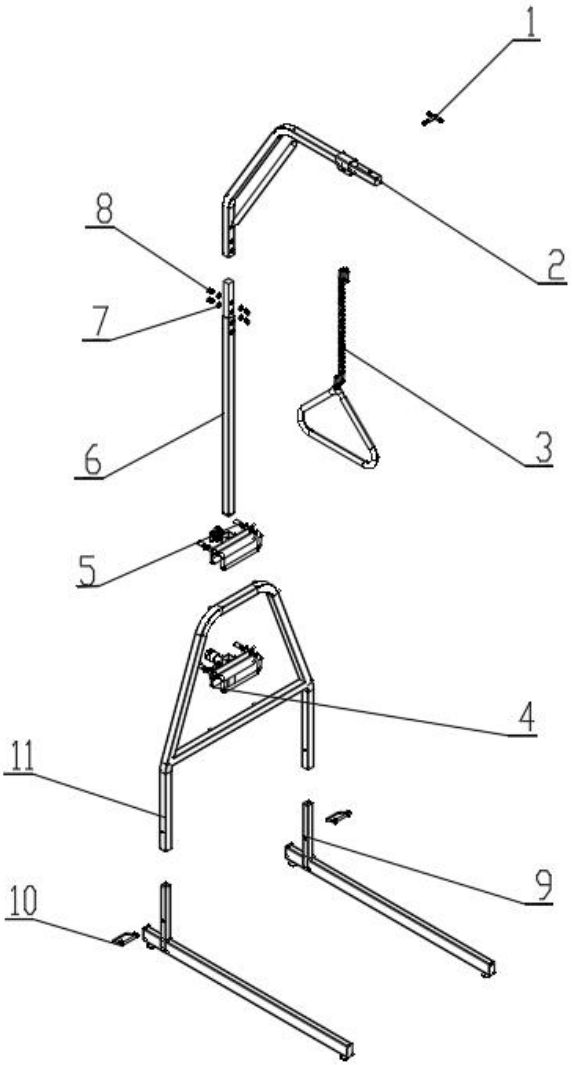
Explosion diagram



Assembly Steps

Paso 1

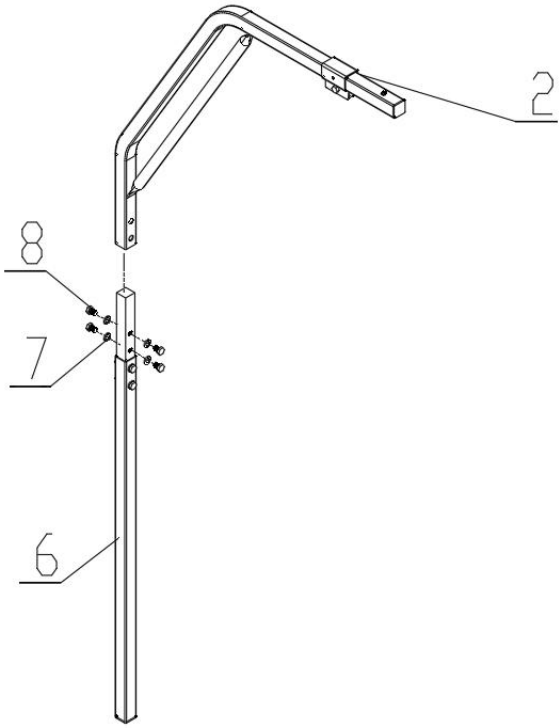
Gire los cuatro tornillos hexagonales exteriores M10x16 (08) del conjunto del tubo vertical de suspensión (06) y retire las cuatro arandelas elásticas (07) con la llave hexagonal exterior (con tornillos M10) (12). A continuación, inserte el conjunto del tubo superior (02) en el conjunto del tubo vertical de suspensión (06). Tras colocar los orificios, atornille los cuatro tornillos hexagonales exteriores M10x16 (08) en el conjunto del tubo vertical de suspensión (06) a través de las arandelas elásticas (07). Por último, utilice una llave hexagonal exterior (con tornillos M10) (12) para apretar.



Paso 2

Coloque los dos conjuntos de trípode (09) en paralelo a una distancia de

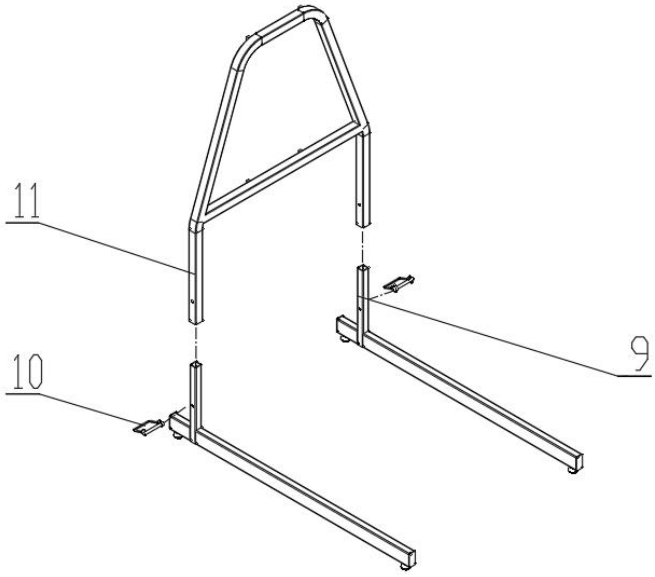68,5 cm y luego alinee los dos pies del conjunto de fijación trapezoidal (11) con el tubo vertical de los dos conjuntos de trípode (09) como se muestra en la figura; Finalmente, después de que la posición del orificio esté alineada, bloquéela con el pestillo del cable de la tarjeta (10).




Paso 3

① Coloque el conjunto de sujeción A (05) y el conjunto de sujeción B (04) en el tubo transversal del conjunto de fijación trapezoidal (11) como se muestra en la figura;

② Inserte el conjunto de tubo vertical de suspensión (06) en el tubo corto del conjunto de sujeción A (05) y el conjunto de sujeción B (04) sucesivamente como se muestra en la siguiente figura, y luego apriete las perillas del conjunto de sujeción A (05) y el conjunto de sujeción B (04) para fijarlos en el conjunto de tubo vertical de suspensión (06);


③ Coloque el conjunto de anillo de elevación (03) en la abrazadera del

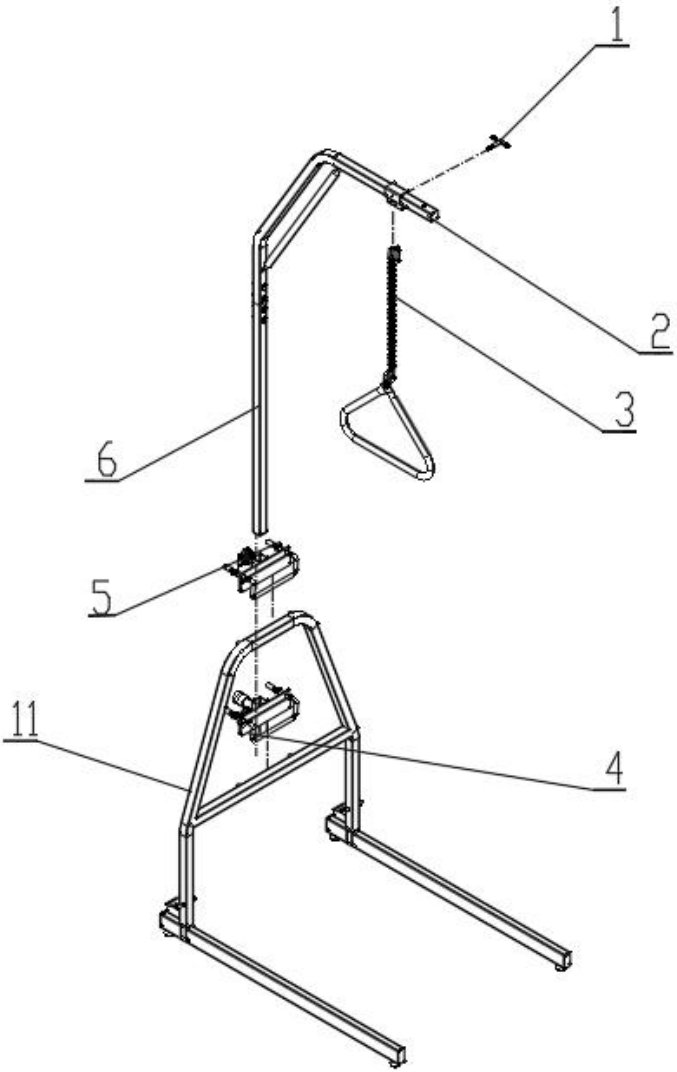conjunto del tubo superior (02) como se muestra en la figura a continuación, y luego apriete el conjunto de bloqueo (01) a través de la abrazadera del conjunto del tubo superior (02) y el conjunto de anillo de elevación (03) a su vez.




Paso 4

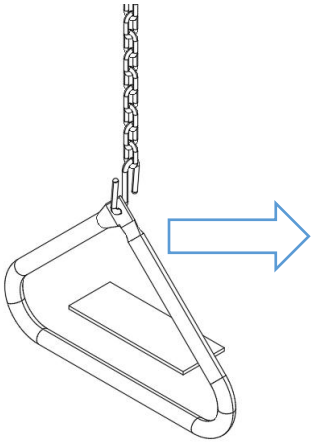Una vez finalizado el montaje, se puede retirar la almohadilla EVA (13) de la pegatina y pegarla en la empuñadura del anillo según sea



necesario.

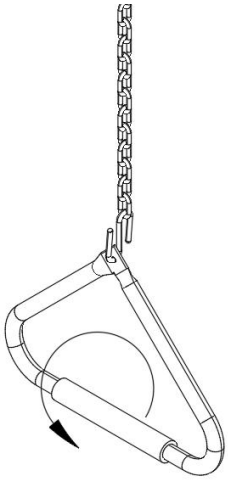

Consejos:

Coloque el trípode (09) debajo de la cama y deslice el colgador completo hacia dentro. Las perillas de los conjuntos de sujeción A (05) y B (04) se pueden aflojar para ajustar la altura del colgador moviendo el tubo vertical (06) hacia arriba y hacia abajo (nota: el conjunto de sujeción A (05) debe moverse entre las líneas de límite (MÍN) y (MÁX)).

La abrazadera del conjunto del tubo superior (02) se puede aflojar aflojando el conjunto de bloqueo (01) de modo que la abrazadera del conjunto del tubo superior (02) ya no sujete el tubo del conjunto del tubo superior (02), y luego la abrazadera del conjunto del tubo superior (02) se puede mover hacia adelante y hacia atrás, y el conjunto de bloqueo (01) se puede apretar nuevamente después de estar en una posición adecuada de modo que la abrazadera del conjunto del tubo superior (02) sujete el conjunto del tubo superior (02)

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauciones de operación

- No exceda el límite de peso recomendado de 250 libras.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los conjuntos estén bien apretados y lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza:

- Limpie el marco con un paño suave y seco al menos una vez a la semana. Si el soporte de asistencia entra en contacto Con humedad, secar inmediatamente.

Aviso :

- No utilice disolventes, ceras abrasivas, productos químicos cáusticos ni silicona en aerosol para limpiar el equipo.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el equipo, podrían rayar el acabado.

- No utilice limpiadores a vapor o de alta presión para limpiar el equipo.

Mantenimiento:

Para garantizar la seguridad y el uso adecuado, realice los siguientes pasos mensualmente: Revise todos los sujetadores para ver si están apretados y desgastados. Reemplace los sujetadores desgastados o sueltos antes de usar. Revise los conjuntos de asientos para detectar daños o desgaste, y asegúrese de que los pernos estén bien apretados. Reemplace cualquier pieza desgastada o componentes dañados.
Compruebe que las ruedas funcionen correctamente y estén bien sujetas. Reemplace las ruedas desgastadas o dañadas.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Dirección: 2F-2, 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra trapezio letto

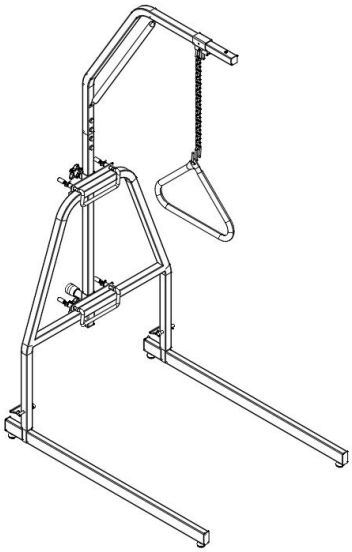
MODELLO: FBL900978

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELLO: FBL900978



Nota: l'immagine del prodotto è di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo Trasferimento del paziente C hair

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operation safety

Si prega di conservare questo manuale in un luogo facile da consultare e di conservarlo correttamente. Questo manuale di istruzioni indica chiaramente come utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro e corretto, in modo da prevenire qualsiasi danno o perdita di proprietà causata a voi e ad altri.

Pericolo









Avvertimento


Capacità di peso: 250 libbre. Non utilizzare mai l'assistenza in piedi per pazienti che superano questo peso.

- Utilizzare solo dove consentito dalle leggi e dalle ordinanze locali applicabili.
- Gli stent-AIDS devono essere utilizzati solo da personale sanitario qualificato e formato sull'uso corretto.
- La barra trapezia del letto deve essere utilizzata solo per aiutare il paziente a sedersi sul letto. L'assistenza dello stent non deve essere utilizzata per trasferire i pazienti da una posizione all'altra .
- Prima di utilizzare l'attrezzatura, controllare che tutte le parti non siano danneggiate durante la spedizione. Se una parte è danneggiata, non utilizzalo e contatta VEVOR per ulteriori istruzioni.
- Prima di utilizzare il supporto di supporto, assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente e che tutti gli elementi di fissaggio siano ben fissati.
- Prima di adagiare il paziente sul supporto per il trasporto, è necessario bloccare la rotella posteriore.
- Evitare di esagerare serraggio dell'hardware di montaggio poiché ciò potrebbe danneggiare le staffe di montaggio
- Il supporto di supporto potrebbe ribaltarsi se utilizzato in modo non corretto. Leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso prima di trasferire chiunque.
- Prestare attenzione se si lascia il supporto sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato poiché la sua superficie potrebbe diventare caldo.

Non utilizzare per il trasporto su lunghe distanze
Non utilizzare per sedersi per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato e non utilizzare accessori o parti sostitutive. Per garantirne il corretto funzionamento è necessaria una manutenzione regolare del supporto e degli accessori.
Se si cede il prodotto a qualcun altro, è necessario includere anche questo manuale d'uso.


Part List

01.  1 PZ	02.  1 PZ	03.  1 PZ	04.  1 PZ
05.  1 PZ	06.  1 PZ	07.  4 PZ	08.  4 PZ
09.  2 PZ	10.  2 PZ	11.  1 PZ	12.  1 PZ

13 Eva Pad  1 PZ			

NOTA: Alcuni elementi di fissaggio avranno un pezzo di ricambio di emergenza

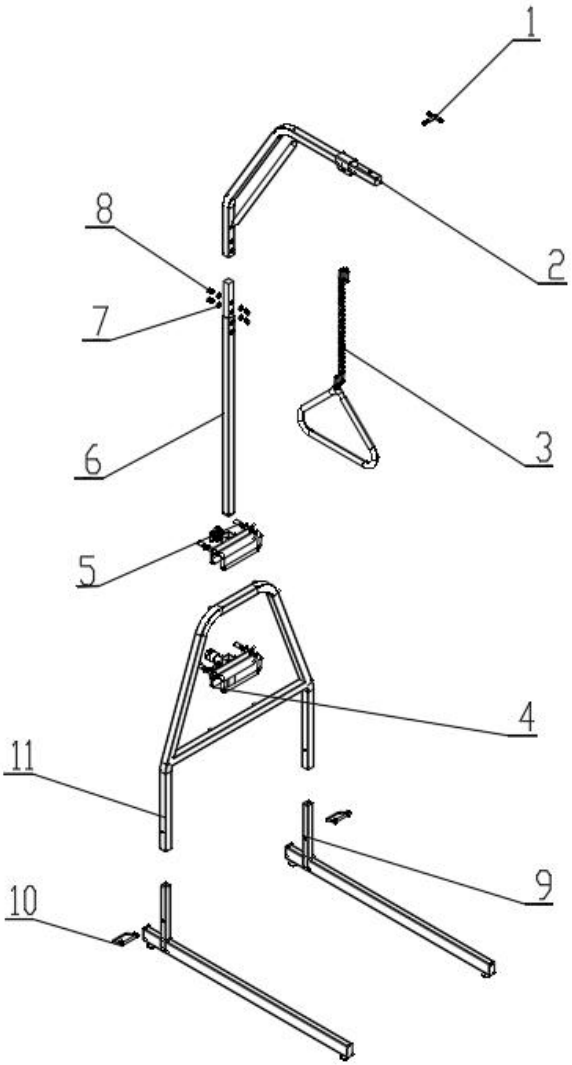
Explosion diagram



Assembly Steps

Passo 1

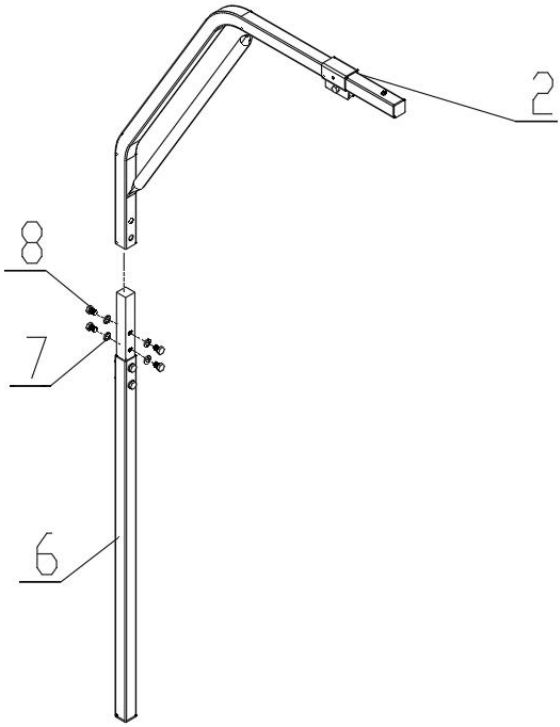
Ruotare le quattro viti esagonali esterne M10x16 (08) dal gruppo tubolare di supporto (06) e rimuovere le quattro rondelle elastiche (07) con la chiave esagonale esterna (con viti M10) (12); quindi inserire il gruppo tubo superiore (02) nel gruppo tubolare di supporto (06). Dopo aver posizionato i fori, avvitare le quattro viti esagonali esterne M10x16 (08) nel gruppo tubolare di supporto (06) attraverso la rondella elastica (07); infine, utilizzare una chiave esagonale esterna (con viti M10) (12) per serrare.



Passo 2

Posizionare i due gruppi treppiedi (09) in parallelo a una distanza di 68,5 cm, quindi allineare i due piedi del gruppo di fissaggio trapezoidale (11)

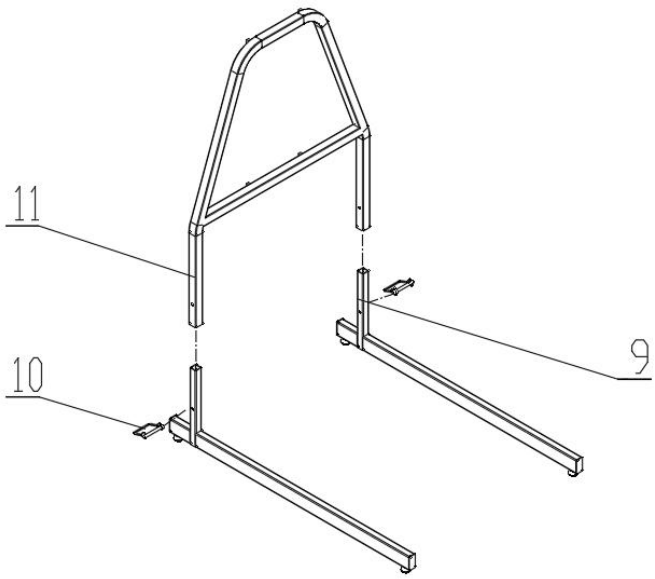con il tubo di supporto dei due gruppi treppiedi (09) come mostrato nella figura; Infine, dopo aver allineato la posizione del foro, bloccarlo con il fermo del cavo della scheda (10).




Passo 3

① Posizionare il gruppo di serraggio A (05) e il gruppo di serraggio B (04) sul tubo trasversale del gruppo di fissaggio trapezoidale (11) come mostrato in figura;

② Inserire il gruppo tubolare di supporto (06) nel tubo corto del gruppo di serraggio A (05) e del gruppo di serraggio B (04) in successione come mostrato nella figura seguente, quindi serrare le manopole del gruppo di serraggio A (05) e del gruppo di serraggio B (04) per fissarli sul gruppo tubolare di supporto (06);

③ Posizionare il gruppo anello di sollevamento (03) nel morsetto del gruppo tubo superiore (02) come mostrato nella figura sottostante, quindi

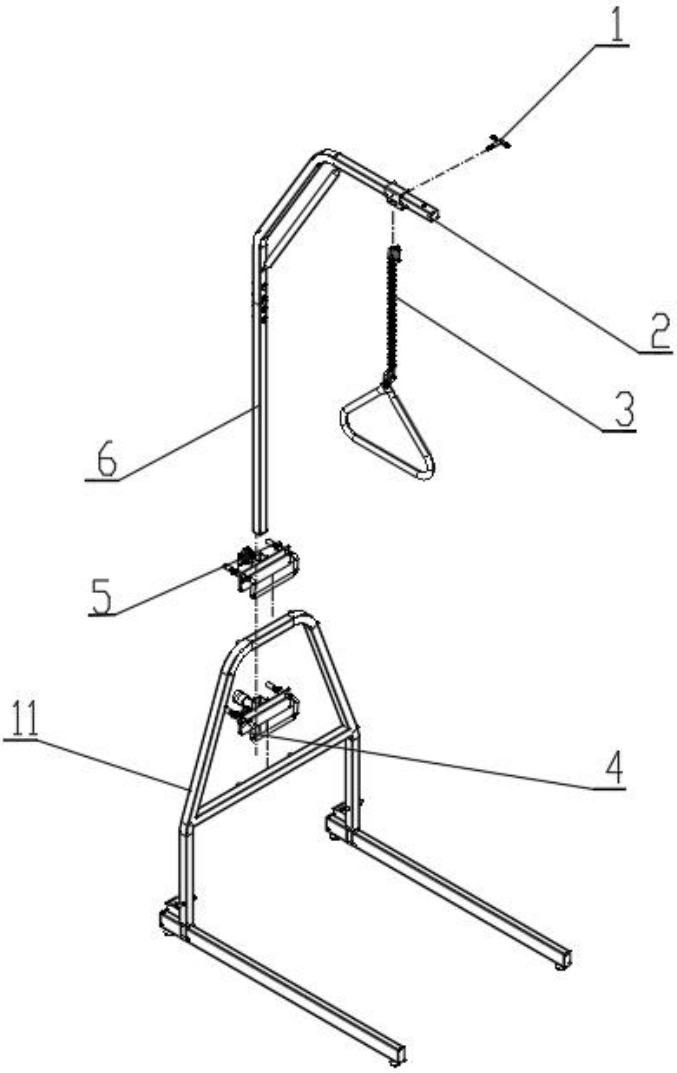
serrare il gruppo di bloccaggio (01) attraverso il morsetto del gruppo tubo superiore (02) e il gruppo anello di sollevamento (03) a turno.




Passo 4

Dopo aver completato il montaggio, il cuscinetto EVA (13) può

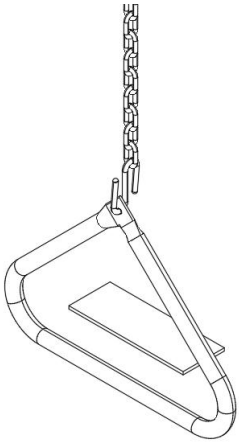essere strappato dall'adesivo e incollato sull'impugnatura dell'anello



secondo necessità.

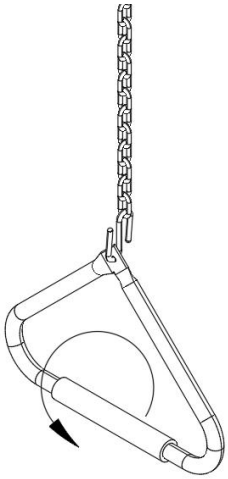

Suggerimenti:

Posizionare il gruppo treppiede (09) sotto il letto e spostare l'intero gancio

nel letto. Le manopole del gruppo di serraggio A (05) e del gruppo di serraggio B (04) possono essere allentate per regolare l'altezza del gancio spostando il gruppo tubo verticale (06) verso l'alto e verso il basso (nota: il gruppo di serraggio A (05) deve muoversi tra le linee limite (MIN) e (MAX)).

Il morsetto del gruppo tubo superiore (02) può essere allentato allentando il gruppo di bloccaggio (01) in modo che il morsetto del gruppo tubo superiore (02) non stringa più il tubo del gruppo tubo superiore (02), quindi il morsetto del gruppo tubo superiore (02) può essere spostato avanti e indietro e il gruppo di bloccaggio (01) può essere nuovamente serrato dopo essere stato in una posizione adatta in modo che il morsetto del gruppo tubo superiore (02) stringa il gruppo tubo superiore (02)

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauzioni operative

- Non superare il limite di peso consigliato di 250 libbre
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i gruppi siano ben serrati e leggere attentamente le istruzioni per l'uso

CARE AND MAINTENANCE

Pulizia:

- Pulisci il telaio con un panno morbido e asciutto almeno una volta alla settimana. Se il supporto entra in contatto con umidità, asciugarlo immediatamente.

Avviso :

- Non utilizzare solventi, cere abrasive, prodotti chimici caustici o silicone spray per pulire l'attrezzatura.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire l'attrezzatura, potrebbero graffiare la finitura.
- Non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione per pulire l'attrezzatura.

Manutenzione:

Per garantire la sicurezza e un uso corretto, eseguire mensilmente i seguenti passaggi: Controllare tutti i dispositivi di fissaggio per verificarne la tenuta e l'usura. Sostituire eventuali dispositivi di fissaggio usurati o allentati prima dell'uso. Controllare i gruppi dei sedili per eventuali danni o usura e assicurarsi che i bulloni siano serrati. Sostituire eventuali parti usurate o componenti danneggiati. Controllare che le rotelle funzionino correttamente e siano fissate saldamente. Sostituire le rotelle usurate o danneggiate

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 2F-2, 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support