VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2B



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Part	Description	Qty
a	Legs	4
b	Table top&frame	1
c	Storage shelf	1
d	Shelf support rod	2
e	Metal Screws(M8*35)	8
f	Metal Screws(M8*50)	8
g	Metal Screws(M8*90)	16
h	Black screws(Matching nut)	4
i	Washer(S:48;L8)	56
j	Hex Key/Wrench	2
k	Wrench	1
l	hanging bracket	2
m	Pipe/tube	1
n	Flat head screws(M6*40)	2
Product size:1895*700*770mm ±10mm		
FDA Registration No.: 3030681105		

This guide outlines the assembly process for your Medical Exam Table.Ensure all components and tools are ready before starting.

Tools Required

·All screws

·Hex Key/Wrench ·hanging bracket


·pipe/tube



Assembly Steps

Step 1:Prepare the Tabletop
Flip the pre-assembled tabletop over and place it on a clean,stain-free surface to avoid damage.
Step 2:Gather Hardware
Remove all screws and the wrench from the packaging.



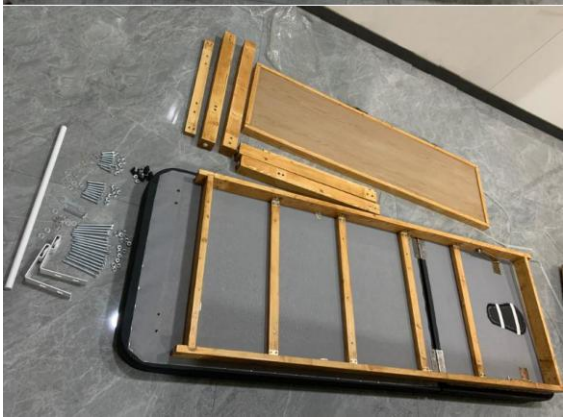

Step 3:Prepare the Legs

Take out the 4 table legs(part a).






Step 4:Install the Legs

Using the screws Install the 4 legs to the table.There is no specific order for this step.Use the 16pcs screws(M8*90)(part g), each leg use 4pcs screws.

Important:Do not fully tighten the screws at this stage to allow for adjustments during the installation of the shelf.

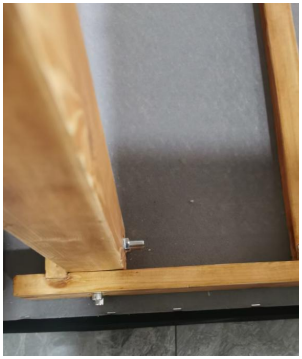

Step 5:Install the Storage Shelf(part c)

Carefully flip the table upright, prepare the Shelf support rod(part d). Install the rod to the legs, use 8pcs screws(M8*35)(part e).

Then install the storage shelf to the support rod, use 8pcs screws(M8*50)(part f).








Step 6: Install the paper roll holder

Prepare the paper roll holder(part l), tube(part m) ,screw(part n)and black screws(part h), and align the hanging bracket with the pre-drilled holes. Secure the bracket using 4 Black screws(part h).

Screws: Used to secure the bed panel and bracket. Install the pipe.

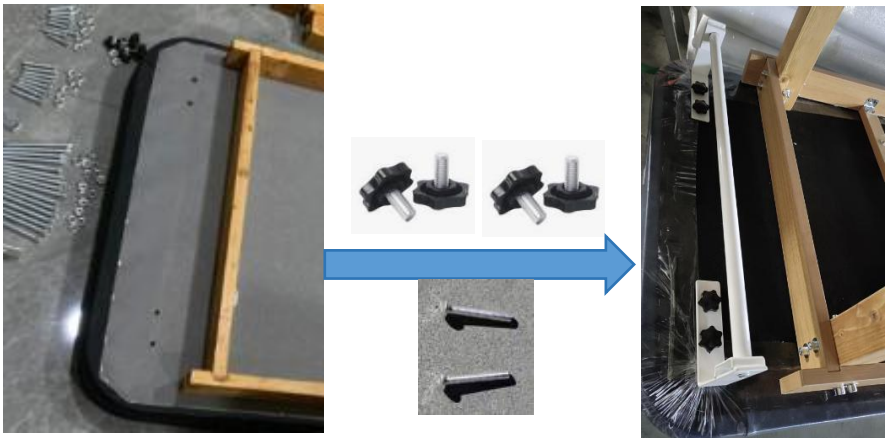

Step 7:Final Tightening

Once all screws are installed,tighten them uniformly to secure the table. Congratulations! Your Medical Exam Table is now assembled and ready for use.

Safety Precautions

Ensure the table is on a flat,stable surface.

Avoid exceeding the weight limit specified for the table.

For any questions during assembly,please contact our support team.

HOW TO USE

1. Backrest function:

Lift the backrest manually to adjust it between 0-40°.

Lift the backrest and release to lock it.

Lower the backrest: Lift it to its highest position, then slowly lower it to its lowest position.





2. Install the paper roll

Before use, you need to install the paper roll.

Before each examination or treatment for a client, it is recommended to lay down disposable paper to ensure hygiene.

Install the paper roll.

Unscrew 2 black screws to disassemble one side of the paper roll holder and remove the tube.

Place the paper roll over the tube and reinstall the paper roll holder on the bed.





Manufacturer: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Address: A1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÓŁ DO BADAŃ LEKARSKICH

MODEL:NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2 B



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE

Część	Opis	Ilość
A	Nogi	4
B	Blat i rama stołu	1
C	Półka do przechowywania	1
D	Pręt podtrzymujący półkę	2
mi	Śruby metalowe (M8*35)	8
F	Śruby metalowe (M8*50)	8
G	Śruby metalowe (M8*90)	16
H	Czarne śruby (pasująca nakrętka)	4
I	Washe r(S:48;L8)	56
J	Klucz imbusowy	2
k	Klucz	1
ja	uchwyt wiszący	2
M	Rura/rurka	1
N	Śruby z łbem płaskim (M6*40)	2
Wymiary produktu: 1895*700*770 mm ± 10 mm		
Numer rejestracyjny FDA: 3030681105		

W tym przewodniku opisano proces montażu stołu do badań lekarskich. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie elementy i narzędzia są gotowe.

Wymagane narzędzia

·Wszystkie śruby

·Klucz imbusowy/klucz płaski ·uchwyt do zawieszania
·rura/rurka




Kroki montażu

Krok 1: Przygotuj blat stołu
Obróć wstępnie zmontowany blat i połóż go na czystej, wolnej od plam

powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.

Krok 2: Zbierz sprzęt
Wyjmij wszystkie śruby i klucz z opakowania.



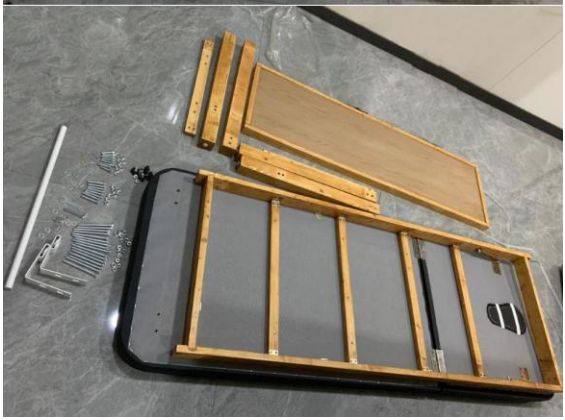


Krok 3: Przygotuj nogi

Wyjmij 4 nogi stołu (część a) .





Krok 4: Montaż nóg
Za pomocą śrub zamontuj 4 nogi do stołu. Nie ma określonej kolejności dla tego kroku. Użyj 16 szt. śruby (M8*90) (część g), do każdej nogi użyj 4 śrub .
Ważne: Na tym etapie nie dokręcaj śrub do końca, aby mieć możliwość dokonania regulacji w trakcie montażu półki.

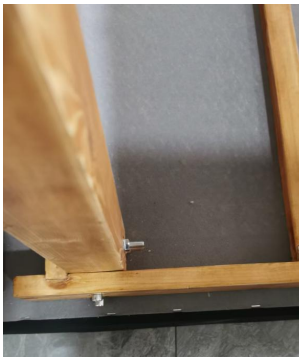

Krok 5: Montaż półki magazynowej (część c)
Ostrożnie odwróć stół do pozycji pionowej i przygotuj pręt podtrzymujący półkę (część d) . Zamontuj pręt do nóg, używając 8 szt. śruby (M8*35) (część e).
Następnie zamontuj półkę do przechowywania na pręcie podporowym, używając 8 szt. śruby (M8*50) (część f).








Krok 6: Montaż uchwytu na rolkę papieru

Przygotuj uchwyt na rolkę papieru (część l), rurkę (część m) ,śrubę (część n) i czarne śruby (część h) i wyrównaj uchwyt wiszący z wywierconymi wcześniej otworami.

Zabezpiecz uchwyt za pomocą 4 czarnych śrub (część h).

Śruby: Służą do mocowania panelu łóżka i wspornika. Zamontuj rurę .

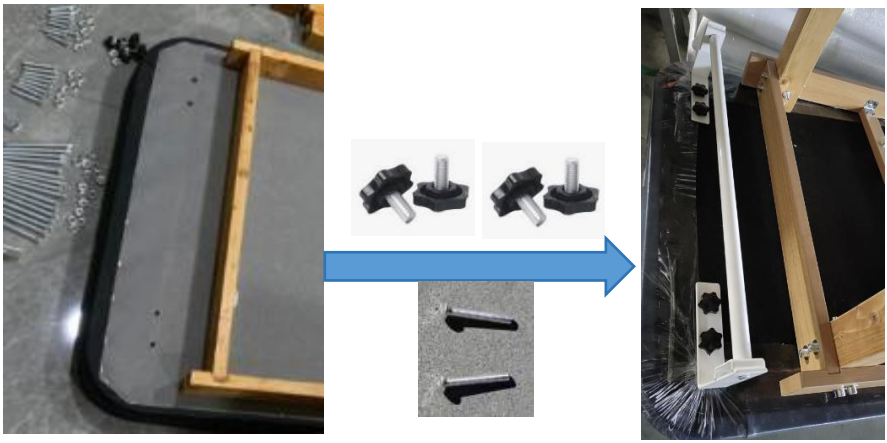

Krok 7: Dokręcanie końcowe
Po zamontowaniu wszystkich śrub należy je równomiernie dokręcić, aby zabezpieczyć stół.
Gratulacje! Twój stół do badań lekarskich jest już zmontowany i gotowy do użycia.

Środki ostrożności
Upewnij się, że stół stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Nie należy przekraczać dopuszczalnego ciężaru określonego dla stołu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące montażu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Oparcie funkcja :
Winda ten oparcie ręcznie Do regulować To między 0-40°.
Winda ten oparcie I uwolnienie Do zamek To .
Niżej ten oparcie : Podnoszone To Do jego najwyższy pozycja ,
następnie powoli niżej To Do jego najniższa pozycja .




2. Zainstaluj rolkę papieru

Przed użyciem należy założyć rolkę papieru.

Przed każdym badaniem lub zabiegiem zaleca się rozłożenie u klienta papieru jednorazowego w celu zapewnienia higieny.

Zainstaluj rolkę papieru.

Odkręć 2 czarne śruby, aby zdemontować jedną stronę uchwytu rolki papieru i wyjąć rurkę.

Umieść rolkę papieru na rurze i zamontuj uchwyt rolki papieru na łóżku.





Producent: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adres: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGSTISCH

MODELL: NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELL: NO2 B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

ANWEISUNGEN

Teil	Beschreibung	Menge
A	Beine	4
B	Tischplatte & Rahmen	1
C	Ablageboden	1
D	Regalstützstange	2
e	Metallschrauben (M8*35)	8
F	Metallschrauben (M8*50)	8
G	Metallschrauben (M8*90)	16
H	Schwarze Schrauben (passende Mutter)	4
ich	Waschen (S:48;L8)	56
J	Inbusschlüssel/Schraubenschlüssel	2
k	Schlüssel	1
l	Aufhängebügel	2
M	Rohr/Schlauch	1
N	Flachkopfschrauben (M6* 40)	2
Produktgröße: 1895 x 700 x 770 mm ± 10 mm		
FDA-Registrierungsnummer: 3030681105		

In dieser Anleitung wird der Montagevorgang für Ihren medizinischen Untersuchungstisch beschrieben. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Werkzeuge bereit sind, bevor Sie beginnen.
Erforderliche Werkzeuge
·Alle Schrauben


· Inbusschlüssel/Schraubenschlüssel · Aufhängevorrichtung ·Rohr/Schlauch



Montageschritte

Schritt 1: Bereiten Sie die Tischplatte vor
Drehen Sie die vormontierte Tischplatte um und legen Sie sie auf eine saubere, fleckenfreie Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.
Schritt 2: Hardware zusammenstellen
Entnehmen Sie alle Schrauben und den Schraubenschlüssel aus der Verpackung.



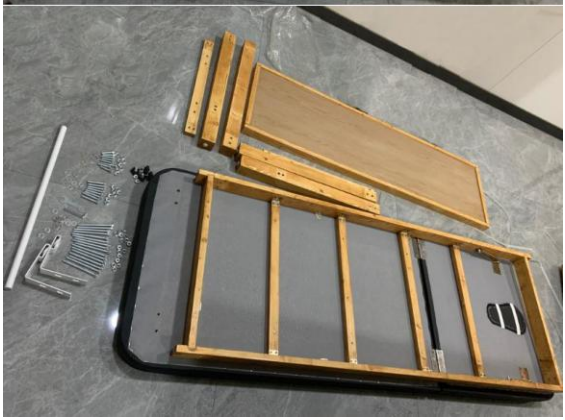


Schritt 3: Bereiten Sie die Beine vor

Nehmen Sie die 4 Tischbeine (Teil a) heraus .



Schritt 4: Installieren Sie die Beine
Montieren Sie die 4 Beine mit den Schrauben am Tisch. Für diesen Schritt gibt es keine bestimmte Reihenfolge. Verwenden Sie die 16 Stück Schrauben (M8*90) (Teil g), jedes Bein benötigt 4 Schrauben .
Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fest, um bei der Montage des Regals noch Anpassungen vornehmen zu können.

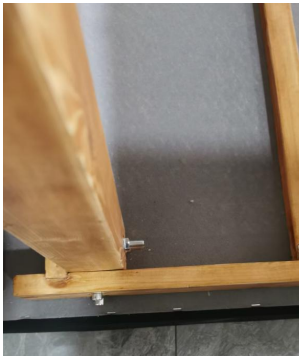


Schritt 5: Installieren Sie das Lagerregal (Teil c)
Drehen Sie den Tisch vorsichtig um und legen Sie die Regalstützstange (Teil d) bereit . Montieren Sie die Stange an den Beinen. Verwenden Sie dazu 8 Stück Schrauben (M8*35) (Teil e).
Dann installieren Sie das Lagerregal an der Stützstange, verwenden Sie 8 Stück Schrauben (M8*50) (Teil f).







Schritt 6: Papierrollenhalter montieren
Bereiten Sie den Papierrollenhalter (Teil l), das Rohr (Teil m) vor , Schraube (Teil n) und schwarze Schrauben (Teil h) und richten Sie die Aufhängehalterung an den vorgebohrten Löchern aus.
Befestigen Sie die Halterung mit 4 schwarzen Schrauben (Teil h).
Schrauben: Dienen zum Befestigen der Bettplatte und der Halterung.
Installieren Sie das Rohr .

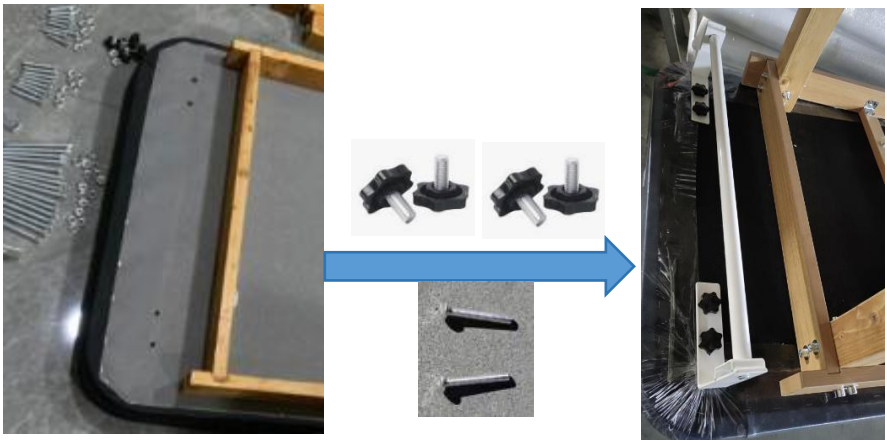

Schritt 7: Abschließendes Festziehen
Sobald alle Schrauben angebracht sind, ziehen Sie sie gleichmäßig fest, um den Tisch zu sichern.
Herzlichen Glückwunsch! Ihr Untersuchungstisch ist nun zusammengebaut und einsatzbereit.

Sicherheitsvorkehrungen
Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.
Vermeiden Sie es, die für den Tisch angegebene Gewichtsgrenze zu überschreiten.
Bei Fragen während der Montage wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

WIE MAN SIE BENUTZT

1. Rückenlehne Funktion :
Aufzug Die Rückenlehne manuell Zu anpassen Es zwischen 0-40°.
Aufzug Die Rückenlehne Und freigeben Zu sperren Es .
Untere Die Rückenlehne : Heben Es Zu es ist höchste Position , dann langsam untere Es Zu es ist unterste Position .




2. Installieren Sie die Papierrolle
Vor der Verwendung müssen Sie die Papierrolle einlegen.
Vor jeder Untersuchung oder Behandlung eines Klienten empfiehlt es sich, aus hygienischen Gründen Einwegpapier auszulegen.
Legen Sie die Papierrolle ein.
Lösen Sie 2 schwarze Schrauben, um eine Seite des Papierrollenhalters zu demontieren und das Rohr zu entfernen.
Legen Sie die Papierrolle über das Rohr und montieren Sie den Papierrollenhalter wieder auf dem Bett.





Hersteller: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
Adresse: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Bezirk Chang An, Stadt Shijiazhuang, Hebei, 050011, China
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLE D'EXAMEN MÉDICAL

MODÈLE : NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODÈLE : NO2 B



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Partie	Description	Qté
un	Jambes	4
b	Plateau et cadre de table	1
c	Étagère de rangement	1
d	Tige de support d'étagère	2
et	Vis à métaux (M8*35)	8
f	Vis à métaux (M8*50)	8
g	Vis à métaux (M8*90)	16
h	Vis noires (écrou assorti)	4
je	Rondelle (S:48;L8)	56
j	Clé hexagonale	2
k	Clé	1
l	support de suspension	2
m	Tuyau/tube	1
n	Vis à tête plate (M6*40)	2
Taille du produit : 1895*700*770mm ± 10mm		
Numéro d'enregistrement FDA : 3030681105		

Ce guide décrit le processus d’assemblage de votre table d’examen médical. Assurez-vous que tous les composants et outils sont prêts avant de commencer.

Outils requis

·Toutes les vis

·Clé hexagonale/clé ·support de suspension
·tuyau/tube




Étapes d'assemblage

Étape 1 : Préparez le plateau de table
Retournez le plateau pré-assemblé et placez-le sur une surface propre et sans taches pour éviter tout dommage.
Étape 2 : Rassembler le matériel

Retirez toutes les vis et la clé de l’ emballage.



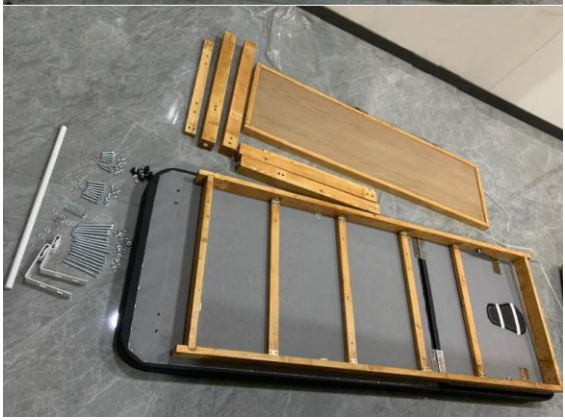


Étape 3 : Préparez les jambes

Retirez les 4 pieds de la table (partie a) .



Étape 4 : Installer les pieds
À l'aide des vis, installez les 4 pieds sur la table. Il n'y a pas d'ordre spécifique pour cette étape. Utilisez les 16 pièces vis (M8*90) (partie g), chaque pied utilise 4 vis .
Important : Ne serrez pas complètement les vis à ce stade pour permettre des ajustements lors de l'installation de l'étagère.

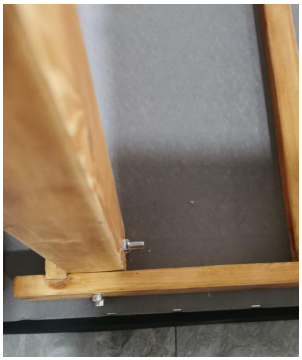

Étape 5 : Installer l'étagère de rangement (partie c)
Redressez délicatement la table et préparez la tige de support d'étagère (pièce d) . Installez la tige sur les pieds (8 pièces). vis (M8*35) (partie e). Installez ensuite l'étagère de rangement sur la tige de support, utilisez 8 pièces vis (M8*50) (pièce f).








Étape 6 : Installer le support de rouleau de papier

Préparez le support de rouleau de papier (partie l), le tube (partie m) ,vis (pièce n) et vis noires (pièce h) et alignez le support de suspension avec les trous pré-percés.

Fixez le support à l'aide de 4 vis noires (partie h).

Vis : Utilisées pour fixer le panneau du lit et le support. Installer le tuyau .

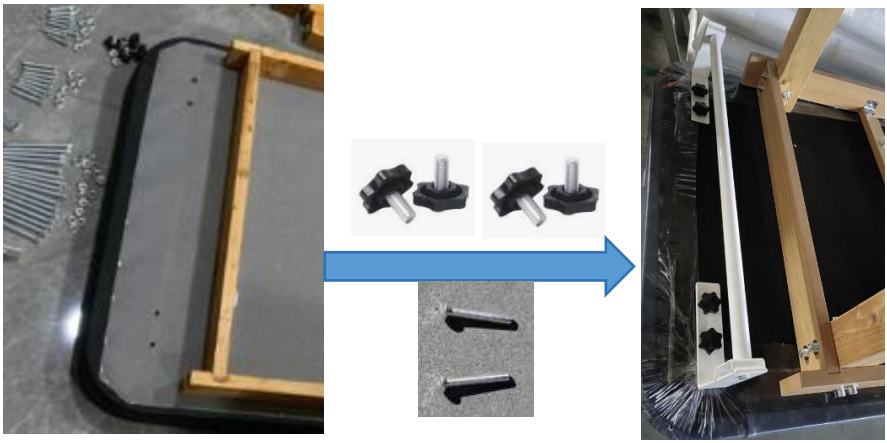

Étape 7 : Serrage final
Une fois toutes les vis installées, serrez-les uniformément pour fixer la table.
Félicitations ! Votre table d’examen médical est maintenant assemblée et prête à l’emploi.

Précautions de sécurité
Assurez-vous que la table est sur une surface plane et stable.
Évitez de dépasser la limite de poids spécifiée pour la table.
Pour toute question lors du montage, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

MODE D'EMPLOI

1. Dossier fonction :

Ascenseur le dossier manuellement à ajuster il entre 0-40°.

Ascenseur le dossier et libérer à verrouillage il .

Inférieur le dossier : relevable il à c'est le plus élevé position , alors lentement inférieur il à c'est position la plus basse .




2. Installez le rouleau de papier
Avant utilisation, vous devez installer le rouleau de papier.
Avant chaque examen ou traitement d'un client, il est recommandé de déposer du papier jetable pour assurer l'hygiène.
Installer le rouleau de papier.
Dévissez 2 vis noires pour démonter un côté du porte-rouleau de papier et retirer le tube.
Placez le rouleau de papier sur le tube et réinstallez le support de rouleau de papier sur le lit.





Fabricant : Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adresse: A 1-2703 Shidai Building, rue Guang An, district de Chang An, ville de Shijiazhuang, Hebei, 050011, Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDISCHE ONDERZOEKSTABEL

MODEL: NO2B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL: NO2B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTRUCTIES

Deel	Beschrijving	Aantal
A	Benen	4
B	Tafelblad en frame	1
C	Opbergplank	1
D	Planksteunstang	2
en	Metalen schroeven (M8*35)	8
F	Metalen schroeven (M8*50)	8
G	Metalen schroeven (M8*90)	16
H	Zwarte schroeven (passende moer)	4
i	Wasmachine (S:48;L8)	56
J	Inbussleutel	2
k	Moersleutel	1
ik	ophangbeugel	2
M	Pijp/buis	1
N	Platkopschroeven (M6* 40)	2
Productafmetingen: 1895*700*770mm ± 10mm		
FDA-registratienummer: 3030681105		

In deze handleiding wordt het montageproces voor uw medische onderzoekstafel beschreven. Zorg ervoor dat alle onderdelen en gereedschappen klaar liggen voordat u begint.

Benodigde gereedschappen

·Alle schroeven


·Inbussleutel/sleutel ·Ophangbeugel
·pijp/buis



Montagestappen

Stap 1: Bereid het tafelblad voor
Draai het voorgemonteerde tafelblad om en leg het op een schoon, vlekvrij oppervlak om beschadigingen te voorkomen.
Stap 2: Hardware verzamelen
Haal alle schroeven en de sleutel uit de verpakking.



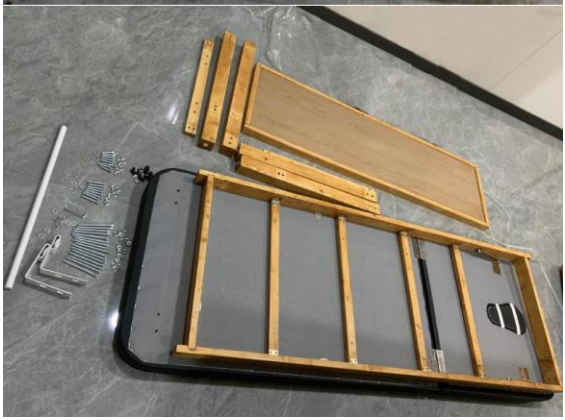


Stap 3: Bereid de benen voor

Verwijder de 4 tafelpoten (deel a) .





Stap 4: De poten installeren
Gebruik de schroeven om de 4 poten aan de tafel te bevestigen. Er is geen specifieke volgorde voor deze stap. Gebruik de 16 stuks schroeven (M8*90)(onderdeel g), per poot 4 schroeven gebruiken .
Belangrijk: Draai de schroeven in dit stadium nog niet helemaal vast, zodat u tijdens de installatie van de plank nog aanpassingen kunt doen.

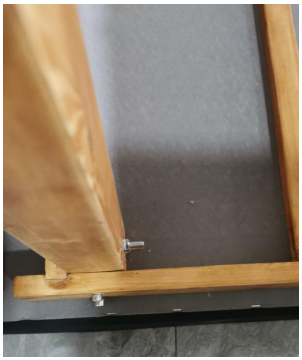

Stap 5: Installeer de opbergplank (onderdeel c)
Zet de tafel voorzichtig rechtop en bereid de planksteunstang (onderdeel d) voor . Bevestig de stang aan de poten, gebruik 8 stuks. schroeven (M8*35) (onderdeel e).
Installeer vervolgens de opbergplank op de steunstang, gebruik 8 stuks schroeven (M8*50) (onderdeel f).








Stap 6: De papierrolhouder installeren

Maak de papierrolhouder (onderdeel l), buis (onderdeel m) klaar ,schroef (onderdeel n) en zwarte schroeven (onderdeel h) , en lijn de ophangbeugel uit met de voorgeboorde gaten.

Bevestig de beugel met 4 zwarte schroeven (onderdeel h).

Schroeven: worden gebruikt om het bedpaneel en de beugel vast te zetten.

Installeer de pijp .

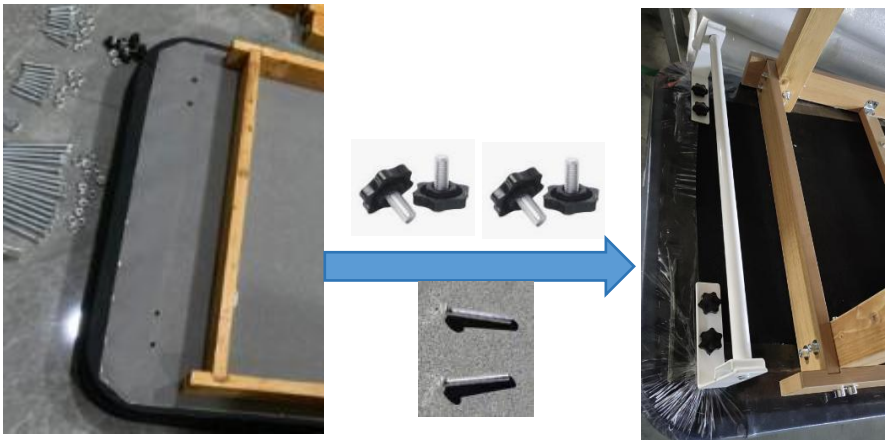

Stap 7: Laatste keer vastdraaien
Zodra alle schroeven zijn gemonteerd, draait u ze gelijkmatig vast om de tafel vast te zetten.
Gefeliciteerd! Uw medische onderzoekstafel is nu gemonteerd en klaar voor gebruik.

Veiligheidsmaatregelen
Zorg ervoor dat de tafel op een vlakke, stabiele ondergrond staat.
Zorg ervoor dat u het in de tabel aangegeven gewichtslimiet niet overschrijdt.
Als u tijdens de montage vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons supportteam.

HOE TE GEBRUIKEN

1. Rugleuning functie :
Tillen de rugleuning handmatig naar aanpassen Het tussen 0-40°.
Tillen de rugleuning En uitgave naar slot Het .
Lager de rugleuning : Lift Het naar zijn hoogste positie , dan langzaam lager Het naar zijn laagste positie .




2. Plaats de papierrol
Voor gebruik dient u de papierrol te installeren.
Voor elk onderzoek of elke behandeling van een cliënt wordt aangeraden om wegwerppapier neer te leggen om de hygiëne te waarborgen.
Plaats de papierrol.
Draai de 2 zwarte schroeven los om één kant van de papierrolhouder te demonteren en verwijder de buis.
Plaats de papierrol over de buis en plaats de papierrolhouder terug op het bed.





Fabrikant: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adres: A 1-2703 Shidai-gebouw, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, China
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICINSK UNDERSÖKNINGSTABELL

MODELL: NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELL: NO2 B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUKTIONER

Del	Beskrivning	Antal
en	Ben	4
b	Bordsskiva och stomme	1
c	Förvaringshylla	1
d	Hyllstödstång	2
e	Metallskruvar (M8*35)	8
f	Metallskruvar (M8*50)	8
g	Metallskruvar (M8*90)	16
h	Svarta skruvar (matchande mutter)	4
jag	Tvätta r(S:48;L8)	56
j	Sexkantsnyckel/skiftnyckel	2
k	Rycka	1
jag	upphängningsfäste	2
m	Rör/slang	1
n	Skruvar med platt huvud (M6*40)	2
Produktstorlek: 1895 * 700 * 770 mm ± 10 mm		
FDA-registreringsnummer: 3030681105		

Den här guiden beskriver monteringsprocessen för ditt medicinska undersökningsbord. Se till att alla komponenter och verktyg är redo innan du börjar.

Verktyg som krävs

· Alla skruvar


·Insexnyckel/skiftnyckel ·hängande fäste
·rör/slang



Monteringssteg

Steg 1: Förbered bordsskivan
Vänd den förmonterade bordsskivan och placera den på en ren, fläckfri yta för att undvika skador.
Steg 2: Samla ihop hårdvara
Ta ut alla skruvar och nyckeln ur förpackningen.



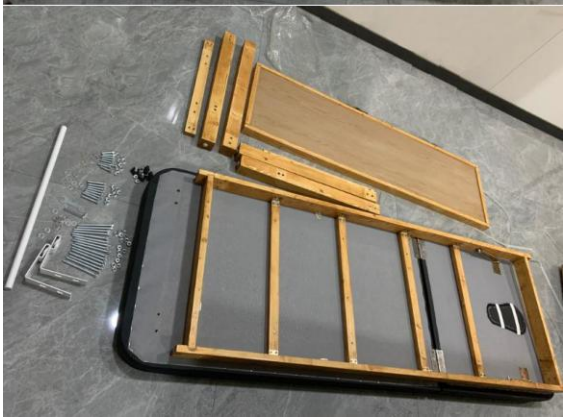


Steg 3: Förbered benen

Ta ut de 4 bordsbenen (del a) .



Steg 4: Montera benen
Använd skruvarna Montera de fyra benen på bordet. Det finns ingen specifik ordning för detta steg. Använd de 16 delarna skruvar (M8*90) (del g), varje ben använder 4 st skruvar .
Viktigt: Dra inte åt skruvarna helt i detta skede för att möjliggöra justeringar under installationen av hyllan.

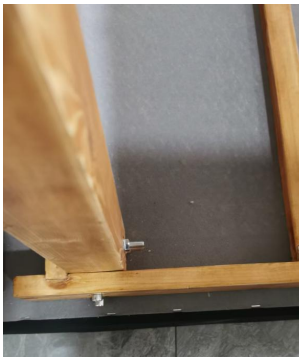

Steg 5: Montera förvaringshyllan (del c)
Vänd försiktigt bordet upprätt och förbered hyllstödsstången (del d) .
Montera stången på benen, använd 8 st. skruvar (M8*35) (del e).
Montera sedan förvaringshyllan på stödstången, använd 8 st. skruvar (M8*50) (del f).








Steg 6: Montera pappersrullhållaren

Förbered pappersrullhållaren (del l), röret (del m) ,skruven (del n) och de svarta skruvarna (del h) och justera upphängningsfästet med de förborrade hålen.

Fäst fästet med fyra svarta skruvar (del h).

Skruvar: Används för att fästa sängpanelen och fästet. Montera röret .

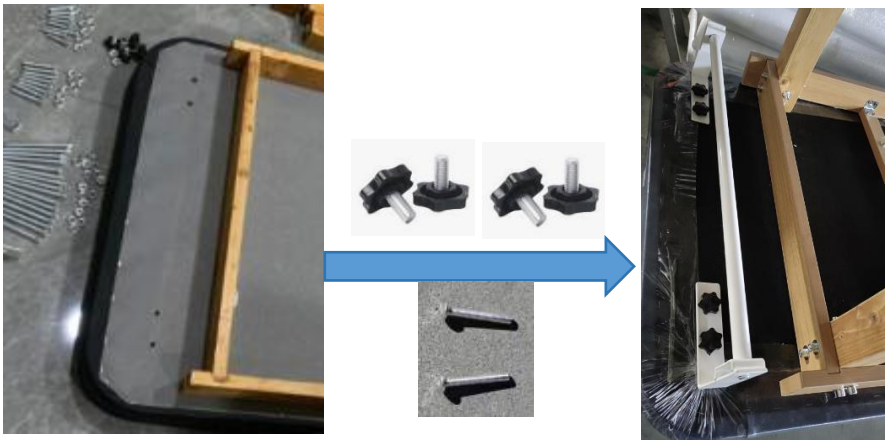

Steg 7: Slutlig åtdragning
När alla skruvar är monterade, dra åt dem jämnt för att fästa bordet.
Grattis! Ditt undersökningsbord är nu monterat och klart att användas.

Säkerhetsåtgärder
Se till att bordet står på en plan och stabil yta.
Undvik att överskrida den angivna viktgränsen för bordet.
Vid eventuella frågor under monteringen, vänligen kontakta vårt supportteam.

HUR MAN ANVÄNDER

1. Ryggstöd funktion :

Lyfta de ryggstöd manuellt till justera det mellan 0–40°.

Lyfta de ryggstöd och släppa till låsa det .

Lägre de ryggstöd : Lyft det till dess högsta position , sedan långsamt lägre det till dess lägsta positionen .




2. Montera pappersrullen

Innan användning måste du installera pappersrullen.

Före varje undersökning eller behandling av en klient rekommenderas det att lägga ut engångspapper för att säkerställa hygienen.

Montera pappersrullen.

Skruva loss de två svarta skruvarna för att demontera ena sidan av pappersrullhållaren och ta bort röret.

Placera pappersrullen över röret och sätt tillbaka pappersrullhållaren på bädden.





Tillverkare: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
Adress: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MESA DE EXAMEN MÉDICO

MODELO: NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELO: NO2 B



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES

Parte	Descripción	Cantidad
a	Piernas	4
b	Tablero y marco de mesa	1
do	Estante de almacenamiento	1
d	Varilla de soporte de estante	2
mi	Tornillos metálicos (M8*35)	8
F	Tornillos metálicos (M8*50)	8
gramo	Tornillos metálicos (M8*90)	16
h	Tornillos negros (tuerca a juego)	4
i	Arandela r(S:48;L8)	56
yo	Llave hexagonal	2
k	Llave inglesa	1
yo	soporte para colgar	2
metro	Tubo/tubería	1
norte	Tornillos de cabeza plana (M6*40)	2
Tamaño del producto: 1895 x 700 x 770 mm ± 10 mm		
Número de registro de la FDA: 3030681105		

Esta guía describe el proceso de ensamblaje de su mesa de examen médico. Asegúrese de que todos los componentes y herramientas estén listos antes de comenzar.

Herramientas necesarias

·Todos los tornillos


·Llave hexagonal/llave inglesa ·soporte para colgar
·tubo/tubería



Pasos de montaje

Paso 1: Prepare la mesa
Dale la vuelta al tablero premontado y colócalo sobre una superficie limpia y sin manchas para evitar que se dañe.
Paso 2: Reúna el hardware
Retire todos los tornillos y la llave del embalaje.



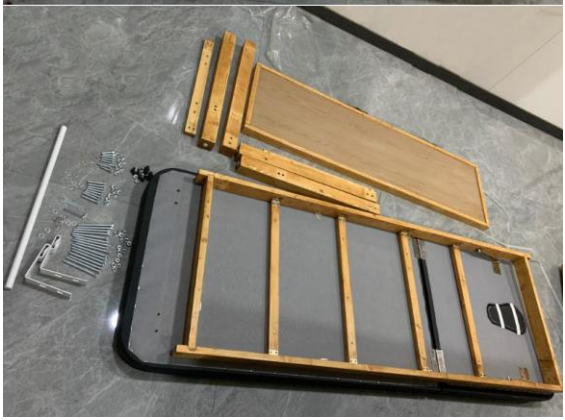


Paso 3: Preparar las piernas

Saque las 4 patas de la mesa (parte a) .





Paso 4: Instale las patas
Uso de los tornillos Instale las 4 patas a la mesa. No hay un orden específico para este paso. Utilice las 16 piezas Tornillos (M8*90) (parte g), cada pata utiliza 4 tornillos .
Importante: No apriete completamente los tornillos en esta etapa para permitir ajustes durante la instalación del estante.

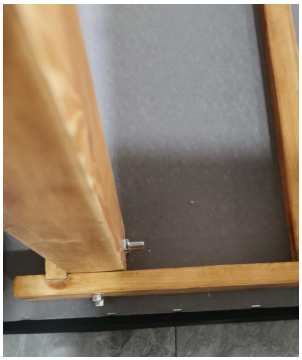

Paso 5: Instale el estante de almacenamiento (parte c)
Coloque la mesa con cuidado en posición vertical y prepare la varilla de soporte del estante (pieza d) . Instale la varilla en las patas (8 piezas). tornillos (M8*35) (parte e).
Luego instale el estante de almacenamiento en la varilla de soporte, use 8 piezas tornillos (M8*50) (parte f).








Paso 6: Instale el soporte del rollo de papel

Prepare el soporte del rollo de papel (parte l), el tubo (parte m) ,tornillo (parte n) y tornillos negros (parte h) , y alinee el soporte colgante con los orificios pretaladrados.

Asegure el soporte con 4 tornillos negros (parte h).

Tornillos: Se utilizan para fijar el panel de la cama y el soporte. Instale el tubo .

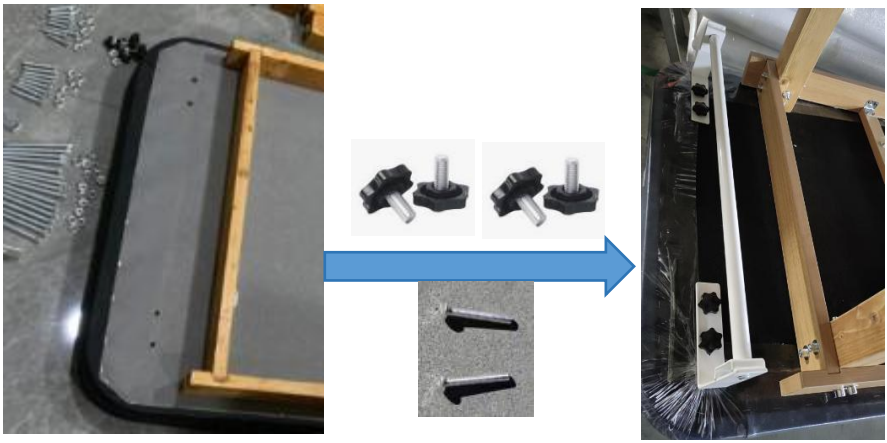

Paso 7: Apriete final
Una vez instalados todos los tornillos, apriételos uniformemente para asegurar la mesa.
¡Felicitaciones! Su mesa de reconocimiento médico ya está ensamblada y lista para usar.

Precauciones de seguridad
Asegúrese de que la mesa esté sobre una superficie plana y estable.
Evite exceder el límite de peso especificado para la mesa.
Para cualquier pregunta durante el montaje, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

MODO DE EMPLEO

1. Respaldo función :

Elevar el respaldo a mano a ajustar él entre 0-40°.

Elevar el respaldo y liberar a cerrar él .

Más bajo el respaldo : Elevador él a es más alto posición , entonces despacio más bajo él a es posición más baja




2. Instale el rollo de papel

Antes de usar, es necesario instalar el rollo de papel.

Antes de cada examen o tratamiento a un cliente, se recomienda colocar papel desechable para garantizar la higiene.

Instalar el rollo de papel.

Desatornille los 2 tornillos negros para desmontar un lado del soporte del rollo de papel y retire el tubo.

Coloque el rollo de papel sobre el tubo y vuelva a instalar el soporte del rollo de papel en la cama.





Fabricante: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
DIRECCIÓN: A 1-2703 Edificio Shidai, Calle Guang An, Distrito de Chang An, Ciudad de Shijiazhuang, Hebei, 050011, China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLO PER VISITA MEDICA

MODELLO:NO2 B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELLO:NO2 B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI

Parte	Descrizione	Quantità
UN	Gambe	4
B	Piano del tavolo e struttura	1
C	Scaffale portaoggetti	1
D	Asta di supporto per mensola	2
e	Viti metalliche (M8*35)	8
F	Viti metalliche (M8*50)	8
G	Viti metalliche (M8*90)	16
H	Viti nere (dado abbinato)	4
io	Lavatrice (S:48;L8)	56
J	Chiave esagonale/chiave inglese	2
k	Chiave	1
l	staffa di sospensione	2
M	Tubo/tubo	1
N	Viti a testa piatta (M6*40)	2
Dimensioni del prodotto: 1895*700*770mm ± 10mm		
Numero di registrazione FDA: 3030681105		

Questa guida descrive il processo di assemblaggio del tuo lettino per visite mediche. Assicurati che tutti i componenti e gli strumenti siano pronti prima di iniziare.

Strumenti necessari

·Tutte le viti


·Chiave esagonale/chiave inglese ·staffa di sospensione
·tubo/tubo



Fasi di assemblaggio

Fase 1: preparare il piano del tavolo
Capovolgere il piano del tavolo preassemblato e posizionarlo su una superficie pulita e priva di macchie per evitare danni.
Fase 2: raccogliere l'hardware
Rimuovere tutte le viti e la chiave inglese dalla confezione.



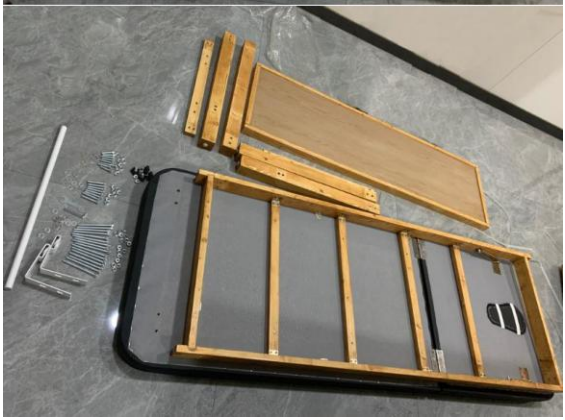


Fase 3: Preparare le gambe

Togliere le 4 gambe del tavolo (parte a) .





Fase 4: Installare le gambe
Utilizzando le viti, installare le 4 gambe sul tavolo. Non esiste un ordine specifico per questo passaggio. Utilizzare le 16 viti viti (M8*90) (parte g), ogni gamba utilizza 4 viti .
Importante: non serrare completamente le viti in questa fase per consentire eventuali regolazioni durante l'installazione della mensola.

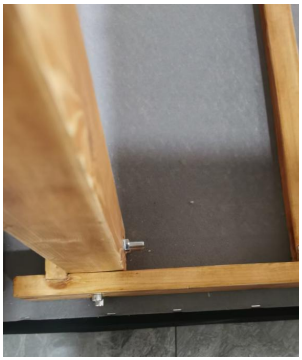

Fase 5: Installare il ripiano portaoggetti (parte c)
Capovolgere con cautela il tavolo in posizione verticale, preparare l'asta di supporto del ripiano (parte d) . Installare l'asta sulle gambe, utilizzare 8 pezzi viti (M8*35) (parte e).
Quindi installare il ripiano portaoggetti sull'asta di supporto, utilizzare 8 pezzi viti (M8*50) (parte f).








Fase 6: Installare il portarotolo di carta

Preparare il portarotolo di carta (parte l), il tubo (parte m) , avvitare (parte n) e viti nere (parte h) e allineare la staffa di sospensione con i fori preforati. Fissare la staffa utilizzando 4 viti nere (parte h).

Viti: utilizzate per fissare il pannello del letto e la staffa. Installare il tubo .

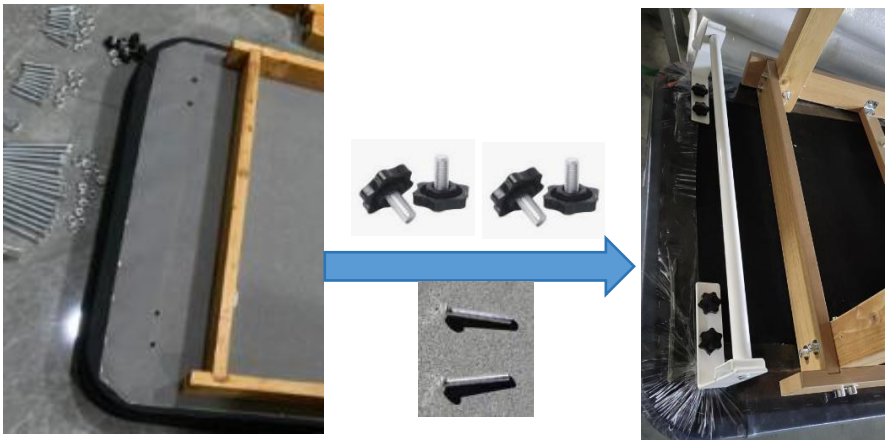

Fase 7: Serraggio finale
Una volta installate tutte le viti, serrarle uniformemente per fissare il tavolo. Congratulazioni! Il tuo lettino per visita medica è ora assemblato e pronto per l'uso.

Precauzioni di sicurezza
Assicurarsi che il tavolo sia posizionato su una superficie piana e stabile.
Evitare di superare il limite di peso specificato per il tavolo.
Per qualsiasi domanda durante il montaggio, contatta il nostro team di supporto.

COME USARE

1. Schienale funzione :

Sollevare IL schienale manualmente A regolare Esso fra 0-40°.

Sollevare IL schienale E pubblicazione A serratura Esso .

Inferiore IL schienale : Sollevamento Esso A suo più alto posizione , quindi lentamente inferiore Esso A suo posizione più bassa .




2. Installare il rotolo di carta

Prima dell'uso è necessario installare il rotolo di carta.

Prima di ogni visita o trattamento per un cliente, si raccomanda di stendere della carta monouso per garantire l'igiene.

Installare il rotolo di carta.

Svitare 2 viti nere per smontare un lato del portarotolo di carta e rimuovere il tubo.

Posizionare il rotolo di carta sul tubo e reinstallare il portarotolo sul letto.





Produttore: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Indirizzo: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Distretto di Chang An, Città di Shijiazhuang, Hebei, 050011, Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

