VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLOOD DRAWING CHAIR


MODEL: HS10

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


BLOOD DRAWING CHAIR

MODEL: HS10

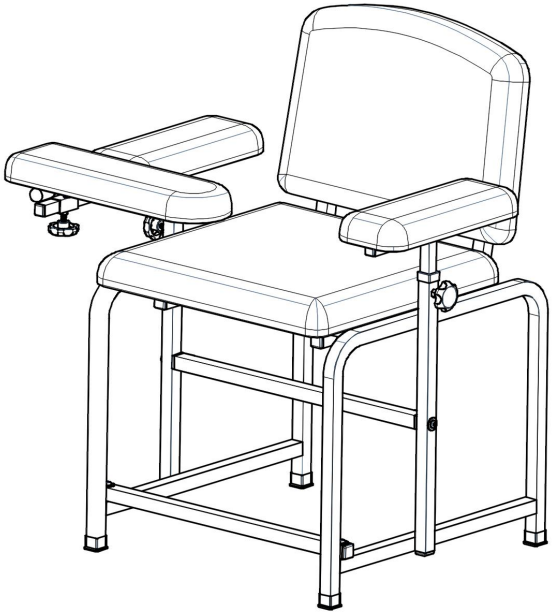

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PART LIST




a:Left and right brackets



b:Armrest connecting pipe 2



c: Armrest connecting pipe 1



d:Seat cushion component




e:Backrest component



f:Right armrest



g:Left armrest



h: Reverse turning bed

Figure 1

HARDWARE LIST

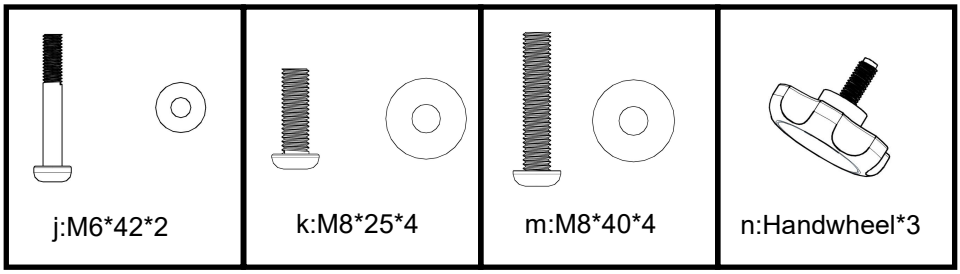


Figure 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note:When assembling the chair, do not over-tighten the screws. Finish the whole assembly and then tighten firmly.

Step 1:

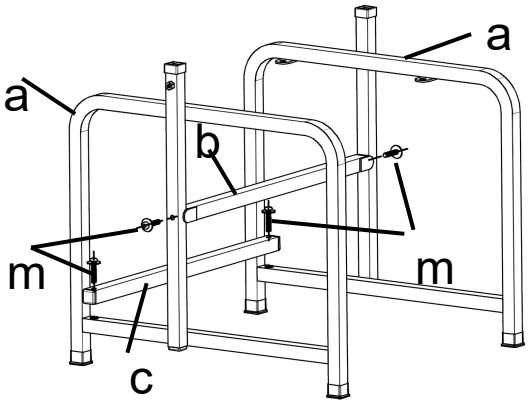


Figure 3

Secure armrest connecting pipe 1 and armrest connecting pipe 2 to leftand right brackets (Figure 3)

a: left and right brackets *2

b: Armrestconnecting pipe 2

c: Armrestconnecting pipe 1

Step 2:

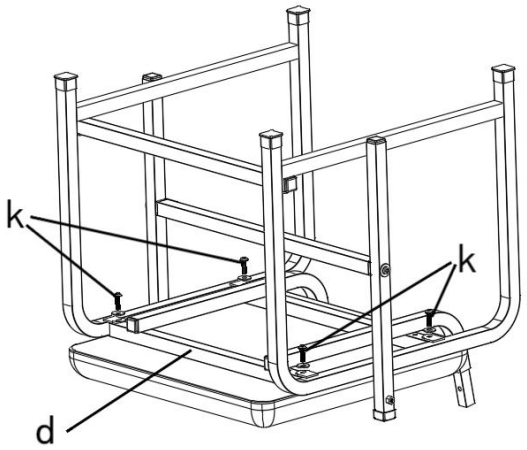


Figure 4

Connect Seat cushion component to the vehicle frame (Figure 4)

d: Seat cushion component k: M8*25*4

Step 3:

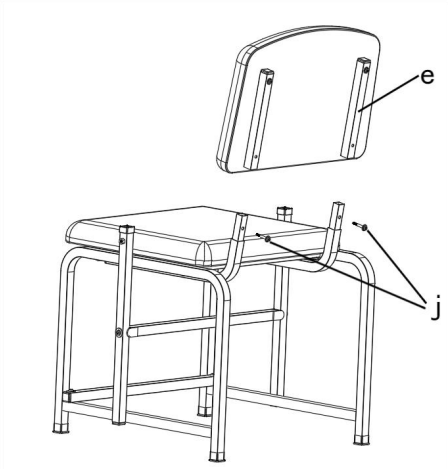


Figure 5

Install the backrest component (Figure 5)

e: Backrest component j: M6*42*2

Step 4:

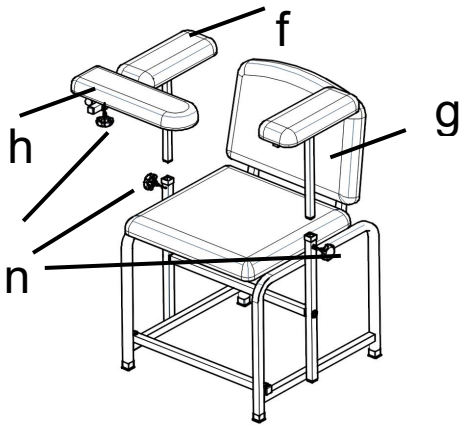


Figure 6

Install 2 handrails on the chair (Figure 6)

f: Right armrest*1 g: Left armrest*1

h: reverse turning bed*1 n: Handwheel*3

Step 5:

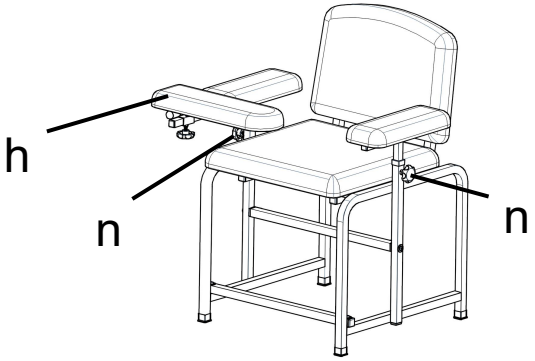


Figure 7

Installation completed(Figure 7)

Relax the handwheel, the height of the armrest can be adjusted. Tighten the handwheel, the armrest can be fixed.

reverse turning bed can be rotated vertically to horizontally.(Can't stop in the middle.)

Manufacturer: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd

Address: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province,214400,China

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHAISE DE PRÉLÈVEMENT DE SANG

MODÈLE : HS10

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHAISE DE PRÉLÈVEMENT DE SANG


MODÈLE : HS10



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES



a : Gauche et droite supports



b :Tuyau de raccordement de l'accoudoir 2



c: Accoudoir tuyau de raccordement 1



d:Coussin de siège composant




e:Dossier composant



effroi accoudoir



g:Gauche accoudoir



h : Inversé lit tournant

Figure 1

Machine Translated by Google

LISTE DU MATÉRIEL

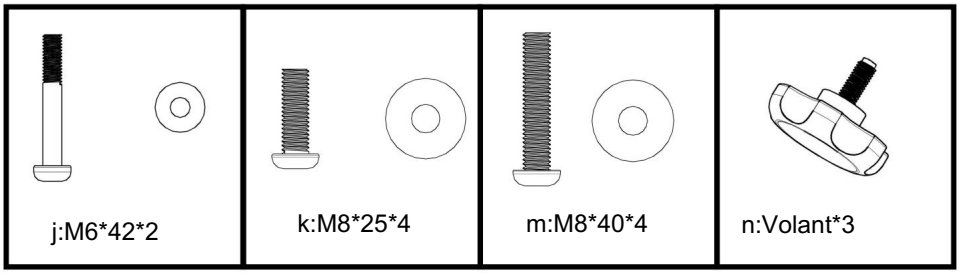


Figure 2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Remarque : lors de l'assemblage de la chaise, ne serrez pas trop les vis.

Terminez l'ensemble de l'assemblage puis serrez fermement.

Étape 1 :

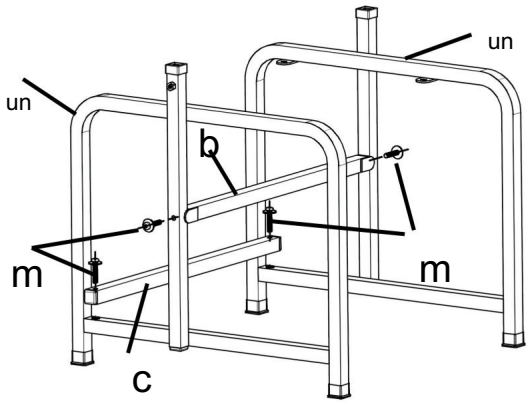


Figure 3

Fixez le tuyau de raccordement de l'accoudoir 1 et le tuyau de raccordement de l'accoudoir 2 à crochets gauche et droit (Figure 3)

a : crochets gauche et droit *2

b : Tuyau de raccordement de l'accoudoir 2

c : Tuyau de raccordement de l'accoudoir 1

Machine Translated by Google

Étape 2 :

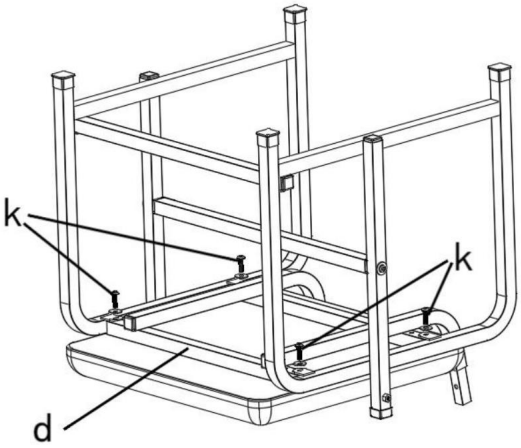


Figure 4

Connectez le composant du coussin de siège au châssis du véhicule (Figure 4)

d : Composant du coussin de siège k : M8*25*4

Étape 3 :

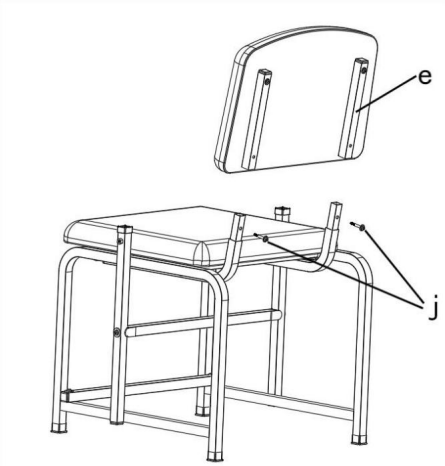


Figure 5

Installer le composant du dossier (Figure 5) j :

Composant du dossier M6*42*2 e :

Machine Translated by Google

Étape 4 :

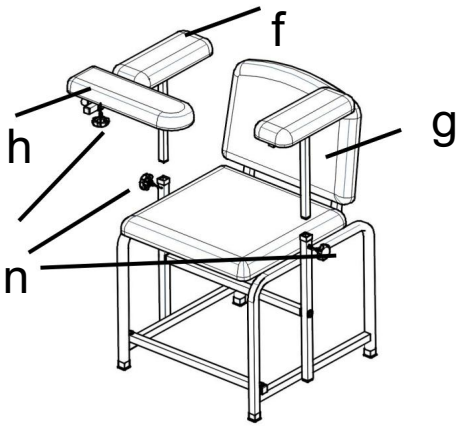


Figure 6

Installer 2 mains courantes sur la chaise (Figure 6) f :

Accoudoir droit*1 g : Accoudoir gauche*1 h : Lit pivotant inversé*1

n : Volant*3

Machine Translated by Google

Étape 5 :

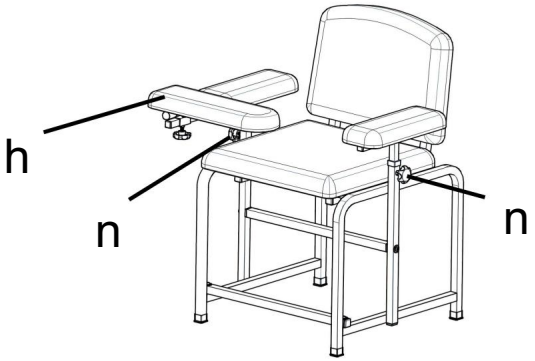


Figure 7

Installation terminée (Figure 7)

Relâchez la molette pour régler la hauteur de l'accoudoir. Resserrez la molette pour fixer l'accoudoir. Le plateau de retournement peut pivoter verticalement ou horizontalement (arrêt impossible).

Fabricant : Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd Adresse : No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, Chine Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLUTENTNAHMESTUHL

MODELL: HS10

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLUTENTNAHMESTUHL


MODELL: HS10



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

TEILELISTE



a:Links und rechts
Klammern



b:Armlehnenverbindungsrohr
2



c: Armlehne
Verbindungsrohr
1



d:Sitzkissen
Komponente




e:Rückenlehne
Komponente



Schreck
Armlehne



g:Links
Armlehne



h: Rückwärts
Wendebett

Abbildung 1

Machine Translated by Google

HARDWARELISTE

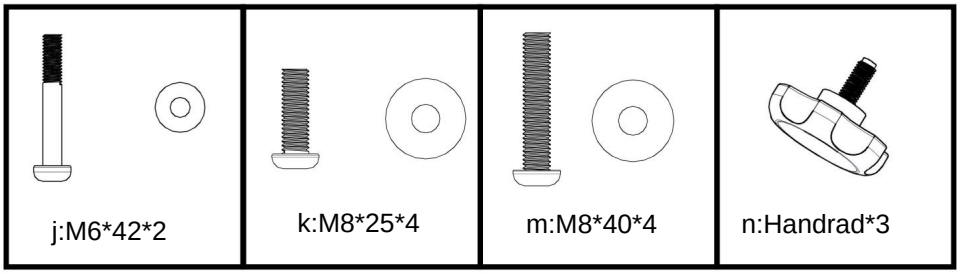


Abbildung 2

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben beim Zusammenbau des Stuhls nicht zu fest an.

Schließen Sie die gesamte Montage ab und ziehen Sie sie anschließend fest an.

Schritt 1:

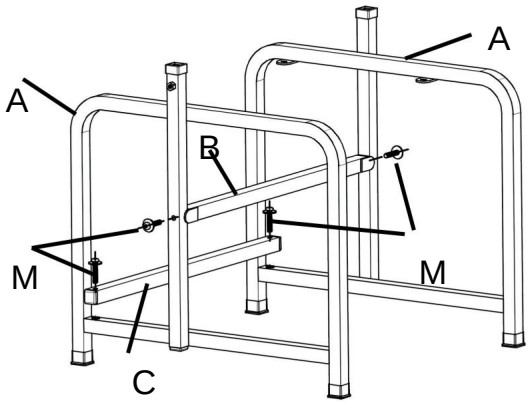


Abbildung 3

Befestigen Sie Armlehnenverbindungsrohr 1 und Armlehnenverbindungsrohr 2 an

linke und rechte Klammern (Abbildung 3)

a: linke und rechte Klammer *2

b: Armlehnenverbindungsrohr 2

c: Armlehnenverbindungsrohr 1

Machine Translated by Google

Schritt 2:

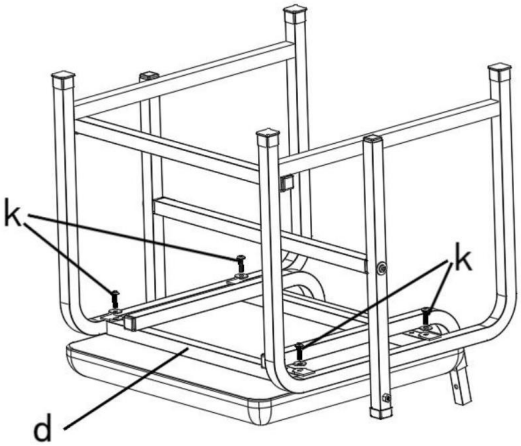


Abbildung 4

Sitzpolsterkomponente mit dem Fahrzeugrahmen verbinden (Abbildung 4) d:

Sitzpolsterkomponente k: M8*25*4

Schritt 3:

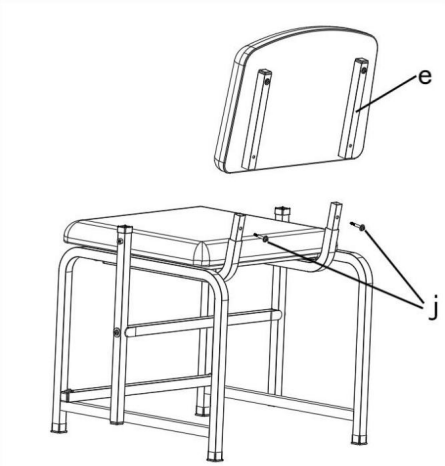


Abbildung 5

Rückenlehnenteil montieren (Abbildung 5) j: M6*42*2 e:

Rückenlehnenteil

Machine Translated by Google

Schritt 4:

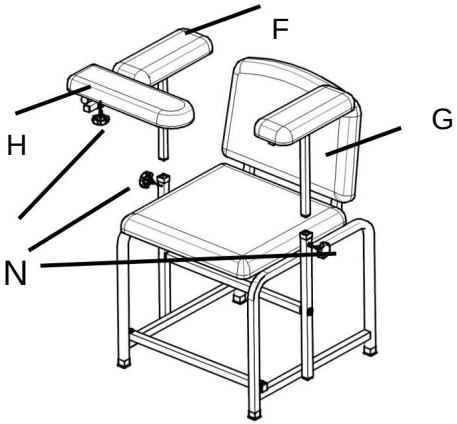


Abbildung 6

Montieren Sie 2 Handläufe am Stuhl (Abbildung 6) f:

Rechte Armlehne*1 g: Linke Armlehne*1 h: Rückwärtsdrehbett*1 n:

Handrad*3

Machine Translated by Google

Schritt 5:

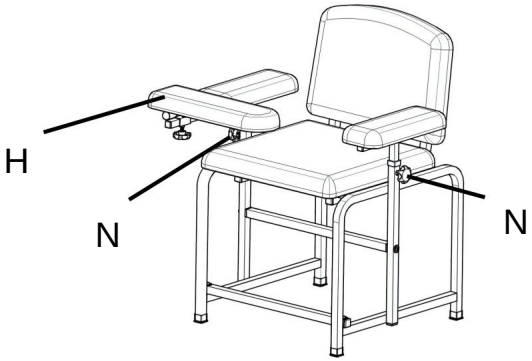


Abbildung 7

Installation abgeschlossen (Abbildung 7)

Durch Lösen des Handrads lässt sich die Höhe der Armlehne verstellen. Durch Festziehen des Handrads lässt sich die Armlehne fixieren. Das

Drehbett kann vertikal und horizontal gedreht werden. (Kann nicht in der Mitte angehalten werden.)

Hersteller: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd **Adresse:** Nr. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, China **Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite

250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEDIA PER PRELIEVO DEL SANGUE

MODELLO: HS10

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEDIA PER PRELIEVO DEL SANGUE


MODELLO: HS10



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ELENCO DEI PEZZI



a:Sinistra e destra
parentesi



b:Tubo di collegamento
bracciolo 2



c: Bracciolo
tubo di collegamento
1



d:Cuscino del sedile
componente




e:Schienale
componente



f:Destra
bracciolo



g:Sinistra
bracciolo



h: Invertire
girare il letto

Figura 1

Machine Translated by Google

ELENCO HARDWARE

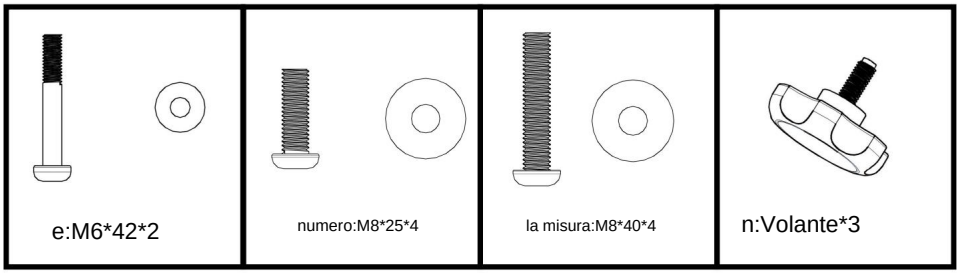


Figura 2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nota: quando si monta la sedia, non serrare eccessivamente le viti.

Completare l'assemblaggio e poi stringere saldamente.

Fase 1:

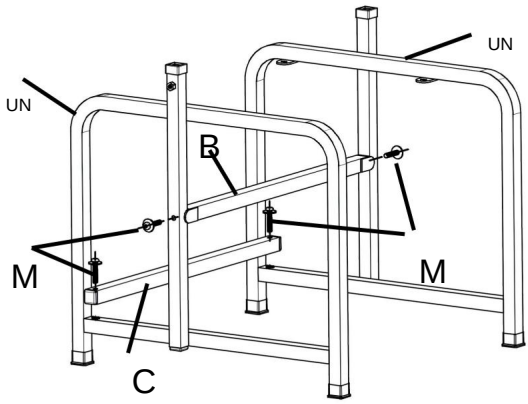


Figura 3

Fissare il tubo di collegamento del bracciolo 1 e il tubo di collegamento del bracciolo 2 a parentesi sinistra e destra (Figura 3)

a: parentesi sinistra e destra *2

b: Tubo di collegamento bracciolo 2

c: Tubo di collegamento bracciolo 1

Machine Translated by Google

Fase 2:

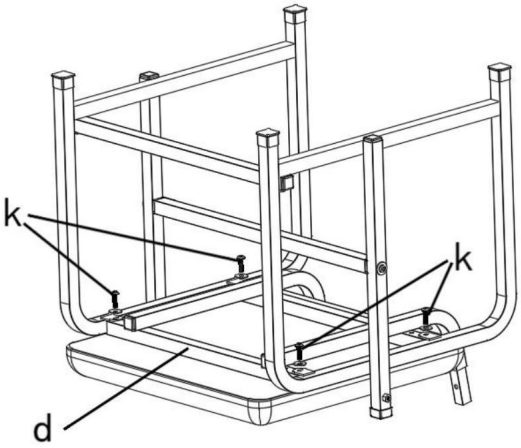


Figura 4

Collegare il componente del cuscino del sedile al telaio del veicolo (Figura 4) d:

Componente del cuscino del sedile k: M8*25*4

Fase 3:

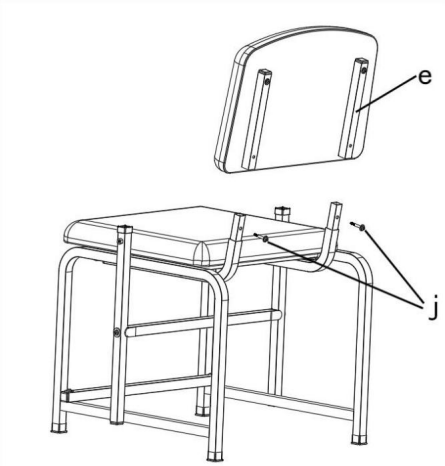


Figura 5

Installare il componente dello schienale (Figura 5)

e: Componente dello schienale j: M6*42*2

Machine Translated by Google

Fase 4:

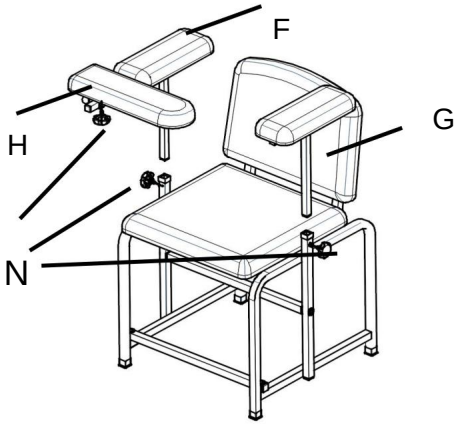


Figura 6

Installare 2 corrimano sulla sedia (Figura 6) f: Bracciolo destro*1 g: Bracciolo sinistro*1 h: Letto girevole inverso*1 n: Volantino*3

Machine Translated by Google

Fase 5:

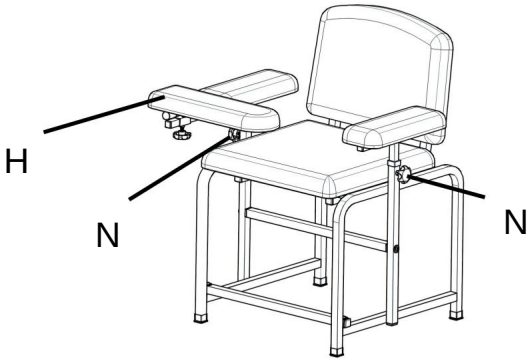


Figura 7

Installazione completata (Figura 7)

Rilassa il volantino, l'altezza del bracciolo può essere regolata. Stringi il volantino, il bracciolo può essere fissato. Il letto girevole inverso può

essere ruotato verticalmente o orizzontalmente. (Non è possibile fermarsi nel mezzo.)

Produttore: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd **Indirizzo:** No.

589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province,214400, Cina

Importato in AUS: SIHAO

PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato in USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SILLA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE

MODELO: HS10

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SILLA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE


MODELO: HS10



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS



a:Izquierda y derecha soportes



b:Tubo de conexión del reposabrazos 2



c: Apoyabrazos tubo de conexión 1



d:Cojín del asiento componente




e:Respaldo componente



susto brazo



g:Izquierda brazo



h: Invertir cama giratoria

Figura 1

Machine Translated by Google

LISTA DE HARDWARE

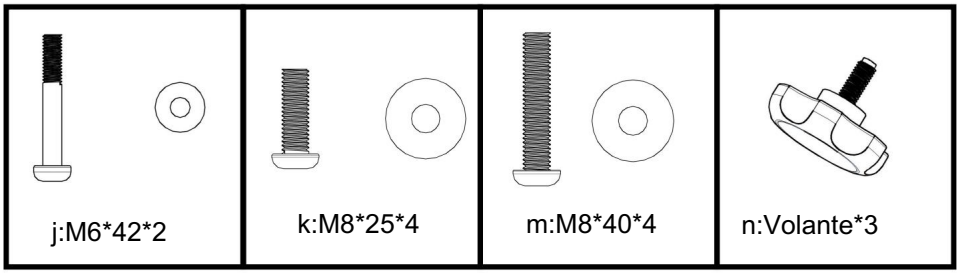


Figura 2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Nota: Al ensamblar la silla, no apriete demasiado los tornillos.

Termine todo el montaje y luego apriételo firmemente.

Paso 1:

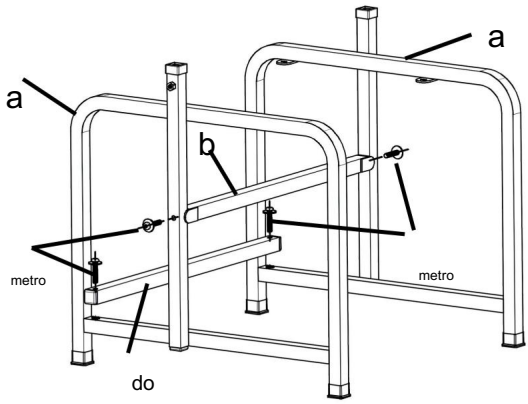


Figura 3

Fije el tubo de conexión del reposabrazos 1 y el tubo de conexión del reposabrazos 2 a corchetes izquierdo y derecho (Figura 3)

a: corchetes izquierdo y derecho *2

b: Tubo de conexión del reposabrazos 2

c: Tubo de conexión del reposabrazos 1

Machine Translated by Google

Paso 2:

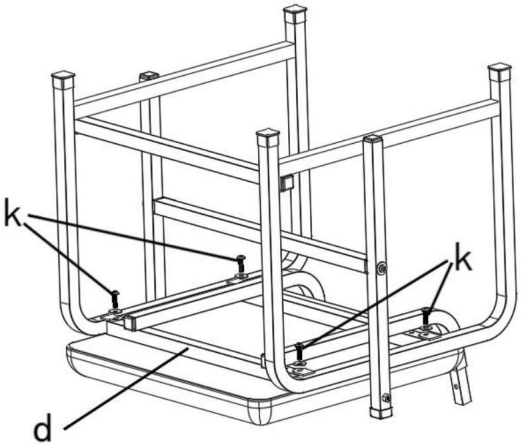


Figura 4

Conecte el componente del cojín del asiento al bastidor del vehículo (Figura 4)

d: Componente del cojín del asiento k: M8*25*4

Paso 3:

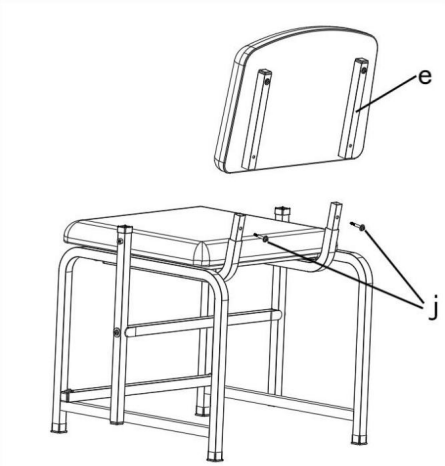


Figura 5

Instale el componente del respaldo (Figura 5)

e: Componente del respaldo j: M6*42*2

Machine Translated by Google

Paso 4:

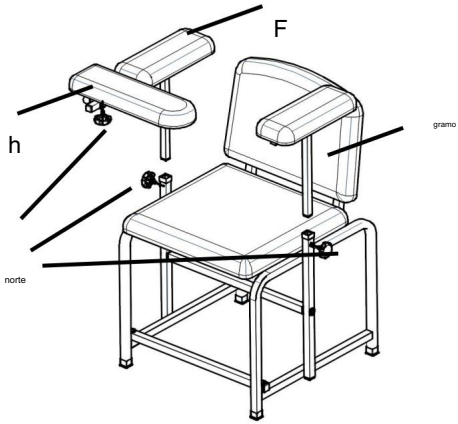


Figura 6

Instale 2 pasamanos en la silla (Figura 6) f: Apoyabrazos derecho*1 g: Apoyabrazos izquierdo*1 h: Cama giratoria inversa*1 n: Volante*3

Machine Translated by Google

Paso 5:

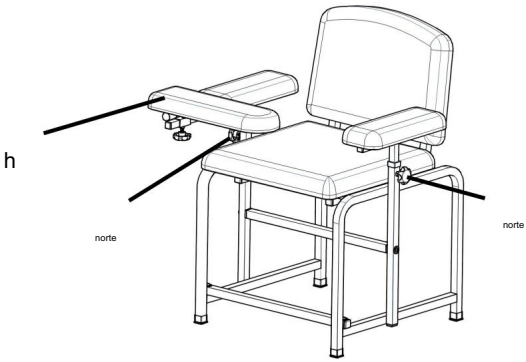


Figura 7

Instalación completada (Figura 7)

Suelte el volante para ajustar la altura del reposabrazos. Apriételo para fijar el reposabrazos. La cama giratoria permite rotar vertical y horizontalmente (sin detenerse en la mitad).

Fabricante: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd. Dirección: No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, China.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia. Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KRZESŁO DO POBIERANIA KRWI

MODEL: HS10

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

KRZESŁO DO POBIERANIA KRWI


MODEL: HS10



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI



a:Lewo i prawo
wsporniki



b: Rura łącząca podłokietnik
2



c: Podłokietnik
rura łącząca
1



d:Poduszka siedziska
część




e:Oparcie
część



strach
podłokietnik



g:Lewy
podłokietnik




h: Odwróć
łóżko obrotowe

Rysunek 1

Machine Translated by Google

LISTA SPRZĘTU

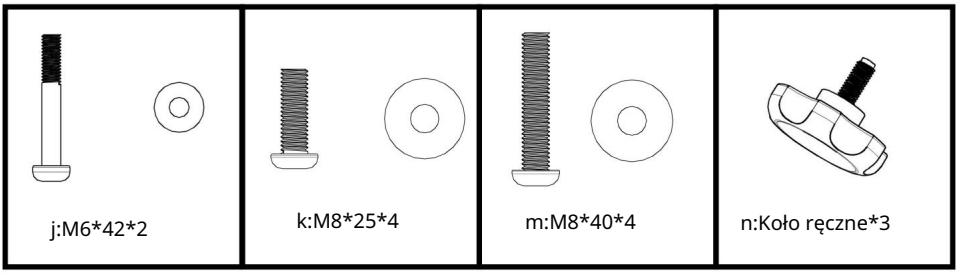


Rysunek 2

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: Podczas montażu krzesła nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

Zakończ cały montaż i mocno dokręć.

Krok 1:

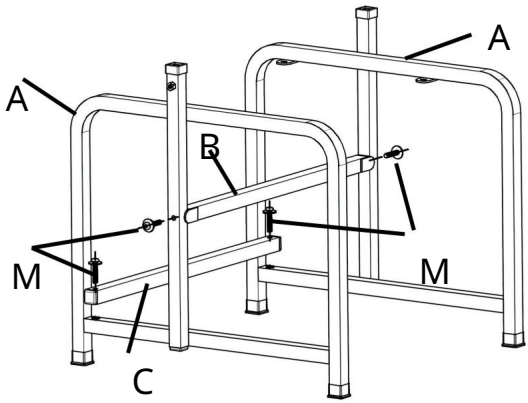

Rysunek 3

Zabezpiecz rurę łączącą podłokietnik 1 i rurę łączącą podłokietnik 2.

nawiasy lewy i prawy (Rysunek 3)


a: nawiasy lewy i prawy *2

b: Rura łącząca podłokietnik 2

c: Rura łącząca podłokietnik 1

Machine Translated by Google


Krok 2:

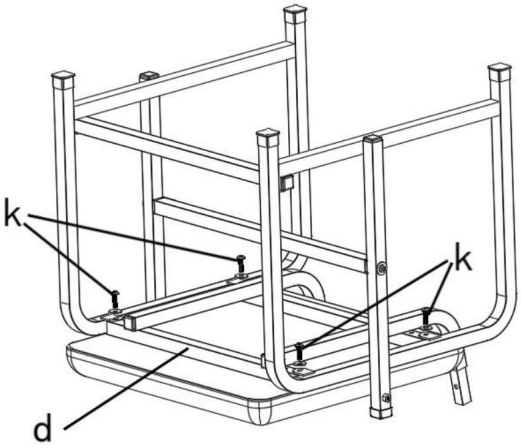

Rysunek 4

Podłącz element poduszki siedzenia do ramy pojazdu (rysunek 4) d: Element poduszki siedzenia k: M8*25*4

Krok 3:

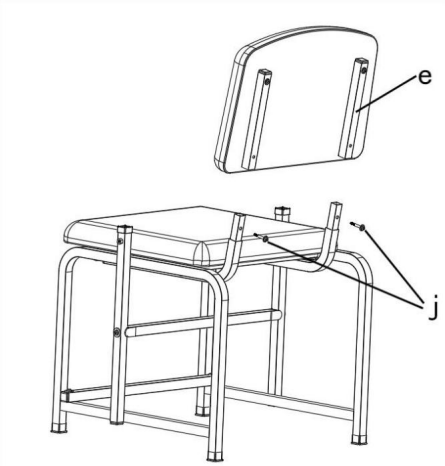


Rysunek 5

Zamontuj element oparcia (rysunek 5) j:

Element oparcia M6*42*2 e:

Machine Translated by Google

Krok 4:

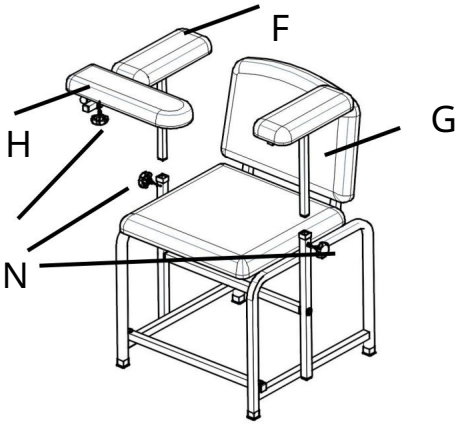


Rysunek 6

Zamontuj 2 poręcze na krześle (rysunek 6) f: Podłokietnik prawy*1 g: Podłokietnik lewy*1 h: Łóżko obracające się w odwrotnym kierunku*1 n: Pokrętło*3

Machine Translated by Google

Krok 5:

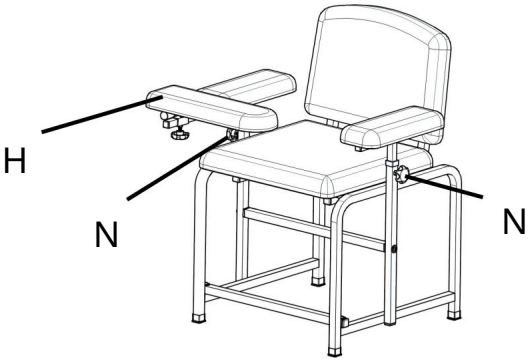

Rysunek 7

Instalacja ukończona (Rysunek 7)

Rozluźnij pokrętło, wysokość podłokietnika można regulować. Dokręć pokrętło, podłokietnik można zamocować. Łóżko obrotowe w odwrotnym

kierunku można obracać pionowo do poziomo. (Nie można zatrzymać się na środku.)

Producent: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd Adres: No. 589

Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, Chiny Importowane

do AUS: SIHAO PTY LTD. 1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLOEDAFNAME STOEL

MODEL: HS10

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


BLOEDAFNAME STOEL

MODEL: HS10



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google



a:Links en rechts haakjes



b: Armleuning verbindingsbuis 2



c: Armleuning verbindingsbuis 1



d:Zitkussen onderdeel




e:Rugleuning onderdeel



f:Rechts armleuning



g:Links armleuning




h: Omgekeerd bed draaien

Figuur 1

Machine Translated by Google

HARDWARELIJST

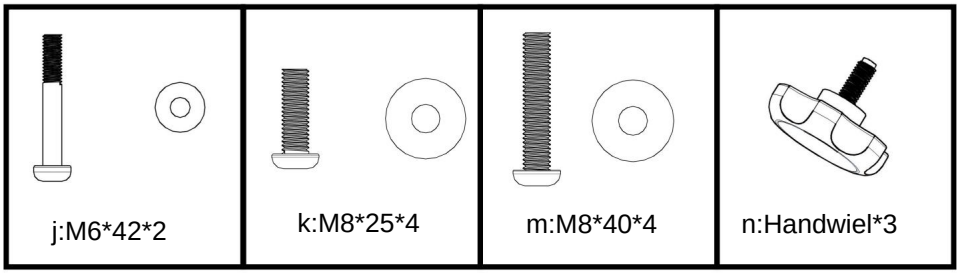


Figuur 2

MONTAGE-INSTRUCTIES

Let op: Draai de schroeven niet te vast bij het monteren van de stoel.
Maak de montage af en draai alles vervolgens stevig vast.

Stap 1:

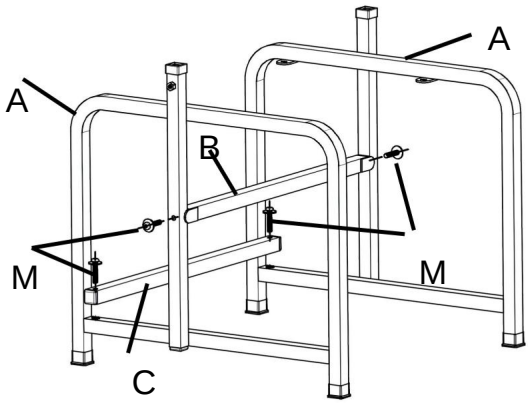

Figuur 3

Bevestig armleuningverbindingsbuis 1 en armleuningverbindingsbuis 2 aan linker- en rechterhaakjes (Figuur 3)


a: linker en rechter haakjes *2

b: Armleuningverbindingsbuis 2

c: Armleuningaansluitbuis 1

Machine Translated by Google

Stap 2:

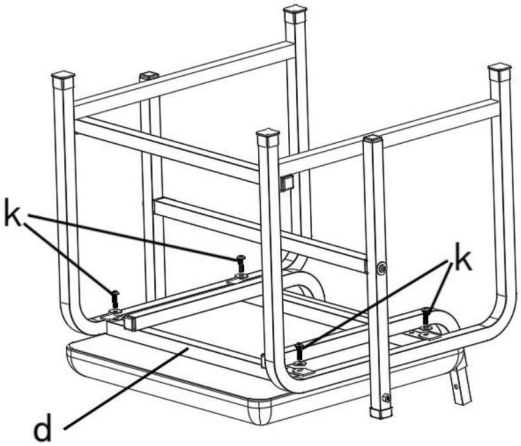


Figuur 4

Bevestig het zitkussencomponent aan het voertuigframe (Figuur 4) d:

Zitkussencomponent k: M8*25*4

Stap 3:

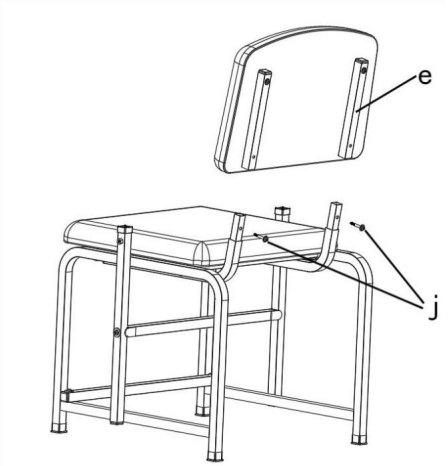


Figuur 5

Rugleuningcomponent monteren (Figuur 5) j:

Rugleuningcomponent M6*42*2 e:

Machine Translated by Google

Stap 4:

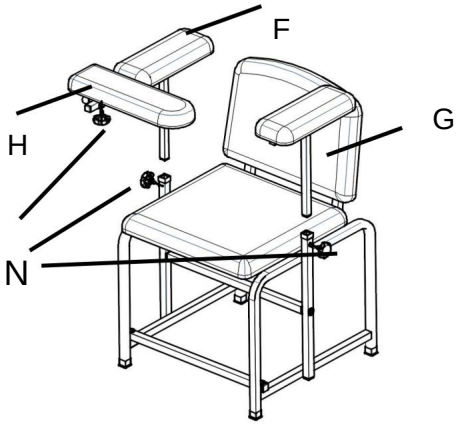


Figuur 6

Monteer 2 leuningen op de stoel (Figuur 6) f: Rechter armleuning*1 g: Linker armleuning*1 h: Omgekeerd draaiend bed*1 n: Handwiel*3

Machine Translated by Google

Stap 5:

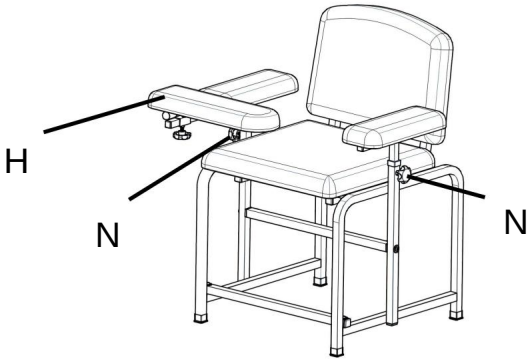

Figuur 7

Installatie voltooid (Figuur 7)

Ontspan het handwiel, de hoogte van de armleuning kan worden aangepast. Draai het handwiel vast, de armleuning kan worden vastgezet.

Omgekeerd draaiend bed kan verticaal naar horizontaal worden gedraaid. (Kan niet in het midden stoppen.)

Fabrikant: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd **Adres:** No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, China

Geïmporteerd naar AUS:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië **Geïmporteerd naar VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLODDRAGNINGSTOL

MODELL: HS10

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLODDRAGNINGSTOL


MODELL: HS10



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

DELLISTA



a: Vänster och höger parenteser



b: Armstödsanslutningsrör 2



c: Armstöd anslutningsrör 1



d: Sittdyna komponent




e: Ryggstöd komponent



skrämsel armstöd



g: Vänster armstöd




h: Omvänd vändsäng

Figur 1

Machine Translated by Google

HÅRDVARULISTA

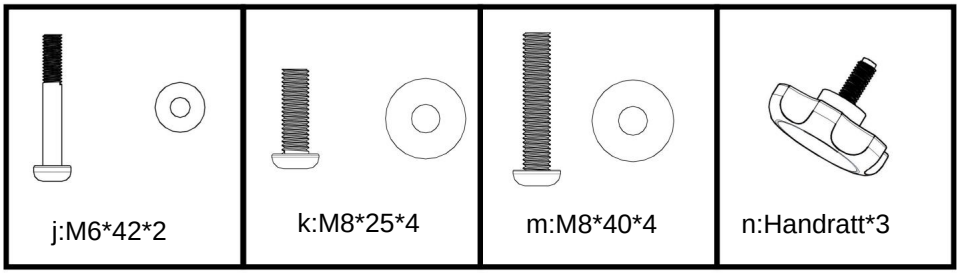


Figur 2

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt när du monterar stolen.

Avsluta hela monteringen och dra sedan åt ordentligt.

Steg 1:

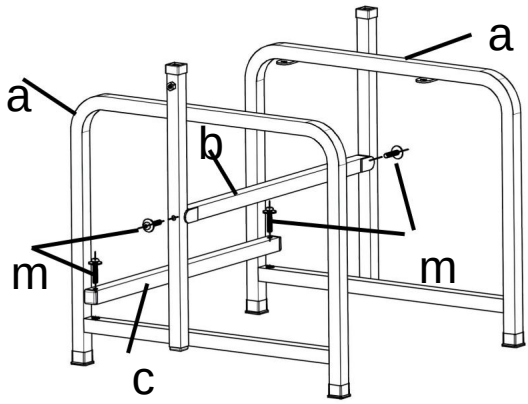

Figur 3

Fäst armstödets anslutningsrör 1 och armstödets anslutningsrör 2 till vänster och höger parentes (Figur 3)


a: vänster och höger parentes *2

b: Armstödsanslutningsrör 2

c: Armstödsanslutningsrör 1

Machine Translated by Google


Steg 2:

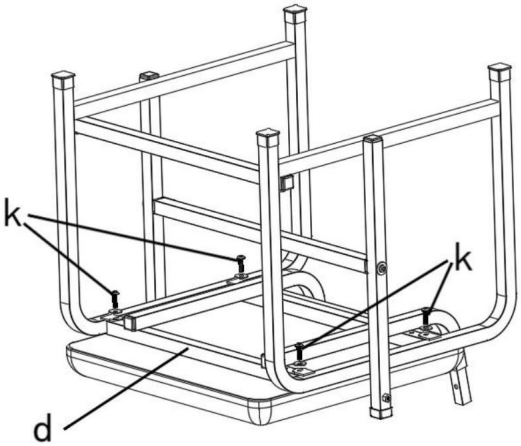

Figur 4

Anslut sittdynans komponent till fordonsramen (Figur 4) d: Sittdynans komponent
k: M8*25*4

Steg 3:

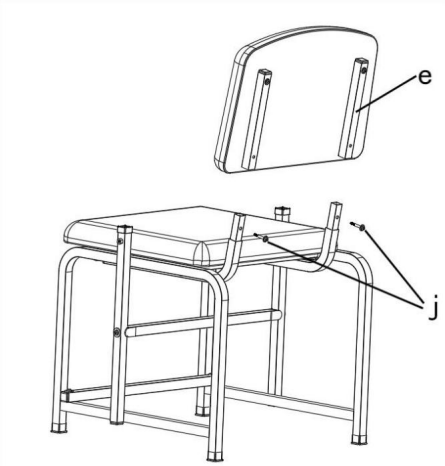

Figur 5

Montera ryggstödskomponenten (Figur 5) j: M6*42*2
Ryggstödskomponent e:

Machine Translated by Google

Steg 4:

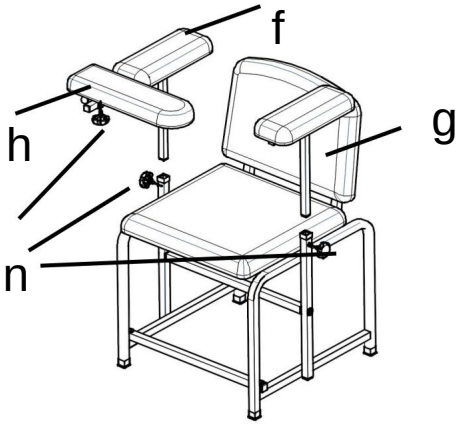


Bild 6

Montera 2 ledstänger på stolen (Figur 6) f: Höger armstöd*1

g: Vänster armstöd*1 h: bakåtvänd säng*1 n: Handratt*3

Machine Translated by Google

Steg 5:

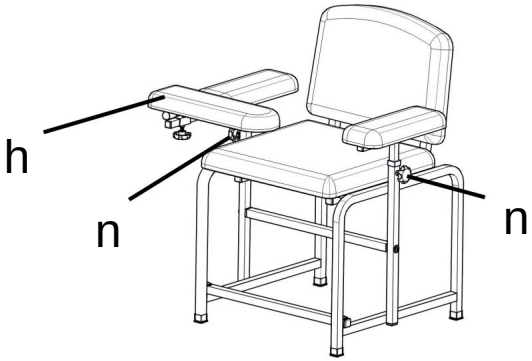


Bild 7

Installationen slutförd (Figur 7)

Slappna av på handratten, höjden på armstödet kan justeras. Dra åt handratten, armstödet kan fixeras. omvänd vändbädd kan roteras vertikalt

till horisontellt.(Kan inte stanna i mitten.)

Tillverkare: Jiangyin Huashi Medical Equipment Co., Ltd. **Adress:** No. 589 Hualu Road, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, 214400, Kina **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support